

**ΠΡΟΣ:**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  
**"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"**

**ΥΠ' ΟΨΙΝ:**  
**ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**ΑΘΗΝΑ, 25 Σεπτεμβρίου 2019**

**ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ) Χειρουργικού Προβολέα LED (α' Διαβούλευση)**

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να παραθέσουμε την απάντηση της εταιρείας μας που αφορά την Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Χειρουργικού Προβολέα LED.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε τα εξής :


- Στην Προδιαγραφή Α.5. ζητείται «Οι ρυθμίσεις να πραγματοποιούνται από στεγανό πληκτρολόγιο στην κεφαλή του προβολέα».

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν προσφέρει κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε έναν χειρουργικό προβολέα, καθότι είναι πιο πρακτικό να υπάρχει ένας τρόπος ελέγχου των ρυθμίσεων του προβολέα και από κάποιο άλλο σημείο πέραν της κεφαλής (δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι χειρουργικοί προβολείς έχουν την δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων μέσω της αποστειρούμενης χειρολαβής που βρίσκεται επί της κεφαλής τους). Επιπροσθέτως είναι και περιοριστική, καθώς η πλειονότητα των κατασκευαστών χειρουργικών προβολέων κατασκευάζουν μοντέλα με το πληκτρολόγιο τοποθετημένο επί του καρδανικού βραχίονα του προβολέα, άρα περιορίζεται η ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε η εν λόγω Προδιαγραφή να αλλαχθεί σε:

***«Οι ρυθμίσεις να πραγματοποιούνται από πληκτρολόγιο επί του βραχίονα ή της κεφαλής του προβολέα καθώς και από αποστειρούμενη χειρολαβή ευρισκόμενης στο κέντρο της κεφαλής του.»***

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις είμαστε στην διάθεσή σας στα τηλέφωνα:  
(210) 7254420-3, φαξ (210) 7254423: και e-mail : [chryssadakos@biosense.gr](mailto:chryssadakos@biosense.gr)

Για την  
«**BIOSENSE**»

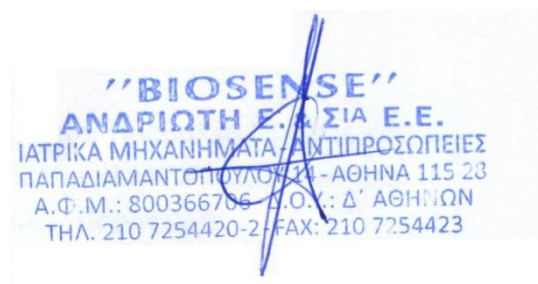

Ελισάβετ Ανδριώτη  
Νόμμος Εκπρόσωπος



**biosense**