

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015

- ΠΡΟΣ :**
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κο Γρηγορόπουλο Αναστάσιο
 - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 - 1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διοικητή / Κο Άγγελο Παπαδόπουλο
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΗ: Προέδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
Κο Λεάνδρο Ρακιντζή
 - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
- Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την πρώτη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Σύμβαση Συντήρησης – Επισκευής Δεκάξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως

επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλευση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

«Συντήρηση – Επισκευή Δεκαέξι Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού GAMBRO»

1.Όρος 2. *«Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο – εξουσιοδοτημένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος*

Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθούν τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου καθώς και τα ισχύοντα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους».

Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από εκπαιδευμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά όταν στην ίδια πρόταση ζητείται να είναι και εξουσιοδοτημένοι καθώς και η προσκόμιση εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τις εν λόγω βεβαιώσεις αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των

εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και **σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.**

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση **υποθάλλει** πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια βεβαιώσεις στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω όρος περί προσκόμισης εξουσιοδοτήσεων από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχε, με αυτή τη μορφή, σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών του Νοσοκομείο Ευαγγελισμού.

Ειδικότερα, στην διακήρυξη με αριθμ. 199/10 (***Σχετ. 1***) αναγραφόταν ότι:

«2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση

του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής

καθώς και στην διακήρυξη 46/2012 (Σχετ. 2) αναγραφόταν ακριβώς ο ίδιος όρος:
«2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής».

Ποιος είναι ο λόγος που ώθησε τον Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού να ζητήσει εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και εξουσιοδοτήσεις από τον κατασκευαστικό οίκο???

Μήπως ότι το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού δεν θέλει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού έχοντας τρανή απόδειξη την τελευταία ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ στην εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, βάσει της απόφασης ΔΣ 23 της 49^{ης} συνεδρίας ΔΣ της 14-1-2015 και ΑΔΑ 71Χ94960ΩΧ-ΖΜΤ (Σχετ. 3), βάσει της οποίας επισημαίνεται μεν η σοβαρότητα της χρήσης των μηχανημάτων, παρόλα αυτά δεν διενεργήθηκε έρευνα αγορά παρά μόνο ζητήσατε προσφορά από την εν λόγω εταιρεία διότι είναι «Αποκλειστικός Διανομέας των Μηχανημάτων Gambro Σουηδίας στην Ελλάδα».

Ποια χειρ φύτευσε εμβόλιμα και παρενθετικά το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και μάλιστα οψίμως, τη στιγμή που μπορεί να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός στην επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων Gambro;

Αναπόφευκτο (ωσάν προγραμματισμένο) αποτέλεσμα θα είναι να ανθίσει η «φαιδρά πορτοκαλέα» και να «θάλλει η ελαία» στο Νοσοκομείο, το οποίο ενώ επί χρόνια βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών των τεχνικών μας (από το 1986 μέχρι 2012), συνδράμει πλέον στη μονοπώληση της σχετικής προμήθειας υπέρ του γνωστού

περιούσιου... μόνο και μόνο γιατί ο τελευταίος διαθέτει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό που δεν είναι όμως, ούτε βάσει νόμου ούτε ήταν παλαιότερα κατά την πρακτική του Νοσοκομείου, το μόνο ικανό και αναγκαίο στοιχείο απόδειξης της τεχνικής αρτιότητας των συντηρητών. Το τι σημαίνει ανταγωνισμός και τι μονοπώλιο είναι θεωρητική πλέον έννοια για τους υπεύθυνους δημόσιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 4) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 5) και αρ.πρωτ. 8834/21-9-2015 (Σχετ. 6) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Ομοίως με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται και από το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε διακήρυξη με αρ. 06/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Σχετ. 7) του νοσοκομείου, οι οποίοι όροι προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση, και έχει ως εξής:

«1. Ο Συντηρητής αποδεδειγμένα θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία για τις εργασίες συντήρησης, τα οποία να αποδεικνύονται με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

- Πιστοποιήσεις ISO του συντηρητή που αφορά στην εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν εκπαιδευτεί στα υπό ανάθεση μηχανήματα τεχνητού νεφρού. Στην περίπτωση όπου δεν διαθέτουν οι τεχνικοί του αναδόχου πιστοποιητικά εκπαίδευσης για τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία τουλάχιστον ενός Δημόσιου

Νοσοκομείου, στην οποία να αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει ικανοποιητικά εργασίες συντήρησης σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου».

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε – τονίζουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία μας παρά την έλλειψη βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή οίκο, δραστηριοποιείται επιτυχώς στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα από το 1976, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών αλλά και πολύ πιο οικονομικότερων για το συμφέρον των νοσοκομείων και για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ εν γένει, τιμών.

Προς επιπλέον επίρρωση της παράνομης σκοπιμότητας του όρου «εξουσιοδότηση» οράτε κατωτέρω στις σελίδες 24-26 υπό τίτλους :

Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 η κατασκευάστρια εταιρεία Gambro Lundia AB στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπου η εταιρεία μας κατέφυγε για τη δικαίωση της.

Και

Ιδού τι αναφέρουν τα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια χρήσης της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρείας Gambro Lundia AB.

2.Όρος 3. *«Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν*

[...]

-Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.»

Τα ανταλλακτικά των Ιατρικών Μηχανημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν αποτελούν – θεωρούνται Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και συνεπώς δεν φέρουν πιστοποίηση CE.

3.Όρος 3. «Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν

[...]

στ. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή ο Συντηρητής θα προβαίνει κατά την άποψη του, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του Συγκροτήματος, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον Κατασκευαστή Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελούμενων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών. **Ο Συντηρητής οφείλει να ενημερώνει στον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά με τις βελτιώσεις του ιατροτεχνολογικού είδους που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος».**

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει απαρέγκλιτα ο κατασκευαστής, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για

την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί (μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντι ανταγωνιστικό μοϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι *«Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 8).*

Ακολούθως, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο *service* στα Νοσοκομεία ως *συμφέρουσα λύση* και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

Σας παραπέμπουμε στη σύμβαση 2581/99 του Υπουργείου Ανάπτυξης όπου το Νοσοκομείο σας προμηθεύτηκε το τέσσερα (4) μηχανήματα τεχνητού νεφρού AK-95 και τα δύο (2) μηχανήματα τεχνητού νεφρού AK-200 του οίκου Gambro, το οποίο αφορά ο παρών διαγωνισμός. Στις σελίδες 26 και 27 αναφέρεται επίσης το άνω κείμενο.

Δηλαδή η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω συμβάσεων 4567/2003 & 2581/99 δεσμεύονταν:

- Να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς 24 νοσοκομείων για το 100% των βλαβών, μεταξύ αυτών και τους τεχνικούς του νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (!)
- Για την δυνατότητα και την οργάνωση 24 Αυτόνομων service σ' αυτά τα 24 Νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και του νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (!)

4.Όροι 5 και 6 .

Όρος 5. «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

[...]

Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 08:00 έως τις 16:00

[...]»

Όρος 6. «DOWN TIME

[...] Ο χρόνος αυτός θα προσμετράτε αθροιστικά από την ειδοποίηση του Συντηρητή (μη εξαιρουμένων Αργιών και Σαββαροκύριακων όταν το νοσοκομείο εφημερεύει) για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή fax από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 έως 22:00. Η κλήση θα γίνεται – εφόσον παραστεί ανάγκη – από ώρες από 08:00 έως

22:00 και τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα, εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει. [...]

Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης του Συντηρητή, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης μηχανήματος υποενότιας υπερβεί τις 24 ώρες από την ειδοποίηση / κλήση του Συντηρητή, οι πέραν των 24 ωρών δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης της περίπτωσης».

Οι δύο αυτοί όροι έρχονται σε πλήρη αντίφαση διότι :

- ο όρος 5 αναφέρει ότι οι επισκευές θα γίνονται από τις 08:00 έως τις 16:00, ενώ ο όρος 6 αναφέρει ότι θα γίνονται από τις 08:00 μέχρι τις 22:00.
- Από την κλήση του συντηρητή για επισκευή βλάβης αρχίζει να μετράει ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος.
- Άραγε ποιο είναι το σωστό χρονικό περιθώριο για την επισκευή του μηχανήματος, από πότε αρχίζει και πότε τελειώνει;
- Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται μόνο καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00 αλλά ο «DOWN TIME» χρόνος θα προσμετρείται αθροιστικά από την ειδοποίηση του συντηρητή από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 έως 22:00 και τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα , εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει . (!!!)

5.Όρος 9. «Θα κατατεθεί βεβαίωση / επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησης των».

Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούσαν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ. 9), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «*Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ*» και το διακριτικό τίτλο «*Medical Products Ltd*», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «*ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service)*» και το διακριτικό τίτλο «*SER.CO LTD*» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «*Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ*» και το διακριτικό τίτλο «*Medical Products Ltd*» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «*ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service)*» και το διακριτικό τίτλο «*SER.CO LTD*», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσκρούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου

αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

Οι αναφορές του περιούσιου συντηρητή σας

Οι αναφορές στις ψευδο-επιστολές και στις προσφορές της που προσκομίζει η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ είναι ψευδείς, και για το λόγο ότι οι τύποι των μηχανημάτων AK-95, AK-100 και AK-200 έχουν πάψει να υποστηρίζονται τεχνικά από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro, όπως προκύπτει από τα παρακάτω σχετικά έγγραφα, τα οποία σας επισυνάπτουμε (*Σχετ. 10, 11, 12 & 13*):

- Ενημερωτικό δελτίο Service No 249/23-1-2013 για τα AK 95
- Ενημερωτικό δελτίο service No 403/21-06-2007 για τα AK-100
- E-mail από Gambro της 26/11/2009 για τελευταία ευκαιρία αγοράς ανταλλακτικών των μηχανημάτων AK-10, AK-90 και AK-100 πριν καταστραφεί (απορριφθεί - scrapped) το τελευταίο απόθεμα του κατασκευαστή.
- Ενημερωτικό δελτίο Service No 168/23-1-2013 για τα AK 200

Ο κατασκευαστικός οίκος δηλαδή δεν παρέχει πλέον γι' αυτά τα μηχανήματα ούτε τεχνική και επιστημονική υποστήριξη αλλά ούτε και ανταλλακτικά. Για ποια ευθύνη κάνει λόγο η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, για ποια αποκλειστική εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή οίκο Gambro, για ποια τεχνολογική και επιστημονική δυνατότητα και για ποια παροχή ανταλλακτικών, όταν ο ίδιος ο κατασκευαστής οίκος έχει αποποιηθεί κάθε ευθύνης με τα παραπάνω έγγραφα;, προσπαθώντας να παραπλανήσει τα νοσοκομεία, προκειμένου να πετύχει τον εκτοπισμό της εταιρείας

μας από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να επιβάλει παράνομα και μονοπωλιακά τις ασύμφορες προσφορές της, δεδομένου ότι αυτά έχουν πάψει προ πολλού να υποστηρίζονται τεχνικά από τον κατασκευαστικό οίκο;;;

Γ. Η μονοπωλιακή σχέση του Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και η πλήρης υποστήριξη του ΚΑΡΤΕΛ από τους αρμόδιους του νοσοκομείου.

Στις διακηρύξεις 199/10 και 46/2012 του νοσοκομείο Ευαγγελισμός υπήρχαν οι κατωτέρω όροι:

«2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής

[...]

9. Θα κατατεθεί βεβαίωση / επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων, ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησης των

10. Θα κατατεθεί δήλωση/δέσμευση του Οίκου Κατασκευής , που θα δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις , με τους ίδιους ακριβώς όρους, της σύμβασης συντήρησης και επισκευής , σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου του έργου να ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο»

Οι παράνομες τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν από τους αρμόδιους του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός αποσκοπούσαν στην απόλυτη στεγανοποίηση της προμήθειας συντήρησης και επισκευής Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro υπέρ του ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και της Gambro Lunia AB, μη δίνοντας την ευκαιρία σε κανένα άλλο τυχάρπαστο τίμιο και ρομαντικό συντηρητή – προμηθευτή ο οποίος δρα και προσπαθεί να επιβιώσει νόμιμα πέρα και μακριά από

τις παράνομες μεν αλλά προσοδοφόρες δε πρακτικές των ΚΑΡΤΕΛ και των ΑΠΙΣΤΩΝ αρμόδιων υπαλλήλων των Νοσοκομείων. Πάντα βέβαια εν γνώσει των αρμοδίων για υψηλές τιμές και αμφιβόλου ποιότητας εργασίες.

Επιπλέον άξιο αναφοράς είναι και το πώς κατακυρώθηκε ανάδοχος η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ; διότι παρόλο που οι προδιαγραφές τέθηκαν με σκοπό την ευνοϊκή της μεταχείριση, και τη δυνατότητα συμμετοχής μόνο αυτής, η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ δεν διέθετε και δεν διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για κανένα τεχνικό της για τους τύπους μηχανημάτων ΑΚ-100 και ΑΚ-10. Επίσης αμφίβολο είναι αν χορηγήθηκε και η ανήκουστη βεβαίωση του παραπάνω όρου 10 από τον κατασκευαστικό οίκο. Άρα έθεσαν τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να συμμετάσχει μόνο η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και έκαναν τα στραβά μάτια γιατί ούτε ο περιούσιος μοναδικός συμμετέχων πληρούσε αυτές τις προδιαγραφές ;;;

Άραγε στα τόσα χρόνια συνεργασίας σας με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, ελέγξατε και μετρήσατε ποτέ τον χρόνο «DOWN TIME » των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro του νοσοκομείου σας ; και πιθανόν οι μετρήσεις αυτές (!) σας έκαναν να αλλάξετε και τον σχετικό όρο – προδιαγραφή προς το αυστηρότερο (!).

Η εταιρεία μας διαδεχόμενη την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ στη συντήρηση των μηχανημάτων Gambro, μέσω των διαγωνισμών που κερδίζουμε, διαπιστώνει καθημερινά τις «συντηρήσεις ... επί χάρτου » που έκανε η εν λόγω εταιρεία (οράτε σχετικά κατωτέρω στις σελίδες 26-29).

Έτσι και η παρούσα δημόσια διαβούλευση είναι πλήρως προσχηματική και πάντα υπέρ του ΚΑΡΤΕΛ αφού οι αρμόδιοι του νοσοκομείου είχαν το θράσος να ενισχύσουν τους όρους ζητώντας πλέον και εξουσιοδοτήσεις, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν το παράνομο μονοπώλιο της συντήρησης των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro. Εντελώς αυθαίρετα και αδικαιολόγητα προσθέτουν και αφαιρούν κατά το δοκούν όρους και τεχνικές προδιαγραφές προς εξυπηρέτηση του ΚΑΡΤΕΛ.

Γράφοντας μάλιστα και στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. πρωτ. 2889/24-7-2015, ανακοίνωση της υπ' αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 απόφασης (Σχετ. 14), με βάση το οποίο από τις 21/07/2015 που τέθηκε σε εφαρμογή, οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που πρόκειται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, δεν συντάσσονται αυθαίρετα από τους αρμοδίους των νοσοκομείων αλλά μετά από υποχρεωτική πρόσκληση κατάθεσης

τεχνικών προδιαγραφών προς προμηθευτές συντηρητές κλπ. (παρόλο που η απόφαση αυτή επίσης δε λύνει το πρόβλημα των αυθαίρετων όρων !)

Σας επισυνάπτουμε (Σχετ. 15) τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις οποίες έχουμε καταθέσει απ' ευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3225/21-8-2015 έγγραφο μας, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης.

Επιπλέον το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ., μεταξύ και άλλων νοσοκομείων, εφάρμοσε την ως άνω απόφαση της ΕΠΥ και με το έγγραφο του υπ' αριθμ. πρωτ. 19763/28-9-2015 ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών. Σας επισυνάπτουμε (Σχετ. 16) Τεχνικές Προδιαγραφές που καταθέσαμε στο Νοσοκομείο του Ερυθρού, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 22260/27-10-2015 έγγραφο μας.

Αντί να δρουν υπέρ των συμφερόντων του νοσοκομείου και εν γένει του Δημοσίου Συμφέροντος δρουν υπέρ των ΚΑΡΤΕΛ και μάλιστα σε μία εποχή που η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε δραματική κατάσταση και η ελληνική κοινωνία ματώνει.

Ενώ λοιπόν βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και όχι ο περιορισμός του *...μέσω τεχνικών προδιαγραφών ... που ευνοούν ένα συγκεκριμένο προμηθευτή* με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων και οικονομικότερων τιμών καθώς και ποιοτικότερων υπηρεσιών, οι αρμόδιοι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός θεωρούν ότι το δημόσιο νοσοκομείο είναι τσιφλίκι τους και ότι μπορούν να πετούν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού προκειμένου να υποστηρίξουν το ΚΑΡΤΕΛ της Medical και της Gambro.

Ευλόγως, κάθε νοήμων άνθρωπος, θα απορούσε για την σκοπιμότητα των όρων αυτών:

Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός θέλει ευρεία συμμετοχή και ανάπτυξη ανταγωνισμού στη συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO ;

Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός θέλει ποιοτικότερες υπηρεσίες συντήρησης ;

Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός θέλει οικονομικότερες τιμές και εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ ;

Ή μήπως το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με πρόσχημα δήθεν την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του συντηρητή , θέλει με πάση θυσία την διατήρηση της πολύχρονης παράνομης μονοπωλιακής συνεργασίας, με τον περιούσιο συντηρητή, ανεξαρτήτου ποιότητας και κόστους ;

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαψεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όπως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις των Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 7) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 17), του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχετ. 4) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία).

Τα Νοσοκομεία που θέλησαν πραγματικά και όχι προσχηματικά να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής συντηρητών πέτυχαν και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολύ οικονομικότερες τιμές :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ	158,00 €	29 Μ.Τ.Ν.	20 MTN AK-200S & 9 MTN AK-200 ULTRA S

2.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	172,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S & 1 AK-200 ULTRA S
3.	ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ	165,00 €	2 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S
4.	Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	165,00 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S, 2 MTN AK-200 2 MTN AK-95S
5.	Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170,00 €	11 Μ.Τ.Ν	4 MTN AK-200S, 6 MTN AK-200 & 1 MTN AK-95
6.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ	195,00 €	10 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S
7.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	178,95 €	7 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S
8.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	160,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S & 4 AK-200 ULTRA S
9.	Γ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	162,50 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-95, 3 MTN AK-95S & 1 MTN AK-200S
10.	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	189,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	6 MTN AK-200, 2 MTN AK-95 & 1 MTN AK-200S
11.	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	166,67 €	13 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95, 1 MTN AK-200, & 8 MTN AK-200S
12.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	176,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-10, 1 MTN AK- 100, 2 MTN AK-200, 4 MTN AK-200S & 1 MTN AK-200SU
13.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	177,78 €	7 Μ.Τ.Ν.	3 MTN AK-10, 1 MTN AK-95 & 3 MTN AK-200S
14.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	160,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95S
15.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ	168,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-200S-
16.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ	158,98 €	11 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-200 ULTRA, 6 MTN AK-200, 3 MTN AK-200S & 1 MTN AK-95
17.	251 Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	166,67 €	6 Μ.Τ.Ν.	5 MTN AK-200 & 1 MTN AK-90S

Αν παρόλα αυτά δεν εμπιστεύεστε ούτε τους συναδέλφους σας ούτε τις καλές πρακτικές των άλλων νοσοκομείων, επιτρέψτε μας την απορία:

Προς τι η διαβούλευση και η συγκρότηση επιτροπών επί επιτροπών, όταν μάλιστα οι μισθοί δεν αυγατίζουν πλέον;;;

Κάντε ένα τηλέφωνο **στον κατασκευαστή... αυτός ξέρει...** θα σας στείλει τον ENAN, ΤΟΝ περιούσιο, ΤΟΝ πιο άξιο, ΤΟΝ πιο οικονομικό, ΤΟΝ ταγμένο στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Α. Ενώ το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός γνωρίζει πολύ καλά τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας στην επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού. Αφού η συνεργασία μας με το Νοσοκομείο από το 1986 ποτέ δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα, οράτε αξιολογήσεις των τεχνικών μας από το διευθυντή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (*Σχετ. 18*). Προτίμησε να εμφυτεύσει τους επιπλέον παραπάνω όρους εμβόλιμα και παρενθετικά προκειμένου να μην αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός και στην ουσία να επιτύχει την κεκαλυμμένη απ' ευθείας ανάθεση στον Περιούσιο συντηρητή.

Την ίδια στιγμή που το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού απαιτεί εξουσιοδοτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του οίκου Gambro, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αρεταίειο, το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, το Γενικό Νοσοκομείο Κω, το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο, το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Αμ.Φλέμιγκ, το Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου, το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς, το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αγλ. Κυριακού, το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και άλλα Δημόσια Νοσοκομεία καθώς και ιδιωτικές Κλινικές, θεωρούν

επαρκέστατη τεχνικά την εταιρεία μας, συνεργάζονται μαζί μας και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες και πολύ οικονομικότερες τιμές.

Τα Νοσοκομεία αυτά δεν συναίνεσαν στις καρτελικές μεθοδεύσεις του «περιούσιου» συντηρητή Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, ανέπτυξαν και εκμεταλλεύτηκαν τον υγιή ανταγωνισμό υπέρ του συμφέροντος του Νοσοκομείου τους και Γενικότερα του Δημόσιου συμφέροντος.

Ε.1. Η τεχνική μοναδικότητα της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ

1. Η εν λόγω εταιρεία, έχοντας εφαρμόσει πλήθος παράνομων πρακτικών προκειμένου να εκτοπίσει την εταιρεία μας από την αγορά, τον τελευταίο καιρό εμφανίζει μια νέα Δήλωση του κατασκευαστή οίκου (με ημερομηνία 4/11/14) προς δήθεν επιβεβαίωση όσων παράνομων, αθέμιτων και αντια ανταγωνιστικών επικαλείται η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ στις ψευδό-επιστολές και στα ψευδό-υπομνήματά της.

Επιπλέον ισχυρίζεται τα περί τεχνικής μοναδικότητάς της, τα οποία εδράζει στην κατωτέρω καινοφανή βεβαίωση του πολυεθνικού οίκου Gambro προς αυτήν με ισχύ από 1.1.2014 (όχι παλαιότερα), η οποία λέει ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ότι «*Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών στον εξοπλισμό που φέρει το σήμα Gambro και Hospal σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας απαιτεί πρόσβαση στα συστήματα GFS και SSRGP και είναι αδύνατη χωρίς τέτοιου είδους πρόσβαση*».

2. Η Gambro Lundia AB στη νέα της δήλωση αναφέρει:

1. Η Medical Products Ltd (MP) είναι ο αποκλειστικός μας διανομέας για όλα τα υπό το σήμα Gambro και Hospal μηχανήματα αιμοκάθαρσης και τα μηχανήματα CRRT, τα συστήματα επεξεργασίας νερού τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα για την περιοχή της Ελλάδας και αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος πάροχος τεχνικών υπηρεσιών (εγκατάσταση, εκκίνηση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση, με και χωρίς ανταλλακτικά) για τέτοιου είδους προϊόντα που φέρουν το σήμα Gambro και Hospal.

2. Ως ο αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος μας πάροχος τεχνικών υπηρεσιών, η ΜΡ έχει διαρκή και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στη βάση δεδομένων και στο λογισμικό ιδιοκτησίας μας που ονομάζονται Υπηρεσίες Πεδίου Gambro («GFS») και Πόροι για την Υποστήριξη Συστημάτων των Προϊόντων Gambro («SSRGP»), τα οποία διασφαλίζονται με μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης και διαθέσιμους μόνο στους εξουσιοδοτημένους μας διανομείς καθώς επίσης και πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των ιδιόκτητων διανοητικών και βιομηχανικών μας δικαιωμάτων, της τεχνογνωσίας, της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας.

3. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών στον εξοπλισμό που φέρει το σήμα Gambro και Hospal σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας **απαιτεί** πρόσβαση στα συστήματα GFS και SSRGP και είναι **αδύνατη** χωρίς τέτοιου είδους πρόσβαση.

4. Η ΜΡ είναι εξουσιοδοτημένη να διορίζει υπεργολάβους για την παροχή τέτοιου είδους τεχνικών υπηρεσιών στα προϊόντα υπό το σήμα Gambro και Hospal, που υπόκεινται στην έγκρισή μας, και τέτοιοι κατάλληλα διορισμένοι και εγκεκριμένοι υπεργολάβοι επίσης αποκτούν πρόσβαση στο GFS και στο SSRGP.

Αυτή η δήλωση ισχύει από 01/01/2014 έως 31/12/2015

Lund, 4 Νοεμβρίου 2014

Υπογραφή

Klas Arildsson

Γενικός Διευθυντής

Gambro Lundia AB

Αναρωτιέται ευλόγως ο καθένας, **ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ GAMBRO ΔΕΝ ΙΣΧΥΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-2014;;;**

Η απάντηση είναι ότι μέχρι τις αρχές του 2014, οπότε καθαρογράφηκε η υπ' 5667/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με βάση την οποία υποχρεώθηκε η εταιρεία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» να μας πουλάει ανταλλακτικά, το ΚΑΡΤΕΛ είχε επικεντρώσει την προσπάθεια εξοβελισμού της εταιρείας μας στο παράνομο μπουκοτάζ μας σε ανταλλακτικά (πού θα πάει...; θα κλείσουν).

Μέχρι το 2014, αυτοί που μας στερούσαν τα ανταλλακτικά (ο κατασκευαστικός οίκος Gambro και η εδώ ενιστάμενη), μας κατηγορούσαν ενώπιον των Δημόσιων Νοσοκομείων ότι πρέπει να αποκλειόμαστε από τους δημόσιους διαγωνισμούς, γιατί δεν διαθέτουμε ανταλλακτικά που αυτοί μας στερούσαν!!!

Από το 2014 και μετά, οπότε επήλθε η δικαστική μας δικαίωση, αναγκάζονται πλέον να αναπροσαρμόσουν τις παράνομες πρακτικές τους εις βάρος μας, διαμορφώνοντας δολίως το περιεχόμενο των ισχυρισμών και βεβαιώσεων προς τα Δημόσια Νοσοκομεία και λέγοντας για πρώτη φορά περί τεχνικής μοναδικότητας.

Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 η κατασκευάστρια εταιρεία Gambro Lundia AB στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπου η εταιρεία μας κατέφυγε για τη δικαίωση της:

Στις 13/2/2012 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«25.3 Ο μάρτυς της αιτούσας κατέθεσε ότι και μετά την καταγγελία της σύμβασης υπεργολαβίας της με την 2^η καθ' ης, η αιτούσα εξακολούθησε να μετέχει σε διαγωνισμούς Νοσοκομείων για τη συντήρηση και συνήψε πράγματι, όπως λέει, νέες τέτοιες συμβάσεις, που σημαίνει ότι και ανταλλακτικά έχει και βεβαιώσεις από εμάς δεν χρειάζεται αφού την επάρκειά της την γνωρίζουν ήδη τα Νοσοκομεία.»

Στις 19/8/2011 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών :

«Με αυτό το δεδομένο, η αιτούσα είχε (και έχει) απόλυτη ελευθερία να συντηρεί εκτός από τα προϊόντα της GAMBRO και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ακόμα και ανταγωνιστικά».

Ιδού τι αναφέρουν τα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια χρήσης της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρείας Gambro Lundia AB:

«Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός είναι ένας τεχνικός που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96 από τη Gambro και διαθέτει πιστοποίηση από τη Gambro ή έχει αποκτήσει ισάξια εμπειρία με παρόμοιο τρόπο.

(ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96, Σχετ. 19).

Για τον εκπαιδευόμενο τεχνικό διατίθεται το Εγχειρίδιο Σέρβις AK 200. Το Εγχειρίδιο Σέρβις παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος.

Οι προληπτικές επιθεωρήσεις, συντήρηση και βαθμονόμηση του AK 200 θα γίνονται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Σέρβις του AK 200, το Εγχειρίδιο Συντήρησης HCEN9164 τα οποία μπορούν να παραγγελθούν από τον αντιπρόσωπό σας της Gambro. Η περιοδική συντήρηση πρέπει να γίνεται μετά από 2500 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον ανά έτος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200 ορ.man. HCEL9761.Rev.12.1999 program verison 4.xx σελ. 1:3 και 1:4, Σχετ. 20).

Για τον έμπειρο τεχνικό, υπάρχει διαθέσιμο το Εγχειρίδιο Επισκευής του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S. Το Εγχειρίδιο Επισκευής παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8, Σχετ. 21).

Επάρκεια Μηχανικών Service

Υπάρχει ένα ορισμένο ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για τους Μηχανικούς service που συντηρούν και επισκευάζουν προϊόντα Gambro, και συνοψίζεται ως εξής:

Ένας μηχανικός συντήρησης θεωρείται κατάλληλα ειδικευμένος, αν αυτός / αυτή έχει:

1. Παρακολουθήσει τεχνικό σεμινάριο για AK 200 S / AK 200 ULTRA S και του έχει δοθεί ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο τεχνικός έχει περάσει το μάθημα.
2. Πρόσβαση στο συνιστώμενο εξοπλισμό δοκιμών και τα ειδικά εργαλεία που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο service.

3. Πρόσβαση στα συνιστώμενα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στο AK 200S / AK 200 ULTRA S – Spare Parts List, HCEN 9288.
4. Πρόσβαση και κατανόηση στο εγχειρίδιο Χρήσης AK 200 S / AK 200 ULTRA S- (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο συντήρησης HCEN12395 Revision 02.2010 program version 10.xx σελ. 1:5, νομίμως μεταφρασμένη (Σχετ. 22)).

Η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία πιθανόν ,έχοντας πλήρη επίγνωση των θεμάτων, δεν χρειάζεται να πάρει κανένα ρίσκο και προσέχει σχετικά , αφού ούτως ή άλλως, υπάρχουν υποψήφιοι «αρμόδιοι» των Νοσοκομείων που μπορούν να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά», θέτοντας παράνομους όρους στους διαγωνισμούς κι έτσι δεν χρειάζεται να παρανομήσει η ίδια.

Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Στις 19/8/2011 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«1.3. με μη νόμιμο Β' αίτημα (χορήγησης βεβαίωσης εξουσιοδοτημένου – πιστοποιημένου παρόχου) κατά της Α' καθής, αφού με αυτό ζητά κάτι που ήδη έχει, ώστε να ελλείπει παντελώς το έννομο συμφέρον (πρόδηλα και οιοδήποτε κατεπείγον) να διαταχθεί αυτό με προσωρινή διαταγή».

«1.6. τέλος, χωρίς ορισμένη επίκληση κινδύνου (δεν συνιστά τέτοια επίκληση η περί «42 εκκρεμών συμβάσεων» που επιβάλουν «διαρκή παροχή υπηρεσιών», αφού η αιτούσα μπορεί ανά πάσα στιγμή να προμηθευτεί από εμάς όποια ανταλλακτικά επιθυμεί για τις εκκρεμείς της συμβάσεις, και παραμένει πιστοποιημένη γι' αυτές».

(Αιτούσα είναι η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ)

Σας αποκαλύπτουμε τις «*συντηρήσεις... επί χάρτου*» που έκανε η εν λόγω εταιρεία, τις οποίες διαπιστώσαμε, διαδεχόμενοι αυτήν στη συντήρηση των μηχανημάτων Gambro στα νοσοκομεία:

Α. Περίπτωση Νοσοκομείου Ρεθύμνου

- Τα μηχανήματα είχαν την εικόνα ασυντήρητων ή πλημμελώς συντηρημένων μηχανών, οι οποίες παρουσίαζαν δυσλειτουργίες.

- Στα μηχανήματα είχαν τοποθετηθεί ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που ο κατασκευαστής τοποθετεί και περιγράφει στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια των μηχανημάτων (Φίλτρα πιπετών K14944001 αντί K1085701).
- Ανταλλακτικά που έχρηζαν αντικατάστασης, δεν είχαν αντικατασταθεί, είτε σε προληπτική συντήρηση (φίλτρα αέρος είχαν να αντικατασταθούν πλέον του έτους), είτε σε επανορθωτικές συντηρήσεις – αποκαταστάσεις βλαβών (γλωσσίδες ορισμένων βαλβίδων).
- Χρήση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών από μηχανήματα του Νοσοκομείου Χανίων.
- Τηλεφωνική ή άλλη τεχνική στήριξη - αναγγελία βλάβης από άλλη εταιρεία (Τεχνοϊατρική-Δουλγκερης) πέραν της εταιρείας που είχε αναλάβει την συντήρηση (MEDICAL PRODUCTS).
- Ακύρωση λειτουργιών σε μηχανήματα λόγω βλάβης (ακύρωση λειτουργίας αντλίας ηπαρίνης), μονάδα πιεσομέτρου (BPM) το οποίο παρέμενε χαλασμένο και απενεργοποιημένο πάρα πολύ καιρό. Αυτό δε αντικατεστάθη από τον προηγούμενο συντηρητή Medical Products μόλις στις 24/9/2014 και ενώ ήδη ήταν συντηρητής η εταιρεία μας από τον Ιούλιο του 2014.
- Μηχάνημα που έμεινε εκτός λειτουργίας αρκετό καιρό λόγω έλλειψης ανταλλακτικού !!

B. Περίπτωση Νοσοκομείου Καρδίτσας

- Υπάρχουν φθαρμένα εξαρτήματα τα οποία έχρηζαν αντικατάστασης ήδη από το χρόνο της προηγούμενης σύμβασης συντήρησης και δεν έχουν αντικατασταθεί από τον προηγούμενο συντηρητή. (καπάκια αντλιών αίματος K19693A, K19693B).
- Έχουν τοποθετηθεί εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που ο κατασκευαστής τοποθετεί και ορίζει σε συγκεκριμένα σημεία του μηχανήματος (Φίλτρα πιπετών, Air Detector Door).
- Παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές στα εξωτερικά κελύφη μηχανημάτων ενώ μερικά είναι σπασμένα.
- Διαπιστώθηκαν αυθαίρετες μετατροπές σε μηχανήματα που στην καλύτερη περίπτωση ακυρώνουν λειτουργικές δυνατότητες των μηχανημάτων. Κάποιες μετατροπές συνιστούν υποβάθμιση (παράκαμψη βάσης select cart) ενώ άλλες

είναι επικίνδυνες (μερική παράκαμψη του 1ου υπερφίλτρου στα AK-200 ULTRA S).

Γ. Περίπτωση Νοσοκομείου Πύργου

- Υπήρχαν φθαρμένα και σπασμένα εξαρτήματα τα οποία έχρηζαν αντικατάστασης ήδη από το χρόνο της προηγούμενης σύμβασης συντήρησης και δεν είχαν αντικατασταθεί από τον προηγούμενο συντηρητή (βάση συγκράτησης αρτηριακού ποτηριού MULTIHOLDER K20397001 σε τρία μηχανήματα και LUNDIA ARM K15541B σε ένα μηχάνημα).
- Εφεδρικά μηχανήματα, τα οποία παρουσίαζαν αδικαιολόγητες βλάβες, δεδομένου ότι είχαν συντηρηθεί από τον προηγούμενο συντηρητή Medical Products.
- Χαλασμένοι αισθητήρες πίεσης από άλλα μηχανήματα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε εφεδρικό μηχάνημα, με συνέπεια να μένει χαλασμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ανακριβείς τεχνικά δελτία (εκθέσεις service) που εμφανίζουν να τοποθετείται εξάρτημα σε κάποιο μηχάνημα, ενώ διαπιστώνεται ότι είναι τοποθετημένο σε άλλο μηχάνημα της M.T.N.
- Δεν υπάρχουν σε κανένα μηχάνημα δύο πανάκριβες κάρτες FM CPU BOARD K40078005 και BM CPU BOARD K40079001R, ενώ δηλώνονται σε εκθέσεις service ότι έχουν αντικατασταθεί.
- Χρήση ανταλλακτικών από εφεδρικό μηχάνημα του Νοσοκομείου σας και όχι καινούργιων - αμεταχείριστων, ως είχε συμβατική υποχρέωση η συντηρήτρια.
- Κίνδυνος μόλυνσης «μη θετικών» μηχανημάτων από την τοποθέτηση σ' αυτά ανταλλακτικών που προέρχονται από εφεδρικό μηχάνημα το οποίο είναι θετικό.
- Εκτός λειτουργίας μηχανήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδικαιολόγητα, και κατά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Δ. Περίπτωση Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλ. Κυριακού»

- Εικόνα μηχανημάτων πλημμελώς συντηρημένων ή ασυντήρητων μηχανημάτων για μακρό χρονικό διάστημα, πολύ μεγαλύτερο από την

τελευταία συντήρηση που αναφέρεται στις τεχνικές εκθέσεις που έκδωσε η προηγούμενη συντηρήτρια εταιρεία Ιατρικά προϊόντα ΕΠΕ.

- Τα φίλτρα των πιπετών (K10857001) καθώς και τα φίλτρα υγρού (K14944001) ήταν σε κακή κατάσταση.
- Οι σωλήνες των συνδετικών (connectors) που διανέμουν το έτοιμο διάλυμα στο φίλτρο αιμοκάθαρσης παρουσίαζαν φθορά, είχαν χρώμα καφέ -κόκκινο όταν υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι διάφανοι.
- «ΑΣυνήθιστες» και υπερβολικά μεγάλες αποκλίσεις αγωγιμότητας που επηρεάζουν την τελική σύσταση του υγρού αιμοκάθαρσης και δεν παρατηρούνται σε μηχανήματα συντηρημένα προ εξαμήνου.
- Μονάδα του συστήματος τεχνητού νεφρού AK100 που χρησιμοποιείται σε έκτακτες αιμοκαθάρσεις στην ΜΕΘ, να είναι ασυντήρητη και να δυσλειτουργεί, παρ' όλες τις διαβεβαιώσεις της συντηρήτριας εταιρείας των μηχανημάτων Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (Medical Products).
- Μηχανήματα πλημμελώς συντηρημένα ή ασυντήρητα, αδικαιολόγητα και κατά παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, σε ένα νοσοκομείο που πρέπει να εξυπηρετήσει νεφροπαθή ΠΑΙΔΙΑ!!!

Οι αυθαίρετες μετατροπές, τα διαφορετικά ή λάθος εξαρτήματα, η μη αντικατάσταση φθαρμένων και σπασμένων εξαρτημάτων καθιστούν τη λειτουργία των μηχανημάτων προβληματική και καταργούν και καταπατούν κάθε έννοια συντήρησης προληπτικής ή επανορθωτικής, όπως αυτή περιγράφεται στις αναλυτικές οδηγίες του κατασκευαστή στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια των μηχανημάτων.

Αν δεν βιάναμε στο πετσί μας το αδιάτακτο ΚΑΡΤΕΛ του πολυεθνικού οίκου Gambro και της ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, θα απορούσαμε ευλόγως πώς είναι δυνατόν ο κατασκευαστής οίκος να μην *τραβάει το αυτί* του *περιούσιου* συντηρητή του (Ιατρικά Προϊόντα) για την άθλια κατάσταση των μηχανημάτων, την οποία θα έπρεπε να γνωρίζει σύμφωνα με το διαφημιζόμενο σύστημα GFS.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η εταιρεία μας βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες παράνομες πρακτικές και καρτελικές μεθοδεύσεις από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ με αιτιάσεις όπως «..η ΣΕΡ.ΚΟ δεν έχει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή οίκο ή δεν έχει πρόσβαση στις αναβαθμίσεις για να μετέχει στους διαγωνισμούς κλπ.».

E.2. Ο πανικός της ... για τους νεφροπαθείς ρε γαμώτο!

Η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ευρισκόμενη σε μεγάλο πανικό να βλέπει την εταιρεία μας, όχι μόνο να μην έχει εξοβελιστεί από την αγορά (παρά τις παράνομες πρακτικές που υφίσταται), αλλά να συμμετέχει ισότιμα στους δημόσιους διαγωνισμούς και να κερδίζει επάξια αυτούς, εφηύρε εσχάτως την μεθόδευση της μη ανάγκης δήθεν διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών (μην διενεργείτε διαγωνισμούς, δώστε τους απευθείας σε εμάς. **για τους νεφροπαθείς ρε γαμώτο!**), επικαλούμενη αλυσιτελώς και αποσπασματικά την Οδηγία 2004/18.

Συγκεκριμένα, ενώ επικαλείται το άρθρο 31 της παραπάνω Οδηγίας, το οποίο ούτως ή άλλως αφορά *όλως εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να ερμηνεύονται στενά* (C-328/92 σκέψεις 15 και 16), αποφεύγει να μνημονεύσει το άρθρο 48 της Οδηγίας που απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής ικανότητας των οικονομικών φορέων, μεταξύ των οποίων δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους (το οποίο αποτελεί γι' αυτή επαρκή λόγο εξάλειψης των δημόσιων διαγωνισμών υπέρ της ίδιας).

Έτι περαιτέρω, η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, έχοντας κακομάθει στη μονοπώληση των διαγωνισμών ενόσω μπούκόταρε την πώληση ανταλλακτικών στην εταιρεία μας, στηρίζει χωρίς την παραμικρή αιδώ το επιχείρημα της ανάγκης δήθεν εξάλειψης των δημόσιων διαγωνισμών όσον αφορά τα μηχανήματα Gambro, στην παράνομη άρνηση του κατασκευαστικού οίκου να γνωστοποιεί προς τους χρήστες των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού τις αναγκαίες βελτιώσεις (άρθρο 13 παρ. 6, δ' Οδηγίας 42/1993), εκβιάζοντας έτσι ωμά τα νοσοκομεία, προκειμένου να αποσπάσει μονοπωλιακά το οικονομικό όφελος μέσω της διενέργειας απευθείας αναθέσεων.

Λησμονεί, όμως, ότι η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro αδιάλειπτα επί ολόκληρες δεκαετίες (ακόμα και ενόσω διαρκούσε το μπούκοτάζ εις βάρος της, στο βαθμό που το επέτρεπαν τα αποθέματά της), έχοντας αποσπάσει όλα αυτά τα χρόνια εύσημα για το επίπεδο των υπηρεσιών της, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αγορά επισκευής και συντήρησης των εν λόγω μηχανημάτων αποτελεί αγορά εντός της οποίας **υφίσταται ανταγωνισμός**, καθώς δραστηριοποιούνται περισσότερες από μία εταιρείες.

Σημειωτέον, δε, ότι αραδιάζει για λόγους εντυπωσιασμού μια σειρά από αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποκρύβοντας ότι καμία από τις επικαλούμενες αποφάσεις δεν δικαιώνει το επιχείρημα παρέκκλισης

από την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών. Λχ. η απόφαση 86/2009 του IV τμήματος του ΕΛΣυν δέχεται ότι η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, στην αγορά υπάρχει ένας μόνον πάροχος των υπό ανάθεση υπηρεσιών, με συνέπεια να καθίσταται ατελέσφορη η, διά της προκήρυξης διαγωνισμού, αναζήτηση άλλων προσφορών, προϋπόθεση όμως που δεν συνέτρεχε καθώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, **μόνη η ιδιότητα της φερομένης ως δικαιούχου εταιρίας ως κατασκευάστριας των μηχανογραφικών προγραμμάτων δεν αρκεί για να την καταστήσει το μοναδικό πάροχο των υπηρεσιών συντήρησής τους.** Έτσι, εκρίθη παράνομη η απευθείας ανάθεση του έργου της συντήρησης μηχανογραφικών προγραμμάτων του ΟΓΑ σε συγκεκριμένη εταιρεία και δεν θεωρήθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε., θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπανανία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Πιθανόν η μέθοδος, να χρησιμοποιεί και να επικαλείται νόμους και ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειμένου να πείσει τα νοσοκομεία για τη νομιμότητα των παράνομων και βρόμικων καρτελικών πρακτικών της, να είναι η ίδια δοκιμασμένη μέθοδος που για δεκαετίες έπειθε και κατάφερνε και πουλούσε τα φίλτρα τεχνητού νεφρού στα 50 € το ένα έναντι των 7 € με 8 € που πουλιόντουσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, ή το απλό κιτρικό που στο μπακάλη της γειτονιάς κοστίζει μόλις 2 € το κιλό (1κιλό = 1000 γραμμάρια) αυτή πουλούσε και πουλάει τα 32 γραμμάρια εντός της ειδικής συσκευασίας (CLEAN CART C) με διαφορά τιμής πολλές χιλιάδες τοις εκατό (ορ. λχ. φίλτρα τεχνητού νεφρού **Σχετ. 23 & 24**, υλικά **CLEAN CART C** και **CLEAN CART A Σχετ. 25**).

Ε.3. Οι συντηρήσεις των Ιατρικών Μηχανημάτων σε όλο τον κόσμο και ο διπλός ρόλος (πρόσωπο) των αρμοδίων του Ευαγγελισμού

Οι συντηρήσεις των Ιατρικών Μηχανημάτων

Σε όλον τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή in house) (ορ. σχετικές εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, *Σχετ. 26*).

Στις 15.9.2014, έλαβε χώρα στην Αθήνα επιστημονική ημερίδα από την Ελληνική Εταιρεία Βιοιατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) με θέμα *«Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού και Πιστοποίηση Κλινικών Μηχανικών»*, την οποία παρακολούθησαν πλήθος στελεχών των τμημάτων βιοιατρικής τεχνολογίας των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, **συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου σας**. Σε αυτήν μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών ήταν και ο Κος Κοτσοβόλης, εκπρόσωπος της εταιρείας MESA που δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητη επισκευάστρια ιατρικών μηχανημάτων σε αρκετές χώρες, ο οποίος παρουσίασε την αγορά της συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων τόσο για την Αμερική όσο και για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA). Σύμφωνα με την εισήγησή του (*Σχετ. 27*) στην αγορά της Αμερικής οι υπηρεσίες συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων κατανέμονται ποσοστιαία μεταξύ εξουσιοδοτημένων παρόχων (OEMs), ανεξάρτητων παρόχων (ISOs) και τεχνικών υπηρεσιών των πελατών ιατρικών μηχανημάτων – νοσοκομείων ως επί το πλείστον (internal) ως εξής:

29%-36% εσωτερικά - internal

34% - 37% μέσω ISOs και

30% - 34% μέσω OEMs

Στην αγορά EMEA (Ευρώπη – Μέση Ανατολή – Αφρική) τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

10% - 12% εσωτερικά-internal,

3% - 5% μέσω ISOs και

82%-87% μέσω OEMs

Ακολούθησε θετικός σχολιασμός από τον Πρόεδρο της ΕΛΕΒΙΤ Κο Παληκαράκη, σχετικά με την δραστηριοποίηση των ανεξάρτητων εταιρειών service στα Ιατρικά Μηχανήματα, την ανάπτυξη ανταγωνισμού και τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που μπορούν να έχουν τα δημόσια νοσοκομεία.

Επίσης, πιο πριν ως κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ο Κος Saide Calil, Καθηγητής του State University of Campinas, Brazil και Πρόεδρος του Clinical Engineering Division της IFMBE στην ομιλία του με θέμα:

“Clinical Engineering Certification: do we need it?”

Ανέπτυξε θέματα όπως:

- Τι προβλέπει η νομοθεσία διεθνώς για την πιστοποίηση των κλινικών μηχανικών.
- Αν χρειάζεται η πιστοποίηση των κλινικών μηχανικών.
- Συστήματα πιστοποίησης κλινικών μηχανικών.

Ο διπλός ρόλος και τα δύο διαφορετικά πρόσωπα των αρμοδίων του Ευαγγελισμού.

Η παραπάνω παρουσίαση του Κου Κοτσοβόλη εκπροσώπου της εταιρείας MESA έγινε στα πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης που έλαβε χώρα κατά την άνω ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) με πρόεδρο αυτής τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Ευαγγελισμού» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΒΙΤ (Αντιπρόεδρος) Κο Β. Α. Γκέρκη (*Σχετ. 28*).

Επίσης παρόν στην άνω ημερίδα ήταν και ο προϊστάμενος του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του «Ευαγγελισμού» Κος Δ. Μπιρμπιλόπουλος.

Έτσι από τη μια βλέπουμε τους πλέον αρμόδιους του «Ευαγγελισμού» πέραν κάθε αμφισβήτησης:

- Να είναι γνώστες για το τι γίνεται διεθνώς στην αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων.
 - Να είναι γνώστες για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού που υφίσταται σε όλο τον κόσμο στην αγορά της συντήρησης και επισκευής των Ιατρικών Μηχανημάτων.
- και από την άλλη με κάθε τρόπο μέσω εμφύτευσης τεχνικών προδιαγραφών, ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής –

συμμετοχής προκειμένου να διατηρηθούν πάση θυσία τα ασύμφορα και παράνομα μονοπώλια των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων τους.

Συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του επιστημονικού σωματίου ΕΛΕΒΙΤ, όπου μεταξύ άλλων, μέσω των επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων που οργανώνει, προάγει την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και ενημερώνει τόσο για την διεθνή όσο και την εθνική νομοθεσία σχετικά με τις συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων.

Αλλά συγχρόνως ως αρμόδια στελέχη του Ευαγγελισμού εργάζονται με κάθε τρόπο προκειμένου να υποστηριχθούν και να διατηρηθούν τα παράνομα μονοπώλια των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων τους κατακρεουργώντας και αφανίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό.

Τα ίδια πρόσωπα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ευαγγελισμού Δ. Μπιρμπιλόπουλος και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ευαγγελισμού Β. Α. Γκέρκης, εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευαγγελισμού, με πρόσχημα ΔΗΘΕΝ την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, την με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ σύναψη σύμβασης Συντήρησης με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αξίας 47.601,00 € (Σχετ. 3). Γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το συμφέρον του Νοσοκομείου και το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, παραβαίνοντας Νομοθεσίες και Κανονισμούς Προμηθειών Δημοσίου.

Ωσάν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού να τα βγάζουν από την τσέπη τους και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός να είναι τσιφλίκι τους, κάνουν πάρτι εις υγείαν των κοροϊδών πετώντας στην κυριολεξία χιλιάδες ευρώ.

Κατόπιν τούτων, και με την πικρή αίσθηση που μας αφήνει η παρούσα διαδικασία, σας καλούμε να αναλογιστείτε το ρόλο σας ως ex officio εγγυητές του δημοσίου συμφέροντος, άλλως θα σας συμβουλεύαμε να μεταπηδούσατε από τον γκρίζο και άχαρο τομέα των τεχνικών προδιαγραφών των δημοσίων συμβάσεων στον καλλιτεχνικό χώρο της φωτογράφισης, όπου η ικανότητά σας είναι απaráμιλλη.

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού από το 1976. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία μας ήταν το μοναδικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών της Gambro στην Ελλάδα, καθώς και ο αποκλειστικός διανομέας ανταλλακτικών. Ουδέποτε όμως χρησιμοποιήσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε την ιδιότητα μας αυτή για να μονοπωλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αθέμιτα την Ελληνική Αγορά των επισκευών και συντηρήσεων των Μ.Τ.Ν. του οίκου Gambro. Αντιθέτως δίναμε απλόχερα σε όποιον μας ζητούσε τόσο τα ανταλλακτικά όσο και την τεχνολογία της Gambro, ως αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη εταιρεία που ήμασταν, χωρίς να δημιουργούμε το παραμικρό εμπόδιο εισόδου και παραμονής σε κανέναν στην εν λόγω αγορά.

Η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (MEDICAL) έχει αποδυθεί σε απόλυτη σύμπνοια και συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο Gambro Lundia AB (GAMBRO) επί τετραετία και πλέον, σε ανηλεή εμπορικό πόλεμο κατά της εταιρείας μας με αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές, προκειμένου να πετύχει την μονοπώληση της ελληνικής αγοράς παροχής υπηρεσιών service στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του ως άνω κατασκευαστικού οίκου, επί ζημία του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Επί των ως άνω παράνομων πρακτικών και επιδιώξεων των δύο εταιριών έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011, η GAMBRO παράνομα και αντισυμβατικά έπαψε να μας τροφοδοτεί με ανταλλακτικά και μας παρέπεμψε στη Medical, τον νέο διανομέα της ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά. Πλην, όμως αργότερα και η Medical διέκοψε την τροφοδοσία της ΣΕΡΚΟ, την οποία όπως μας δήλωσε (προσχηματικά όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων) θα διατηρούσε μόνο για τις εκκρεμείς συμβάσεις μας. Εν συνεχεία, στις 16 Φεβρουαρίου του 2012 η GAMBRO, σε πλήρη σύμπλευση με τη MEDICAL κλιμακώνοντας τις αντιανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές τους, αιφνιδίως διέκοψε στη ΣΕΡΚΟ την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματά της προκειμένου να δυναμιτίσει την παροχή υπηρεσιών από μέρος μας.

Η εταιρεία μας προσέφυγε αμέσως στη Δικαιοσύνη, η οποία δια της υπ' αριθμ. 5667/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απεφάνθη μεταξύ άλλων κατά το διατακτικό της:

- *ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ* ότι η άρνηση της δευτέρης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «*Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ*» και το διακριτικό τίτλο «*Medical Products Ltd*», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «*ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service)*» και το διακριτικό τίτλο «*SER.CO LTD*» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.
- *ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ* τη δευτέρα εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «*Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ*» και το διακριτικό τίτλο «*Medical Products Ltd*» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «*ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service)*» και το διακριτικό τίτλο «*SER.CO LTD*», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπτώξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Η εταιρεία μας είναι από τις λίγες εξαιρέσεις στην ελληνική αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων που προσπαθεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάποια νοσοκομεία ενώ βλέπουν ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων δεν αναπτύσσεται καθόλου ανταγωνισμός και λειτουργεί το απόλυτο μονοπώλιο προσπαθούν, αντί να

συνδράμουν στην ανάπτυξη ανταγωνισμού και στο άνοιγμα της αγοράς και σε μικρές εταιρείες όπως η εταιρεία μας, να προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες υπέρ της στεγανοποίησης της αγοράς, βοηθώντας και συμμετέχοντας στις εναρμονισμένες παράνομες αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές των πολυεθνικών κατασκευαστών και των βραχιόνων τους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε Διαγωνισμό Δημόσιου Νοσοκομείου για την συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στον οποίο δεν συμμετείχαμε, λόγω του παράνομου μποϊκοτάζ προμήθειας ανταλλακτικών, που προαναφέραμε, και έχουμε ήδη δικαιωθεί, η διαφορά - ζημιά - για το Δημόσιο συμφέρον φθάνει τις 13.500 €, παραπάνω κόστος από τη μονοπωλιακή σύμβαση που υπέγραψε με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Σε όλο τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή inhouse). (βλ. αντίστοιχες εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) (Σχετ. 26).

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε. και της Gambro, θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπανανία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε κοινοποιήσει και είναι εν γνώση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, καθώς και μέσω των καταγγελιών μας και Αγωγών είναι εν γνώση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Οράτε ενδεικτικά:

Στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-

2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3225/21-8-2015, Αρ. πρωτ. 3296/31-8-2015.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας: Αρ. πρωτ. 2210/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2211/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2335/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 2336/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 321/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 406/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 621/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 622/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 1009/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1010/5-5-2015, Αρ.

πρωτ. 1011/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1207/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1208/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1209/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2259/1-9-2015.

Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Αρ. πρωτ. 2280/22-5-2014, Αρ. πρωτ. 2344/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2345/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2427/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2624/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 2793/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 2887/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 2888/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3222/30-7-2014, Αρ. πρωτ. 3255/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 3588/4-9-2014, Αρ. πρωτ. 3938/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 3993/26-9-2014, Αρ. πρωτ. 4086/2-10-2014, Αρ. πρωτ. 4170/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4169/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4218/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 4247/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 4666/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 5401/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5402/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5403/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5404/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5405/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5406/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 658/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 659/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 842/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 1140/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1142/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1963/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1964/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1965/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1966/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1967/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 2213/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2214/19-5-2015 Αρ. πρωτ. 2215/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3742/1-9-2015.

Στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης: Αρ. πρωτ. 23836/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 25335/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 26642/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 26643/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 27771/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 27772/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 3387/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 4175/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 5611/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 5613/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 9919/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9920/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9922/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9923/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9924/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 11347/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11348/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11350/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 19222/1-9-2015.

Πράγματι, βέβαια, η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό του Νοσοκομείου σας **γεννά σοβαρότατους κινδύνους**, αλλά για το ίδιο το ΚΑΡΤΕΛ του πολυεθνικού οίκου Gambro και της ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, βλέποντας το παράνομο μονοπώλιό τους σιγά σιγά να καταρρέει...

Προς επιπλέον απόδειξη ότι τα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία απαιτούν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες και δεν τάσσονται υπέρ του παράνομου ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αλλά υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ απορρίπτοντας τις παράνομες πρακτικές του ΚΑΡΤΕΛ, σας παραθέτουμε λίστα με τα Δημόσια Νοσοκομεία που προσφάτως έχει συνάψει συμβάσεις η εταιρεία μας, και είμαστε στη διάθεσή σας, μόλις μας ζητηθεί, να σας προσκομίσουμε και τα πρακτικά κατακύρωσης – συμβάσεις, παρόλο που αυτά είναι δημόσια διαθέσιμα από την εφαρμογή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ :

- 1) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- 2) Γ. Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ
- 3) Γ. Νοσοκομείο –Κ.Υ. Κω
- 4) Γ. Νοσοκομείο Φιλιατών
- 5) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
- 6) Γ. Νοσοκομείο Λευκάδας
- 7) Γ. Νοσοκομείο Καλύμνου
- 8) Γ. Νοσοκομείο Λιβαδειάς
- 9) Γ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
- 10) 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
- 11) Γ. Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- 12) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
- 13) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΠΚ
- 14) Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας
- 15) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κύμης
- 16) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- 17) Γ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου
- 18) Γ. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
- 19) Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας
- 20) Γ. Νοσοκομείο Πύργου
- 21) Γ. Νοσοκομείο Αγρινίου
- 22) Γ. Νοσοκομείο Ρεθύμνου
- 23) Γ. Νοσοκομείο Πρέβεζας
- 24) Γ. Νοσοκομείο Λασιθίου
- 25) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου
- 26) Γ. Νοσοκομείο Χίου
- 27) Γ. Νοσοκομείο Σύρου
- 28) Γ. Νοσοκομείο Λαμίας
- 29) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Επιπλέον για να γίνει περισσότερο αντιληπτό από το Νοσοκομείο σας, το μέγεθος του πλιάτσικου από το συγκεκριμένο ΚΑΡΤΕΛ, σας γνωστοποιούμε ενδεικτικά πόσο πωλούνται αντίστοιχα, σε άλλες χώρες, τα ανταλλακτικά:

Κ40280001 AC/DC UNIT AK200S:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 350,00€ ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 2.069,65 €.

Κ11845A Level Transducer:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 36,00 € ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 246,72 €.

Κ40228003 Pressure transducer kit compl.:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 112,00 € ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 715,48 €.

Ανταλλακτικό που άλλες χώρες το αγοράζουν 112 € στην Ελλάδα πουλιέται από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ 715,48 €. Το ίδιο πράττει η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και με τις τιμές των αναλωσίμων τεχνητού νεφρού,

Έτσι το Φίλτρο Τεχνητού Νεφρού που το κόστος του δεν υπερβαίνει το 1 € και άλλες χώρες το αγοράζουν 6 - 8 € στην Ελλάδα σήμερα πουλιέται 28 € και παλιότερα 50 €.

Με βάση δημοσιεύματα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο της περιόδου Ιουλίου 2014 σχετικά με έρευνα του εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Κου Δημόπουλου :

«Σύμφωνα με την καταγγελία, τα φίλτρα αιμοκάθαρσης στα ελληνικά νοσοκομεία πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονται από 23 έως 30 ευρώ, όταν την περίοδο αυτή στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπερβαίνουν τα 15 ευρώ. Παλιότερα δε, οι τιμές τους είχαν εκτοξευτεί στα 50 ευρώ το ένα, παρότι το κόστος παρασκευής των υλικών αυτών υπολογίζεται ότι μετά βίας να ξεπερνούσε το 1 ευρώ!!

Ο κ. Εισαγγελέας, ζητά να εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου από την πλευρά των ιδρυμάτων, αλλά και τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και το ενδεχόμενο να έχει τελεστεί το αδίκημα

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Δεν αποκλείεται παράλληλα να γίνουν έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων, καθώς οι καταγγέλλουσες πηγές ανέφεραν ότι υποστηρίζουν πως από τις συγκεκριμένες προμήθειες μέλη νοσοκομείων “εισπράττουν ποσοστά”», αναφέρεται σε σχετικό επίσημο ερώτημα αρ. πρωτ. 1200/17-7-2014 των βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδα προς τον υπουργό υγείας (Σχετ.24).

Για το καρτέλ στο χώρο του Τεχνητού Νεφρού, έχει μιλήσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας Κος Α. Σαμαράς από το βήμα της Βουλής στις 12/11/2012: «Τα Ελληνικά νοσοκομεία αγόραζαν ως πρόσφατα τα φίλτρα για τις μονάδες τεχνητού νεφρού προς 35 ευρώ το ένα. Την ίδια στιγμή στην Κύπρο και σε άλλες χώρες τα ίδια φίλτρα έκαναν προς 8 ευρώ το ένα! ... Αυτό πια κόβεται με το μαχαίρι...».(Σχετ. 23).

"Σύμφωνα με την καταγγελία, όλες οι προμηθεύτριες εταιρίες συμφώνησαν να διαθέτουν τα υλικά, στην ίδια υψηλή τιμή και συνέστησαν offshore εταιρία, με τη συμμετοχή γιατρών από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και την Αθήνα."

Πηγή: <http://www.onmed.gr/ygeia-politiki/item/316153-sta-xeria-tou-eisaggelea-i-yprothesi-gia-to-kartel-tou-texnitoy-nefroy#ixzz3Fg1ycufs>

Κατόπιν τούτων, η συμβολή των Δημόσιων Νοσοκομείων και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει να είναι καθοριστική στην αποτροπή εγκαθίδρυσης παράνομων μονοπωλιακών καταστάσεων στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων, με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη του Δημόσιου Συμφέροντος μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται απλοί παρατηρητές και ακόμη περισσότερο συμμετοχοί στο «τεράστιο πάρτυ» των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Τέλος, εφόσον η παρούσα διαβούλευση δεν είναι προσχηματική (ή πάψει να είναι προσχηματική) και υπάρχει (υπάρξει) πραγματική βούληση – πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και της μέγιστης δυνατής ανάπτυξης ανταγωνισμού,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι, για πρώτη φορά:

- το σταμάτημα των ασύμφωνων μονοπωλιακών συνεργασιών των Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
- την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro.
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τους προϋπολογισμούς των Δημόσιων Νοσοκομείων – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Σχετικά:

- 1) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 199/10 του Γ.Νοσ/μειου Αθηνών Ευαγγελισμός
- 2) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 46/2012 του Γ.Νοσ/μειου Αθηνών Ευαγγελισμός
- 3) Απόφαση υπ' αριθμ. 23/49/14-1-2015 του Γ.Ν. Αθηνών Ευαγγελισμός περί απευθείας ανάθεσης της συντήρησης και επισκευής των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro στην Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ
- 4) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 5402/23-06-2015 του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου– Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ»
- 5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 2860/20-03-2015
- 6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 8834/21-9-2015
- 7) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2014 του Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- 8) Σύμβαση 4567/2003 Υπουργείου Ανάπτυξης – Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ
- 9) Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου
- 10) Ενημερωτικό δελτίο Service No 249/23-1-2013 για τα ΑΚ 95
- 11) Ενημερωτικό δελτίο Service No 403/21-6-2007 για τα ΑΚ 100
- 12) E-mail της 26-11-2009 για τα ΑΚ-100
- 13) Ενημερωτικό δελτίο Service No 168/23-1-2013 για τα ΑΚ 200
- 14) Έγγραφο της ΕΠΥ υπ' αριθμ. πρωτ. 2889/24-07-2015-11-24

- 15) Έγγραφο της εταιρείας μας υπ' αριθμ. 3225/21-8-2015 προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
- 16) Έγγραφο μας υπ' αριθμ. πρωτ. 22260/27-10-2015 προς το Γ.Ν. Αθηνών Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
- 17) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2137/2015 του Γ.Ν. Ρεθύμνου
- 18) Εντυπα αξιολόγησης ISO υπογεγραμμένα από το Διευθυντή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
- 19) Εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96
- 20) Εγχειρίδιο λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200 op.man. HCEL9761.Rev.12.1999 program verison 4.xx σελ. 1:3 και 1:4
- 21) Εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8
- 22) Εγχειρίδιο συντήρησης HCEN12395 Revision 02.2010 program version 10.xx σελ. 1:5
- 23) Δημοσίευμα με ομιλία του πρωθυπουργού Κου Α. Σαμαρά από το βήμα της Βουλής στις 12/11/2012
- 24) Δημοσίευμα με σχετικό επίσημο ερώτημα αρ. πρωτ. 1200/17-7-2014 των βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδα προς τον υπουργό υγείας
- 25) Επιστολή της εταιρείας μας υπ' αριθμ. πρωτ. 18222/8-7-2014 προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 26) Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για συντηρήσεις ιατρικών μηχανημάτων με αποσπασματική μετάφραση
- 27) Εισήγηση του Κου Κοτσοβόλη στην Ημερίδα της ΕΛΕΒΙΤ της 15/09/2014
- 28) Πρόγραμμα Ημερίδας ΕΛΕΒΙΤ της 15/09/2014
- 29) Ψηφιακός Δίσκος (cd) με όλα τα δεδομένα του παρόντος

Για τη ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ


Μπάλτσας Ιωάννης

ΣΕΡ.ΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ.: 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221953 - ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ


Στεριώτης Κων/νος

Διαχειριστές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Ταχ. Δ/ση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47
Τ.Κ. 10626- ΑΘΗΝΑ
URL: www.evangelismos-hosp.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 199/10

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια **ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**
με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοίκτος Δημοσίου Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	10-02-11
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ)	0800-00001
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	
ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	641.972,11€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	(1) ένας χρόνος
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.	15-12-10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	24-12-10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	22-12-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΗΛΕΥΤΗΣ

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Ν.Π.Δ.Δ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΑΘΗΝΑ 29-4-2011

ΚΑΕ: 0800-00001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2009 ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΥ ΕΤΟΥΣ 2010 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)

ΑΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Σύστημα επεξεργασίας ύδατος με αντιστροφή Οσμωση	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	3.710,60 €
2 Ακτινολογικό PHILIPS DIAGNOST VR	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	15.922,00 €
3 Δύο Ακτινολογικά PHILIPS DIAGNOST TH	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	9.863,00 €
4 Συγκρότημα μαγνητικής τομογραφίας GE Medical Systems	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 79.855,00
5 Δικέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sophia Medical	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 22.134,00
6 Μονοκέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sophia Medical	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 29.914,00
7 Επτά (7) Αναισθ/κά Συγκροτήματα GE HEALTHCARE	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 32.067,57
8 Επτά (7) Αναισθ/κά KION MAQUET CRITICAL CARE	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 51.048,86
9 Ψηφιακός Στεφανιογράφος INNOVA 2000 GE	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 73.362,00
10 Δεκατρείς (13) Αναπνευστήρες Servo-i MAQUET	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 29.892,25
11 Εμφανιστήρια-Ψηφιοποιητές-Εκτυπωτές AGFA	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 32.454,87
12 Συγκρότημα Ψηφιακής Αγγειογραφίας INTEGRIS V500 PHILIPS	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 48.755,50
13 Κλιβανοί Ατμού και Πλυντήρια εργαλείων GETINGE	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 39.879,00
14 Δεκαέξη (16) Αναπνευστήρες Servo 300 MAQUET	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 54.378,24
15 Ακτινολογικό Συγκρότημα Siemens Iconos R200	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 25.585,00
16 Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού GAMBRO	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 54.621,00
17 Ηλεκτρικά κρεβάτια HILL-ROM	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	€ 9.255,22
18 Αναπνευστήρας Υψηλών Συχνοτήτων	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	4.403,00 €
19 C-ARM OEC 9800 PLUS G.E. Medical Systems	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	13.447,00 €
20 Δύο (2) Συστήματα Πρωτοξειδίου Αζώτου (NO)	ΕΝΑ ΕΤΟΣ	11.424,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :		641.972,11 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

ΑΘΗΝΑ 10-6-2010

1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO

Αναλυτικός πίνακας Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού που πρόκειται να καλυφθούν με σύμβαση συντήρησης.

	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΜ	FM	SERIAL NUMBER	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:2454 BMM:31062 UCM:16968 FCM:10582	MTN	Με όσμωση WSF:3536 & WRO:8377
2	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:4661 BMM:271 UDM:16948 FCM:9622	MTN	-
3	GAMBRO	AK-95	-	-	5328	MTN	-
4	GAMBRO	AK-95	-	-	5331	MTN	-
5	GAMBRO	AK-95	-	-	5353	MTN	-
6	GAMBRO	AK-95	-	-	5355	MTN	-
7	GAMBRO	AK-100	11684	10607	-	MTN	-
8	GAMBRO	AK-200	5958	4518	-	MTN	-
9	GAMBRO	AK-200	6128	4636	-	MTN	-
10	GAMBRO	AK-200	9048	6682	-	MTN	-
11	GAMBRO	AK-200	9050	6684	-	MTN	-
12	GAMBRO	AK-200	12155	8939	-	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ	Με όσμωση WRO: 1189 & WSF: 101
13	GAMBRO	AK-200S	-	-	16279	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ	Με όσμωση WRO: 1768 & WSF: 101
14	GAMBRO	AK-200S	-	-	16292	MTN	-
15	GAMBRO	AK-200S	-	-	16293	MTN	-

1°. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των παραπάνω αναφερόμενου μηχανημάτων , κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου , καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης .
Ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει ISO 9001/2008 και το ISO 13485.

2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής .

3. Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν :

α) Την λειτουργική συντήρησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου και ειδικότερα :

- Τον έλεγχο ασφαλείας , μετρήσεις τάσεων παλμών , κλπ.
- Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης .
- Τις αναγκαίες ρυθμίσεις , λιπάνσεις και εσωτερικούς καθαρισμούς των μηχανημάτων .

β) Την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα :

- Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση .
- Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.
- Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών .

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή:

- i) Ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός , θύελλες , νερά , κεραυνό, φωτιά). Από χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή από τρίτους.
- ii) Η αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή από τρίτους.
- iii) Η χρήση ακατάλληλων υλικών για την αποστείρωση, για τον καθαρισμό απασβέστωσης, καθώς και η ελλιπής διαδικασία απασβέστωσης , ή καθαρισμού, πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στα Τεχνικά εγχειρίδια .

- iv) Η κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου.
- v) Η κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περιόδων του Νοσοκομείου ή της ΔΕΗ.
- vi) Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

Εάν ζητηθεί αποκατάσταση των βλαβών , λόγω των παραπάνω περιπτώσεων και εφόσον είναι δυνατόν, η δαπάνη θα συμπεριλαμβάνει τα εργατικά και τα ανταλλακτικά, και θα χρεώνεται χωριστά με βάση τις ισχύουσες τιμές του συντηρητή.

Ο μέγιστος χρόνος αντίδρασης είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες και κατόπιν έγγραφης κλήσεως από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .

- γ) Την περιοδική συντήρηση των μηχανημάτων , που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από αυτόν, και συγκεκριμένα :
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-10 ανά εξάμηνο
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-95 κάθε 2500 ώρες λειτουργίας (kit κωδ 113 502 500)
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-100 κάθε 2500 ώρες λειτουργίας (kit κωδ 113 802 500)
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-200 κάθε δύο (2) χρόνια το Base-Kit (K40165001) και το A-Kit (K40166001) και το B-Kit (K40167001) .

4. Όλες οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται υπό την εποπτεία αρμόδιου τεχνικού του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή , από 08:30π.μ έως 16:30μ.μ εξαιρουμένων εορτών και αργιών .


5. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται προγραμματισμένα , ενώ για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών ο Συντηρητής υποχρεούται να επιλαμβάνεται με αποστολή των ειδικευμένων τεχνικών του , εντός δύο (2) ωρών από την λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της συντηρήτριας εταιρείας .

6. Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος τεχνητού νεφρού της σύμβασης , συμφωνείται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ανά έτος . Σαν χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια αιμοκάθαρσης . Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης .

Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης θα προστείνεται η σύμβαση κατά επτά (7) ημέρες άνευ ανταλλάγματος.

7. Μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχεται στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίου εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης .
8. Ο Συντηρητής πρέπει να διατηρεί ικανή επάρκεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων .
9. Θα κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων , ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής των.
10. Θα κατατεθεί δήλωση/δέσμευση του Οίκου Κατασκευής , που θα δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις , με τους ίδιους ακριβώς όρους, της σύμβασης συντήρησης και επισκευής , σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου του έργου να ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο.-

Για το
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Κ.ε.α.



Δ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Προϊστάμενος Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Ταχ. Δ/ση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47
Τ.Κ. 10626- ΑΘΗΝΑ
URL: www.evangelismos-hosp..gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 46/2012
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 13 Σεπτεμβρίου 2012. Ημέρα : Πέμπτη Ωρα : 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Υψηλάντου 45-47
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50400000-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	470.371,67€ με Φ.Π.Α.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	12 μήνες
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου και η ποσότητα παράδοσης δεν θα είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί σε χρόνο κάλυψης αναγκών σε ποσότητες 45 ημερών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.	18/07/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	19/07/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	20/07/2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΑΘΗΝΑ 10-6-2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO

Αναλυτικός πίνακας Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού που πρόκειται να καλυφθούν με σύμβαση συντήρησης .

	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	BM	FM	SERIAL NUMBER	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ
1	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:2454 BMM:31062 UCM:16968 FCM:10582	MTN	<u>Με όσμωση</u> WSF:3536 & WRO:8377
2	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:4661 BMM:271 UDM:16948 FCM:9622	MTN	-
3	GAMBRO	AK-95	-	-	5328	MTN	-
4	GAMBRO	AK-95	-	-	5331	MTN	-
5	GAMBRO	AK-95	-	-	5353	MTN	-
6	GAMBRO	AK-95	-	-	5355	MTN	-
7	GAMBRO	AK-100	11684	10607	-	MTN	-
8	GAMBRO	AK-200	5958	4518	-	MTN	-
9	GAMBRO	AK-200	6128	4636	-	MTN	-
10	GAMBRO	AK-200	9048	6682	-	MTN	-
11	GAMBRO	AK-200	9050	6684	-	MTN	-
12	GAMBRO	AK-200	12155	8939	-	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ	<u>Με όσμωση</u> WRO: 1189 & WSF: 101
13	GAMBRO	AK-200S	-	-	16279	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΚΟ ΤΜΗΜΑ	<u>Με όσμωση</u> WRO: 1768 & WSF: 101
14	GAMBRO	AK-200S	-	-	16292	MTN	-
15	GAMBRO	AK-200S	-	-	16293	MTN	-
16	GAMBRO	AK-200S	-	-	21822	MTN	-
17	GAMBRO	AK-200S	-	-	21826	MTN	-

1°. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των παραπάνω αναφερόμενου μηχανημάτων , κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου , καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης .
Ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει ISO 9001/2008.

2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο από τον Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης το οποίο παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε κάθε τεχνικό που παρακολουθεί τις τακτικές εκπαιδεύσεις. Να κατατεθούν οι διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης και το ISO 13485 που πρέπει να διαθέτει ο συντηρητής .

3. Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν :

α) Την λειτουργική συντήρησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου και ειδικότερα :

- Τον έλεγχο ασφαλείας , μετρήσεις τάσεων παλμών , κλπ.
- Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης .
- Τις αναγκαίες ρυθμίσεις , λιπάνσεις και εσωτερικούς καθαρισμούς των μηχανημάτων .

β) Την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα :

- Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση .
- Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.
- Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών .

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή:

- i) Ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός , θύελλες , νερά , κεραυνό, φωτιά). Από χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή από τρίτους.
- ii) Η αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή από τρίτους.
- iii) Η χρήση ακατάλληλων υλικών για την αποστείρωση, για τον καθαρισμό απασβέστωσης, καθώς και η ελλιπής διαδικασία απασβέστωσης , ή καθαρισμού, πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στα Τεχνικά εγχειρίδια .

- iv) Η κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου.
- v) Η κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περιόδων του Νοσοκομείου ή της ΔΕΗ.
- vi) Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

Εάν ζητηθεί αποκατάσταση των βλαβών , λόγω των παραπάνω περιπτώσεων και εφόσον είναι δυνατόν, η δαπάνη θα συμπεριλαμβάνει τα εργατικά και τα ανταλλακτικά, και θα χρεώνεται χωριστά με βάση τις ισχύουσες τιμές του συντηρητή.

Ο μέγιστος χρόνος αντίδρασης είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες και κατόπιν έγγραφης κλήσεως από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .

- γ) Την περιοδική συντήρηση των μηχανημάτων , που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από αυτόν, και συγκεκριμένα :
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-10 κάθε 1000 ώρες λειτουργίας ή μία φορά το εξάμηνο τουλάχιστον, καθώς και κάθε 3000 ώρες λειτουργίας ή μία φορά τον χρόνο τουλάχιστον.
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-95
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-100
 - Για τις μηχανές GAMBRO AK-200 κάθε δύο (2) χρόνια το Base-Kit (K40165001) και όποτε απαιτείται το A-Kit (K40166001) και το B-Kit (K40167001) .

- 4. Όλες οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται υπό την εποπτεία αρμόδιου τεχνικού του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τις Κυριακές και τις αργίες.
- 5. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται προγραμματισμένα , ενώ για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών ο Συντηρητής υποχρεούται να επιλαμβάνεται με αποστολή των ειδικευμένων τεχνικών του , εντός δύο (2) ωρών από την λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της συντηρήτριας εταιρείας .
- 6. Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος τεχνητού νεφρού της σύμβασης , συμφωνείται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ανά έτος . Σαν χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια αιμοκάθαρσης . Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης .

Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης θα παρατείνεται η σύμβαση κατά επτά (7) ημέρες άνευ ανταλλάγματος.

7. Μετά το πέρας της κάθε εργασίας θα παρέχεται στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίου εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης .
8. Ο Συντηρητής πρέπει να διατηρεί ικανή επάρκεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων .
9. Θα κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων , ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής των.
10. Θα κατατεθεί δήλωση/δέσμευση του Οίκου Κατασκευής , που θα δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις , με τους ίδιους ακριβώς όρους, της σύμβασης συντήρησης και επισκευής , σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου του έργου να ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο.-

Για το
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

**CPV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (50400000-9)**

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.	Δικέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sorpha Medical	Ετήσια	22.878,00 € με ΦΠΑ
2.	Δικέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sorpha Medical	Ετήσια	22.878,00 € με ΦΠΑ
3.	Μονοκέφαλη τομογραφική Γ' κάμερα Sorpha Medical	Ετήσια	30.919,44€ με ΦΠΑ
4.	Τέσσερα (4) Αναισθ/κά Συγκροτημάτα GE HEALTHCARE (OHMEDA)	Ετήσια	27.020,63 € με ΦΠΑ
5.	Αυτόματο Σύστημα Απομόνωσης DNA/RNA	Ετήσια	2.776,11 € με ΦΠΑ
6.	Εμφανιστήρια-Ψηφιοποιητές-Εκτυπωτές AGFA	Ετήσια	32.454,84 € με ΦΠΑ
7.	Κλίβανοι Ατμού και Πλυντήρια εργαλείων GETINGE	Ετήσια	39.360,00 € με ΦΠΑ
8.	Δεκατρείς (13) Αναπνευστήρες Όγκου Servo-IMAQUET	Ετήσια	29.520,00 € με ΦΠΑ
9.	Δεκαέξι (16) Αναπνευστήρες Όγκου Servo-300 MAQUET	Ετήσια	55.104,00 € με ΦΠΑ
10.	Δεκαπέντε(15) Μηχ/τα Τεχνητού Νεφρού GAMBRO	Ετήσια	57.142,65 € με ΦΠΑ
11.	Ηλεκτρικά κρεβάτια HILL-ROM	Ετήσια	16.140,00 € με ΦΠΑ
12.	Δύο (2) Συστήματα Πρωτοξειδίου Αζώτου (NO)	Ετήσια	11.424,00 € με ΦΠΑ
13.	Ενδοσκοπικός εξοπλισμός Olympus ΙΑΠΩΝΙΑΣ	Ετήσια	122.754,00 € με ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ		470.371,67 € με ΦΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
 Της 49^{ης} Συνεδρίας Δ.Σ. της 14-1-2015
 Απόφαση 23

Σύμβαση Πλήρους Συντήρησης Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού GAMBRO Σουηδίας.

Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αριθμ. πρωτ. 14/01/4048/24-12-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, σχετική με το παραπάνω θέμα, η οποία αναφέρει :

- ΣΧΕΤ.: α. Απόφαση 14 της 102 Συνεδρίας Δ.Σ. της 22-11-2013
 β. Σύμβαση υπ' αριθμό 3099/2013
 γ. Απόφαση 40 Ε.Η.Δ. της 82^{ης} Συνεδρίας Δ.Σ. της 26-7-2013
 δ. Προσφορά της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD) με αρ. πρωτ. 4028/23-12-2014
 ε. Σχέδιο Σύμβασης

Κύριε Διοικητά:

1. Με την Απόφαση 14 της 102^{ης} Συνεδρίας Δ.Σ. της 22-11-2013 (σχετ. α), έχει ανατεθεί η συντήρηση (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των Kit των συντηρήσεων) του παρακάτω αναφερόμενου εξοπλισμού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, στην Προμηθεύτρια και Αποκλειστική Διανομέα Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD). Το κόστος της συντήρησης για ένα (1) έτος (Από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ήταν 48.708,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/α	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	BM	FM	SERIAL NUMBER	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:2454 BMM:31062 UCM:16968 FCM:10582	MTN	<u>Με όσμωση</u> WSF:3536 & WRO:8377
2	GAMBRO	AK-10	-	-	BCM:4661 BMM:271 UDM:16948 FCM:9622	MTN	-
3	GAMBRO	AK-95	-	-	5328	MTN	-
4	GAMBRO	AK-95	-	-	5331	MTN	-
5	GAMBRO	AK-95	-	-	5353	MTN	-
6	GAMBRO	AK-95	-	-	5355	MTN	-
7	GAMBRO	AK-100	11684	10607	-	MTN	-
8	GAMBRO	AK-200	5958	4518	-	MTN	-
9	GAMBRO	AK-200	6128	4636	-	MTN	-
10	GAMBRO	AK-200	9048	6682	-	MTN	-

11	GAMBRO	AK-200	9050	6684	-	MTN	-
12	GAMBRO	AK-200	12155	8939	-	ΝΕΦΡΟΛΟ ΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	<u>Με όσμωση</u> WRO: 1189 & WSF: 101
13	GAMBRO	AK-200S	-	-	16279	ΝΕΦΡΟΛΟ ΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	<u>Με όσμωση</u> WRO: 1768 & WSF: 101
14	GAMBRO	AK-200S	-	-	16292	MTN	-
15	GAMBRO	AK-200S	-	-	16293	MTN	-
16	GAMBRO	AK-200S	-	-	21822	MTN	-
17	GAMBRO	AK-200S	-	-	21826	MTN	-

2. Λόγω της ιδιαιτερότητας, παλαιότητας και ευαισθησίας ως προς τη σωστή χρήση των ποιο πάνω Μηχανημάτων, του υψηλού κόστους των ανταλλακτικών και του υψηλού κόστους προμήθειας των απαιτούμενων οργάνων για τους απαραίτητους ελέγχους από τους Τεχνικούς του Νοσοκομείου, το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ζήτησε από την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD), να καταθέσει πρόταση ανανέωσης της σύμβασης συντήρησης.
3. Σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας, το κόστος συντήρησης (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των Kit συντηρήσεων) για τα παρακάτω μηχανήματα, θα ανέλθει στο ποσό των 47.601,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	BM	FM	SERIAL NUMBER	ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ ΕΙΣ
1.	GAMBRO	AK-95	---	---	5328	MTN	-
2.	GAMBRO	AK-95	---	---	5331	MTN	-
3.	GAMBRO	AK-95	---	---	5353	MTN	-
4.	GAMBRO	AK-95	---	---	5355	MTN	-
5.	GAMBRO	AK-100	11684	10607	-	MTN	-
6.	GAMBRO	AK-200	5958	4518	-	MTN	-
7.	GAMBRO	AK-200	6128	4636	-	MTN	-
8.	GAMBRO	AK-200	9048	6682	-	MTN	-
9.	GAMBRO	AK-200	9050	6684	-	MTN	-
10.	GAMBRO	AK-200	12155	8939	-	MTN	<u>Με όσμωση</u> WRO: 1189 & WSF: 101
11.	GAMBRO	AK-200S	---	---	16279	MTN	<u>Με όσμωση</u> WRO:1768 & WSF: 101
12.	GAMBRO	AK-200S	---	---	16292	MTN	-
13.	GAMBRO	AK-200S	---	---	16293	MTN	-
14.	GAMBRO	AK-200S	---	---	21822	MTN	-
15.	GAMBRO	AK-200S	---	---	21826	MTN	-
16.	GAMBRO	AK-200S	---	---	14765	MTN	<u>Με όσμωση</u> WRO: 300 & WSF: 10-9M

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Το Ν° 16 Μηχάνημα GAMBRO του ΠΙΝΑΚΑ 2 περιήλθε στην κυριότητα του Νοσοκομείου μετά από δωρεά (σχετ. γ).
β) Η πλήρη συντήρηση του μηχανήματος GAMBRO AK-100 του ΠΙΝΑΚΑ 2 θα καλύπτεται χωρίς χρέωση.

4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί σε 24ωρη βάση 6 ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.
-Εφόσον καλύπτονται από Σύμβαση Συντήρησης τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα, η ανταπόκριση της εταιρείας σε περίπτωση βλάβης θα είναι εντός δύο (2) ωρών από ειδοποίησής της, το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, προτείνει όπως εγκρίνετε:

- i. Για τον παραπάνω αναφερόμενο εξοπλισμό του ΠΙΝΑΚΑ 2, την σκοπιμότητα σύναψης ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης (Από 01-01-2015 έως 31-12-2015) με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD) που είναι ο Αποκλειστικός Διανομέας των Μηχανημάτων GAMBRO Σουηδίας στην Ελλάδα.
- ii. Το Σχέδιο Σύμβασης (Σχετ. ε).
- iii. Την δαπάνη των **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (47.601,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** για την πλήρη συντήρηση (επισκευών με ανταλλακτικά και τα Kit των συντηρήσεων) των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του ΠΙΝΑΚΑ 2.
- iv. Την καταβολή της δαπάνης των **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (47.601,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε τέσσερεις (4) τριμηνιαίες δόσεις των ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (11.900,25 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκάστη, βάσει τιμολογίων που θα εκδίδονται μετά το πέρας του κάθε τριμήνου της Σύμβασης Συντήρησης.-**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δ.ΜΠΗΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β.Α.ΓΚΕΡΓΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την απόφαση 14 της 102 Συνεδρίας Δ.Σ. της 22-11-2013, την υπ' αριθμό 3099/2013 σύμβαση, την απόφαση 40 Ε.Η.Δ. της 82^{ης} Συνεδρίας Δ.Σ. της 26-7-2013, την προσφορά της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD) με αρ. πρωτ. 4028/23-12-2014, το σχέδιο Σύμβασης, την κείμενη νομοθεσία, μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, **ομόφωνα**

αποφασίζει-εγκρίνει:

1.Την σκοπιμότητα σύναψης ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού GAMBRO Σουηδίας, (για τον εξοπλισμό του Πίνακα 2), από 1-1-2015 έως 31-12-2015, με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. (MEDICAL PRODUCTS LTD) που είναι ο Αποκλειστικός Διανομέας των Μηχανημάτων GAMBRO Σουηδίας στην Ελλάδα.

2.Το Σχέδιο Σύμβασης.

3. Δαπάνη ποσού **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (47.601,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την πλήρη συντήρηση (επισκευών με ανταλλακτικά και τα Kit των συντηρήσεων) των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του Πίνακα 2.

4.Την καταβολή της δαπάνης των **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (47.601,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε τέσσερεις (4) τριμηνιαίες δόσεις των **ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (11.900,25 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκάστη, βάσει τιμολογίων που θα εκδίδονται μετά το πέρας του κάθε τριμήνου της Σύμβασης Συντήρησης.

5.Την ανάρτηση της Σύμβασης στο Διαδίκτυο.

6.Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας/Γραφείο Προμηθειών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

**Διοικητής
«Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός
-Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική»**

**Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2015
Ακριβές Αντίγραφο**

**Γεωργία Κανέλλου
Γραμματέας Δ.Σ.**

Εσωτερική Διανομή

**Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Γραφείο Προμηθειών**

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του cookies. Ενημερωθείτε για την πολιτική χρήσης τους [εδώ](#) ().

✓ Ενημερώθηκα



Διαύγεια (lumiview)
διαφάνεια στο κράτος

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



Είσοδος (/login)

Εισάγετε κείμενο για αναζήτ

A- A A+ A++

Σύνθετη αναζήτηση...

Πληροφορίες αναζήτησης... (/searchInfo)

Αρχική > Προβολή Πράξης

Ενέργειες ▾

Υποβολή επισήμανσης

ΑΔΑ

71X94690ΩΧ-ZMT

Κατάσταση

Αναρτηθείσα

Ημερομηνία ανάρτησης

28/01/2015 09:53:00

Τελευταία τροποποίηση

28/01/2015 09:53:00

Ηλεκτρονικό αρχείο

Λήψη αρχείου (<https://diavgeia.gov.gr/doc/71X94690ΩΧ-ZMT>) | Προβολή αρχείου (<https://diavgeia.gov.gr/doc/71X94690ΩΧ-ZMT?inline=true>)

Είδος

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Θέμα

Σύμβαση Πλήρους Συντήρησης Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού GAMBRO Σουηδίας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-
 ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
 Α.Φ.Μ 999070198
 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
 ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100
 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ
 ΤΗΛ:2841343174
 FAX:284108328
 www.agnhosp.gr
 e-mail: gkoxara@agnhosp.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5402/23-6-2015	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
Για την παροχή υπηρεσιών :	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
Κωδικός CPV	50421000-2
Με κριτήριο κατακύρωσης :	ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) :	73.000,00 ευρώ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 28 Ιουλίου 2015 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11 πμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γραφείο Προμηθειών Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014	50421000-2
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.	ΚΑΕ 887
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	73.000,00 € (συμπ/νου του ΦΠΑ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.agnhosp.gr)	26/6/2015

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1. Του **Ν. 2286/1995** (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 145/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
2. Του **Π.Δ. 118/2007** (ΦΕΚ Α' 150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.».
3. Του **Ν. 2362/95** (ΦΕΚ Α' 247/1995) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Του **Ν. 2741/1999** (ΦΕΚ Α' 199/1999), άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
5. Του **Ν. 2955/2001** (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και

λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύει σήμερα.

6. Του **N. 3329/2005** (ΦΕΚ Α' 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
7. Του **N. 3527/2007** (ΦΕΚ Α' 25/9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
8. Του **N. 3580/2007** (ΦΕΚ Α' 134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
9. Του **Π.Δ. 166/2003** (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
10. Του **N. 3846/2010** (ΦΕΚ Α' 66/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24.
11. Του **N 3861/2010** (ΦΕΚ Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
12. Του **N. 3867/2010** (ΦΕΚ Α' 128/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 27.
13. Του **N. 3868/2010** (ΦΕΚ Α' 129/3-8-2010) τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
14. Του **N. 3918/2011** (ΦΕΚ Α' 31/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
15. Το **N. 4013/2011** (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

1. **Το Ν. 4052/2012** (ΦΕΚ Α 41/1.3.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
2. **Τον Ν. 4281/2014** (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

2. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. 5804/24-11-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3261Β/4-12-2014) περί Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό πρ/σμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
2. Την υπ' αριθμ. 6484/30-12-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 3693Β/31-12-2014 «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014 πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2010, 2011 και 2013.)
3. Την υπ' αριθμ. 352/8-6-2015 Απόφαση του Διοικητή 7^{ης} Υ.Πε. Κρήτης.
4. Την με αρ. 11081/14.12.2011 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των φορέων του αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ

2957B/23.12.2011).

5. Το με ΑΠ 2397/21.3.2012 έγγραφο της ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
6. Το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
7. Την υπ' αριθμ. 335/27-5-2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο τακτικό ανοικτό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Α' με κωδ. **50421000-2** του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 Πιστώσεις 2015 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 887 και αναλυτικά :

1. **ΤΜΗΜΑ Α:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 37.000,00 ΕΥΡΩ
2. **ΤΜΗΜΑ Β:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 24.000,00 ΕΥΡΩ
3. **ΤΜΗΜΑ Γ:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 12.000,00 ΕΥΡΩ

Άρθρο 1^ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από κανονική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο και στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση/ανάρτηση:

- Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημ. Συμβάσεων» της Εφημερ. της Κυβέρνησης στις 23/6/2015 όπου θα δημοσιευθεί στις 26/6/2015
- Στον ελληνικό τύπο στις 23/6/2015 όπου και θα δημοσιευθεί στις 26/6/2015
- Στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ στις 23/6/2015, στους Πίνακες Ανακοινώσεων του

ΓΝΑΝ, του Τοπικού Επιμελητηρίου και του Δήμου Αγ. Νικολάου στις 23/6/2015.

Αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ στις 26/6/2015.

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας βαρύνουν το Νοσοκομείο στις δε τοπικές εφημερίδες βαρύνουν τους αναδόχους.

- Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.agnhosp.gr (Προκηρύξεις Διαγωνισμών) στις 26/6/2015 απ' όπου θα διατίθεται αποκλειστικά.
- Η αναθέτουσα αρχή θα διατηρεί ειδικό κατάλογο, στον οποίο θα καταγράφονται όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη, προς ενημέρωσή τους σε περίπτωση που χρειαστεί να τους ενημερώσει για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού. Όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικό έγγραφο αίτημα ένταξής τους στον ειδικό αυτό κατάλογο (με φαξ στο 2841083327 ή με e-mail στα: gkochara@agnhosp.gr), συμπληρώνοντας το έντυπο του παραρτήματος Γ', στο οποίο θα καταγράφουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα υπογράψουν, θα αναγράφεται δε ακόμη και η ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης.

Άρθρο 2^ο

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος	27 Ιουλίου 2015 Δευτέρα ΩΡΑ: 2:30 μμ	Γραφείο Προμηθειών Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος	28 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη ΩΡΑ: 11:00 πμ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
2. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:
 - α) Τα μέλη της επιτροπής
 - β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης).

Άρθρο 3ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

- α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) Συνεταιρισμοί
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- δ) Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής** στον διαγωνισμό ίση με το **2%** της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 1.187,00 ευρώ εφόσον ο υποψήφιος θα συμμετέχει στον διαγωνισμό για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Εφόσον θα συμμετέχει προμηθευτής σε ορισμένες μόνο από τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες, η εγγυητική επιστολή μπορεί να αφορά μόνο τις υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο παράρτημα Γ' της παρούσας διακήρυξης.
2. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** (Α'75), άρθρου 8, παρ. 4 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :
 - 2.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή η διαδικασία ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν.
 - 2.2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 - 2.2.1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007) δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - 2.2.2. Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 - 2.2.3. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
 - 2.2.4. Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από

τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

- 2.2.5.** Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. του αρ. 43 του ΠΔ 60/2007 καταστάσεις, δηλ. σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
- 2.2.6.** Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας & επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- 2.2.7.** Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση ότι θα προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του.
- 2.2.8.** Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) & επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
- 2.2.9.** Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη & προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ. 6 του ΠΔ 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ. 6 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 20 του ΠΔ 118/2007. Τα δικαιολογητικά αυτά θα τα προσκομίσουν μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση από την αναθέτουσα αρχή και μόνο από τον προς όν η κατακύρωση.
- Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

3. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
- 3.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 - 3.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - 3.3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
 - 3.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - 3.5. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - 3.6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
4. **Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο** τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους **παραστατικό εκπροσώπησης**.
5. Υπεύθυνη **Δήλωση** της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α'75) όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με την οποία υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα του προμηθευτή, ΠΔ.118/2007 άρθρο 8 παρ. 2, που απαιτούνται στο στάδιο της κατακύρωσης.

Η μη έγκαιρη και προσηκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται **η χώρα καταγωγής του** τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ 118/2007
2. **Υπεύθυνες Δηλώσεις** που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :
- 2.1. Ο προσφέρων, εφόσον **κατασκευάζει ο ίδιος** το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
 - 2.2. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.
 - 2.3. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς

τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιοδήποτε λόγο, ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 118/2007, άρθρο 18.

3. Σε περίπτωση που κατατεθούν δείγματα το αντίγραφο του Δελτίου αποστολής των Δειγμάτων θα κατατίθεται με την τεχνική προσφορά

4. Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας :

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO
- CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων.
- Με τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.
- Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη.
- Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών μόνο οι προμηθευτές στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και παραλαβής της ειδοποίησης, τα εξής δικαιολογητικά :

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του **τελευταίου τριμήνου** πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

- α)** συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- β)** δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- γ)** απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- δ)** νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
- ε)** Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής** (έκδοσης του **τελευταίου εξαμήνου**) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής** (έκδοσης του **τελευταίου εξαμήνου**) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό.
4. **Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή**, από το οποίο να προκύπτει ότι **κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης**, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής** στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
6. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου** ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, **κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού**, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

7. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου)** πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

8. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
- β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
- γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
- δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
- ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση **αποτελεί ένωση υποψηφίων προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά**, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλ.
 - Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
 - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του0 χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ,κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης.

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α & Β αντίστοιχα.

- 2.** Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α'101) όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπο άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
- 3.** Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των Ε.Π.Ε και των προσωπικών εταιρειών Ο.Ε και Ε.Ε και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης ,από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περιπτώσεως 1 του εδαφίου Α.

Επί ημεδαπών Α.Ε τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της εκδίδονται όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ,στο μητρώο Α.Ε της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7^α.1ιά αι 7β.12 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ,από το αρμόδιο εφετείο της έδρας της Α.Ε που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

- 1.** Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ του δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

- Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μάιου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλ.
 - Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
 - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
4. Επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά εφόσον πρόκειται για **ημεδαπούς συνεταιρισμούς**.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
 - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2 &3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Εφόσον πρόκειται για **αλλοδαπούς συνεταιρισμούς** :

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του παρόντος δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής :

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νόμιμες καταστάσεις.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Προκειμένου να διαπιστωθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. **Κατάλογο**, στον οποίο αναφέρονται οι **κυριότερες παραδόσεις** των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.
2. Περιγραφή του **τεχνικού εξοπλισμού** της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο τζίρο της τελευταίας τριετίας της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος τζίρος για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι :

- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
- Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ή των ακριβών αντιγράφων τους.
- Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της προηγούμενης παραγράφου.

- Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
- Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει:

α. Να υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, **δηλαδή μέχρι 27/7/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 μμ.**

β. Να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι **27/7/2015** (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες**, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με **τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες**.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Οι Υποψήφιοι προμηθευτές **δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους**, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος **υπόκειται σε κυρώσεις** και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα σε έντυπη μορφή.

Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3 Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

2.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5 Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1 **ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** (πρωτότυπα και αντίγραφα) που αναφέρονται στο Άρθρο 4, της παρούσης και η **εγγυητική συμμετοχής** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**».

3.2 **ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς (Πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο σε έντυπη μορφή, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:

- **ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ** που αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσης
- Τα Προσφερόμενα είδη και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους με αναφορά στην αρίθμηση που φέρει καθένα από αυτά στο παράρτημα Α της παρούσας:.
- Τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS φωτογραφίες, τεχνικών φυλλαδίων, εγχειρίδια κ.λ.π.)
- Τα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας και τις δηλώσεις του άρθρου 5.
- Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, συμπληρωμένο κατά το συνημμένο στην

διακήρυξη υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών.

- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού.

3.3 **ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο σε έντυπη μορφή με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

4. Επισημαίνεται ότι :

- 4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις **ενδείξεις του κυρίως φακέλου**.
- 4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 4.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «**πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα**». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- 4.4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να **είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική** γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
- 4.5. Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά

στοιχεία που ορίζει η διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με τις ενδείξεις «**κύρια προσφορά**» και «**αντίγραφο προσφοράς**»

- 4.6.** Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. **Παραπομπές σε έγγραφα** επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
- 4.7.** Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δΐξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 4.8.** Αντιπροσφορές ή Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης.
- 4.9. Διευκρινίσεις** που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
- 4.10.** Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή **διορθώσεις** οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
- 4.11.** Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά σε μέρος ή στο σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού (Παράρτημα Α).
- 4.12.** Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι **αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης**

και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ΠΔ 118/2007 διαδικασία.

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

1. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο **φάκελος των δικαιολογητικών** καθώς και ο φάκελος της **τεχνικής προσφοράς**, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) ή με τη χρήση μηχανικού μέσου (διατρητή) θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
 - Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.
 - Η Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
 - Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.
- 2. Οι οικονομικές προσφορές** θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,

στους Προσφέροντες Θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

3. Μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ενημερώνονται όλοι οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην οικονομική αξιολόγηση με έγγραφη ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των **φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης**, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ζητούνται μόνο από αυτούς που έχουν αναδειχθεί από την οικονομική αξιολόγηση ως υποψήφιοι προμηθευτές, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο Διενέργειας & Αποσφράγισης των προσφορών.

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική έγγραφη ανακοίνωση.

4. Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών, τιμών που προσφέρθηκαν) εντός πέντε ημερών μετά από κάθε αποσφράγιση και ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή. Στην έντυπη οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή που θα επισυνάπτει στην οικονομική του προσφορά.

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προσφερόμενη τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης όπως ζητείται στη διακήρυξη (ανά τεμάχιο, σετ κ.λ.π.) επί ποινή απόρριψης.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή είναι ανώτερη από την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

Άρθρο 12ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την τελική επιλογή του ανάδοχου λαμβάνεται υπόψη:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- 3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.

Άρθρο 13ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνώμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :

Α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%.

Β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό. ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Άρθρο 14ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με χρόνο ισχύος 15 μήνες από την έκδοσή της. Το ύψος της εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, θα προσδιοριστεί με την ανακοίνωση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρ. 25 παρ. 5 του ΠΔ 118/2007. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης.

Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Άρθρο 15ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - A. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
 - B. Τα συμβαλλόμενα μέρη
 - Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
 - Δ. Την τιμή
 - E. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
 - ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
 - Z. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 - H. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
 - Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
 - I. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Σχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 16^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί για ένα τρίμηνο μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση του προμηθευτή και με τους εξής όρους:

Α) Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Β) Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ' αναλογία.

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του

προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 18ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση του Νοσοκομείου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση του Νοσοκομείου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση, την κακή εκτέλεση ή την παράβαση όρων της σύμβασης.

Άρθρο 19ο

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και το ΠΔ 118/07.

Τόπος παράδοσης των υλικών όπως θα ορίζει και η σύμβαση είναι οι αποθήκες του Νοσοκομείου μας.

Άρθρο 20^ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 21ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα γίνεται από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο μηνών από την κατάθεση των τιμολογίων.

Τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται στην οικονομική υποδιεύθυνση του νοσοκομείου και αφού θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, θα προχωρούν στην έκδοση εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα θεωρείται αρμοδίως.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:

Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07

Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης (αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011)

Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 22^ο

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 23^ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Αγίου Νικολάου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ
FRESENIUS ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.****ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 601,62 ΕΥΡΩ**

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα δέκα (10) μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESENIUS της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας .

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESENIUS με ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου .

Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει δύο (2) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά εξάμηνο). Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασιών ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν., μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου FRESENIUS .

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESINIUS του Νοσοκομείου μας.

Το τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχανήμα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχανήμα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως .

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας.

**ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ
GAMBRO ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 390,24 ΕΥΡΩ

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα επτά (7) μηχανήματα τεχνητού νεφρού (επτά μηχανήματα ΑΚ 200) του οίκου GAMBRO της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας .

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα ΑΚ 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης ΑΚ 200 του οίκου GAMBRO.

Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά τρίμηνο).Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν. , μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίησή της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου GAMBRO .

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα)που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους,

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας,

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO του Νοσοκομείου μας.

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχάνημα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ**ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.****ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 195,12 ΕΥΡΩ**

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για την συντήρηση του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100 S των Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας .

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στον προαναφερόμενο κλίβανο με αμεταχείριστα ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση μέσα σε 24 ώρες εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου .

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης (ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2) και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε με τους κωδικούς τους,

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2) θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κλιβάνου λόγω βλάβης ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος. Στον χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος για την προληπτική και την επανορθωτική συντήρηση του κλιβάνου.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας,

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους , που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD του Νοσοκομείου μας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1

Θα γίνει με την συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση επιπέδου Ε2 και **θα περιλαμβάνει**

1) PM 1 kit

2)Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης , Αλλαγή λαδιών αντλίας κενού , Καθαρισμό ναρογίzer κλιβάνου , Απομάκρυνση νερού από δοχείο συλλογής αέρα, Απομάκρυνση υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης, Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ,καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2

Με την συμπλήρωση 12 μηνών ή 2250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση επιπέδου Ε2 και **θα περιλαμβάνει**

1) PM1 kit και PM2 kit

2)Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης , Αλλαγή λαδιών αντλίας κενού , Καθαρισμό ναρογίzer κλιβάνου , Απομάκρυνση νερού από δοχείο συλλογής αέρα, Απομάκρυνση υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης, Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ,καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος , Έλεγχος λειτουργίας ρυθμιστή πίεσης ,Αντικατάσταση καταλυτικού φίλτρου και του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού, Αντικατάσταση του φίλτρου HEPA ,Καθαρισμό της πόρτας του κλιβάνου ,Αντικατάσταση δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου, Αντικατάσταση

Των STOP στους οδηγούς του ραφιού του θαλάμου, Αντικατάσταση των μονωτικών αποστατών του ηλεκτροδίου .

3)Πιστοποίηση του κλιβάνου από τον κατασκευαστικό οίκο .

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

Αναβαθμίσεις - Διορθωτικές επεμβάσεις - Τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το Νοσοκομείο καθώς επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-
ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Α.Φ.Μ 999070198
Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα την ημέρα στην Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, οδός Κνωσού, αρ. 4, οι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός μεν ο κ. Εμμανουήλ Μακρονικολάκης, Πρόεδρος του Δ. Σ. και Διοικητής του Νοσοκομείου και νόμιμος εκπρόσωπός του και αφ' ετέρου η εταιρεία, που εδρεύει στο, οδόςαρ., ΤΚ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον,, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος στο εξής θα αποκαλείται χάρη συντομίας «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ενώ ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα αποκαλείται «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ».

Την το Νοσοκομείο διενήργησε Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» σύμφωνα με την αριθμ. 335/27-5-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου εγκρίθηκε το πρακτικό δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού και κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας για τα είδη που αναφέρονται στην σύμβαση.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου εγκρίθηκε το πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε η προμήθεια των αναφερόμενων στην σύμβαση ειδών στην προμηθεύτρια εταιρεία.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης δικαιολογητικών του διαγωνισμού στην συμβαλλόμενη προμηθεύτρια αντί συνολικού ποσού € (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με την προσφορά της και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους περί προμηθειών του Δημοσίου όπως εκάστοτε ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύει τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Ήδη με την παρούσα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την ετήσια συντήρησηγια ένα έτος στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

1. Το Νοσοκομείο αναθέτει στην εταιρεία την ετήσια συντήρηση αντί του συνολικού ποσού των ευρώ.
2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την συντήρηση και επισκευή των οκτώ (8) μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού FRESINIUS του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

- I. «**Προληπτική συντήρηση**» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των μηχανημάτων

- II. **«Επανορθωτική συντήρηση»** είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- III. **«Κανονικές μέρες εργασίας»** θεωρούνται: Οι από Δευτέρα έως και Σάββατο εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους.
- IV. **«Ανωτέρα βία»** σημαίνει και θα περιλαμβάνει κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο, που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμη και με την λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.
- V. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
- VI. Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για τα μηχανήματα (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματοςπέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης στα μηχανήματασυμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων (αναλωσίμων και μη αναλωσίμων) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΤΥΠΟΣ	
-----	-------	--

1.		
----	--	--

ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

1. Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ από το Νοσοκομείο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι ως εξής:
 - (Η κατά μήνα επιβάρυνση του Νοσοκομείου για την συντήρηση κάθε μηχανήματος θα είναι: πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.)
 - Άρα η ανά μήνα επιβάρυνση του Νοσοκομείου για τα μηχανήματαείναι .:€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
 - Συνεπώς η ετήσια επιβάρυνση του Νοσοκομείου θα είναι€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.

2. Η εξόφληση της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, που είναι οι εξής:
 - Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07
 - Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης (αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011)
 - Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Η εξόφληση θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του ΠΔ 166/2003.

Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

3. (Σε περίπτωση που τεθεί εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα ή προστεθεί κάποιο άλλο, το κόστος της συντήρησης θα διαμορφωθεί ανάλογα.)

4. Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της παρούσας σύμβασης.

5. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την έως τις Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί, με τους ίδιους όρους

και τιμές, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους τρεις πρώτους μήνες παράτασης, μετά την λήξη της σύμβασης. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση του προμηθευτή και με τον όρο ότι η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες συνολικά. Σε περίπτωση παράτασης σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της σύμβασης και η τιμή της.

6. Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση παροχής των υπηρεσιών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Επιφυλασσόμενων των όρων και προϋποθέσεων των όλων όσων γράφονται στην παρούσα σύμβαση το Νοσοκομείο συμφωνεί στις ακόλουθες ενέργειες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

1. Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να τα χειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί προσεκτικά προφυλλάσσοντάς τα από οποιαδήποτε ζημιά.
2. Να γνωστοποιεί άμεσα και έγκαιρα στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
3. Να εξασφαλίζει ώστε όλη η προληπτική ή επανορθωτική συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
4. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την παροχή των υπηρεσιών στους ανάλογους χώρους του Νοσοκομείου, καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση της προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης.
5. Να παρέχει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ χωρίς επιβάρυνση επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία.
6. Να καταγράφει όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων Οι παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον

εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης τους όπως και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Επιφυλασσόμενων των όρων και προϋποθέσεων των όλων όσων γράφονται στην παρούσα σύμβαση ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ συμφωνεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες συντήρησης κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

1.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που προκαλεί την ανωτέρα βία.
2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τους τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο με έγγραφη γνωστοποίηση.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα του Νοσοκομείου μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση δε που το Νοσοκομείο ζητήσει από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των εργατικών και των ανταλλακτικών θα χρεώνονται ξεχωριστά βάσει των ισχυουσών τότε τιμών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

1. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής των μηχανημάτων από θεομηνίες (πλημμύρα, φωτιά, κεραυνός, σεισμός κ.λπ.)

2. Από κακή χρήση των μηχανημάτων από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους καθώς επίσης από πτώση ή χτυπήματα των μηχανημάτων.
3. Λοιπές εργασίες όπως μεταφορά των μηχανημάτων σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου κ.λπ.
4. Κακόβουλες ενέργειες τρίτων

Όλους τους παραπάνω όρους αποδέχονται τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και προς επικύρωση τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΑΡΘΡΟ 5° ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Προμηθευτή να εκχωρήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και έχει εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Αγίου Νικολάου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση) προς τους Οίκοι του εξωτερικού που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 9° ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμογή έχουν οι νόμοι περί Προμηθειών του Δημοσίου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε δύο αντίγραφα, και έλαβε ο καθένας των συμβαλλομένων από ένα νόμιμα υπογεγραμμένο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης: _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Οδός ΚΝΩΣΟΥ αρ. 4 , Τ.Κ. 72100, Πόλη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εγγύηση μας υπ' αριθμόν _____ για ευρώ _____

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των _____ ευρώ υπέρ της Εταιρείας _____, οδός _____, αριθμός _____ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) _____, (2) _____, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της _____ δια την προμήθεια ειδών «Χειρουργικά Είδη και εργαλεία μιας χρήσης» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με την υπ' αριθμ. _____ Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την _____ (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

**Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Οδός ΚΝΩΣΟΥ αρ. 4 , Τ.Κ. 72100, Πόλη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εγγύηση μας υπ' αριθμόν _____ για ευρώ _____

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών _____, οδός _____, αριθμός _____, σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ' αρ. σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση , συνολικής αξίας , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ποσού _____

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα _____ παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) _____, 2) _____ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την _____

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ:
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
Άγιος Νικόλαος
Κνωσσού 4
ΤΚ 72100

Δηλώνω ότι παρέλαβα την υπ' αριθμ. διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας (για λογαριασμό της κάτωθι εταιρείας) και παρακαλώ για την εγγραφή της στον ειδικό κατάλογο που διατηρεί η υπηρεσία σας, και για την ενημέρωσή μας για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί του ανωτέρω διαγωνισμού.

Επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Φαξ	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	
Ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης	

Τόπος, ημερομηνία
Υπογραφή αιτούντος
Σφραγίδα εταιρείας, ονοματεπώνυμο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	
Αντιγραφή Ζητούμενης Τεχνικής Προδιαγραφής της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται στα Παράρτημα Α' της παρούσας	Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΚΑΛΥΠΤΕΙ" Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ"	Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής Προδιαγραφής της Προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον Υποψήφιο Ανάδοχο	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<i>Για παράδειγμα:</i>			
1. Να διαθέτει Τάση τροφοδοσίας 220volts/50Hz.	ΚΑΛΥΠΤΕΙ	Το προσφερόμενο σύστημα Χ του κατασκευαστικού οίκου Υ διαθέτει τάση τροφοδοσίας 220volts/50Hz.	Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4

- Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στο παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης.
- Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΚΑΛΥΠΤΕΙ", αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ" ενώ αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ".
- Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προδιαγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
- Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
- Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
- Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.



Ι.Π Μεσολογγίου 20-3-2015

Αριθμ. Πρωτ: 2860

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Γραφείο : Προμηθειών
 Ταχ. Δ/ση : Οδός Ναυπάκτου
 Ταχ. Κώδικας : 30200
 Πληροφορίες : Κουτσοβούλου Χριστίνα
 Τηλ. : 2631360185
 Fax : 2631360107

ΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία με ανάρτηση για :

1. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΜΗΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Από 1-4-2015 έως και 31-7-2015, συνολικού Προϋπολογισμού 9.400,00€ με ΦΠΑ)».

Σχετ.: α. Το Π.Δ 118/07 άρθρο 22.

β. Το Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

γ. Ο Ν.2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 13, εδαφ. V.

δ. Η με Αριθμ. πρωτ. 4516/4-6-2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο 1 της Ε.Π.Υ

ε. Το με Αριθμ. πρωτ. ΓΠΠΓ οικ. 68005/8-06-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΥΚΑ.

στ. Την με αριθμ. πρωτ: 2856/20-3-2015 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών.

ζ. Την υπ' αριθμ. 60/20-3-2015 απόφαση έγκρισης Διοικητή για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί σε προμήθεια και παροχή υπηρεσίας με πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά των παρακάτω εργασιών, άκρως απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις **27/3/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**, σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφετε η φράση «οικονομική προσφορά» το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου). Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί την προσφορά τους να υποβάλλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
- Να δηλώνεται υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος για τις εργασίες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να τις εκτελέσει σε χρονικό διάστημα που θα του ορίσει το Νοσοκομείο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-6-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ. 2631360178).

Η σύμβαση θα έχει ισχύ 4 μήνες με δικαίωμα μονομερούς παράτασης δύο μηνών. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού παύει να ισχύει.

Ο προμηθευτής που θα υπογράψει σύμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βάσει του άρθρου 25 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

α) Για την τετράμηνη κάλυψη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης δύο μηνών βλαβών/συντήρησης 8 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO της MTN. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται η εργασία και μετακίνηση τεχνικών και όχι τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά. (AK-95S-21336, AK-95S-21337, AK-200S-15753, AK200-6802, AK200-6749, AK200-6801, AK200-6763, AK200S-208333). (Προϋπολογισμού 5.700,00€ με ΦΠΑ)

β) Για την τετράμηνη κάλυψη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης δύο μηνών βλαβών/συντήρησης 5 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού FRESINIUS της MTN. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται η εργασία και μετακίνηση τεχνικών και όχι τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά. (FRESINIUS 4008B-8V5AC524, FRESINIUS 4008B-8V5AC519, FRESINIUS 4008B-8V5AC517, FRESINIUS 4008B-8V5AC512, FRESINIUS 4008B-8V5AC537). (Προϋπολογισμού 3.700,00€ με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, απαιτείται η σύναψη σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Τα Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης που θα καλύπτονται από τη σύμβαση συντήρησης και επισκευής είναι τα ως άνω. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

01. Προληπτική Συντήρηση

Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει συντηρήσεις σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι' αυτές τις συντηρήσεις, θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

02. Αποκατάσταση Βλάβης

Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

03. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

04. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τρίτη Πέμπτη από 07:20 έως 14:40 που δεν λειτουργεί η Μονάδα). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

05. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα μεγνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.

06. Ανταλλακτικά

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης **θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο με ξεχωριστή έγκριση δαπάνης**. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξάρτηματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

07. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.

08. Τηλεφωνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

09. Απόσυρση Μηχανήματος

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχανήμα τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι' αυτό το μηχανήμα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης.

10. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. Φύλλο Συμμόρφωσης

Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο απαιτήσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γρ. Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Ναυπάκτου
Τηλ. 2631360185
Φαξ: 2631360107

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.09.21 14:22:42
EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μεσολόγγι : 21-09-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 8834
ΑΔΑ : ΩΓΒΗ46907Π-ΣΝ7

ΠΡΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ –GAMBRO N.M.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» διάρκειας τριών (3) μηνών προϋπολογισμού δαπάνης 4.250,88 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ”

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε κλειστή τεχνική και οικονομική προσφορά για τα κάτωθι το αργότερο έως 24/09/2015 ώρα 11:00 π.μ., η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 24/09/2015 στις 12:00 μ.μ.. Με τον μειοδότη θα υπογραφεί 3μηνη σύμβαση με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός μηνός βλαβών/συντήρησης των 8 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO της MTN. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται η εργασία και μετακίνηση τεχνικών και όχι τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά. (AK-95S-21336, AK-95S-21337, AK-200S-15753, AK200-6802, AK200-6749, AK200-6801, AK200-6763, AK200S-208333). ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 1/10/2015-31/12/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, απαιτείται η σύναψη σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Τα Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης που θα καλύπτονται από τη σύμβαση συντήρησης και επισκευής είναι τα ως άνω. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

01. Προληπτική Συντήρηση

Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει συντηρήσεις σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι' αυτές τις συντηρήσεις, θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

02. Αποκατάσταση Βλάβης

Ο συντηρητής θα πρέπει να αναποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

03. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

04. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τρίτη Πέμπτη από 07:20 έως 14:40 που δεν λειτουργεί η Μονάδα). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

05. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.

06. Ανταλλακτικά

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης **θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο με ξεχωριστή έγκριση δαπάνης**. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επίσκεψη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

07. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.

08. Τηλεφωνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

09. Απόσυρση Μηχανήματος

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επίσκεψης κάποιο μηχάνημα τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι' αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης.

10. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. Φύλλο Συμμόρφωσης

Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο απαιτήσεων.

Ευχαριστούμε



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πειραιάς: 13-06-2014

2^η Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"

Αριθμ. Πρωτ. 6811

Αριθμ. Διακήρυξης 6

ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

Ταχ. Δ/ση : Αφεντούλη & Ζαννή ,
Τ.Κ 185 36

Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο : 210 4592 160

FAX 210 4592 597

13-06-2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6 / 2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ανοικτός δημόσιος Διαγωνισμός ή..... Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: 17-07-2014 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 10 π.μ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	16-07-2014 ΩΡΑ 13.00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γρ. Προμηθειών Σύμφωνα με συνημμένη κατάσταση ...50400000-9.....(# 58.671,00 # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Σύμφωνα με συνημμένη κατάσταση
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ένας(1) χρόνος.....
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ	...13-06-.2014
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ	... 13-06-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΓΡ. ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΖΑΝΕΙΟΥ www.tzaneio.gr
ΣΗΜΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:	

Έχοντας υπόψη:**1. Τις διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί:**

- Της Α3α/οικ./10358/92 (ΦΕΚ 681/Β.20-11-92) Απόφαση Υ.Π.Π.Κ.Α. “Αρμοδιότητες Δ.Σ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων”.
- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) “Προμήθειες Δημ. Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”.
- Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) “Περί Δημόσιου Λογιστικού”.
- Του Ν. 2889 (Φ.Ε.Κ. 37/2-3-2001) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 2955 (Φ.Ε.Κ. 256/2-11-2001) Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
- Του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28-9-1999).
- Του Ν. 3204/03 (Φ.Ε.Κ. 296/23-12-03) Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθν. Σύστημα Υγείας και άλλων θεμάτων.
- Του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. 279/10-11-05). Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
- Του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/4-4-05).
- Του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. Α25Τ/9-2-07).
- Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16-3-07).
- Του Ν. 3580/07 (Φ.Ε.Κ. 134/18-6-07). Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υ.Υ.& Κ.Α. και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 3204/03.
- Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/10-7-07). Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. (Κ.Π..Δ.).
- Του Ν.3867 / 2010 (Φ.Ε.Κ 128/ 3-08-2010 τ. α')
- Ν. 4152 / 2013 (107 / 9-5-2013)
- 18 / 10-10-2012 Απόφαση Ε.Π.Υ (Α.Π 965 / 26-03-2013) «Κόστη ετήσιου συμβολαίου πλήρους συντήρησης Ιατρικών Συστημάτων με εγκεκριμένες από την Ε.Π.Υ προδιαγραφές»

2. Την με Αριθμ. πρωτοκ. 6881 / 3-10-2012 Απόφαση της Ε.Π.Υ (Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας(Π.Π.Υ.Υ) έτους 2012 και 2013
- 3 . Την με αριθμ. 5572/24-10-2013 Απόφαση Παράτασης Π.Π.Υ.Υ 2012
4. Το με Αρ. πρωτ. 13134 / 24-05-2013 έγγραφο 2^{ης} Δ.Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου περί καθορισμού Φορέα υλοποίησης για διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ 2012
5. Το με αριθμ. πρωτ. 15915 / 27-6-2013 περί Καθορισμού Φορέα υλοποίησης για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ του 2012
6. Την με αριθμ. 05 / 05-03-2014 Θ. 1^ο Ε.Η.Δ εγκριτική προκήρυξης διαγωνισμού Δ.Σ Νοσοκομείου
7. Τις με αριθμ. 9/10-04-2014 Θ 10^ο Ε.Η.Δ και 13 / 21-05-2014 Θ 2^ο Ε.Η.Δ αποφάσεις Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά με τη διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία. Οι διαδικασίες εξέλιξης διέπονται από το Π.Δ. 118/2007

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΤΟΠΟΣ: «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-07-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 10 π.μ.

Οι προσφορές πρέπει είτε να υποβάλλονται στο Νοσοκομείο (Ζαννή και Αφεντούλη), είτε να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από αυτό μέχρι και την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού , ΔΗΛΑΔΗ 16-

07-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ΩΡΑ 13.00 Ημερομηνία Υποβολής / Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να φέρει την ένδειξη, «Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία».

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

- α) Οι Έλληνες πολίτες.
- β) Οι Αλλοδαποί
- γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- δ) Οι Συνεταιρισμοί.
- ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

5. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα εξής παραρτήματα:

- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** : Γενικοί όροι του διαγωνισμού.
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β** : Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών.
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ** : Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών (**χαμηλότερη τιμή**).
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ** : Αναλυτικός κατάλογος ειδών
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε** : Τεχνικές προδιαγραφές
- **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ**: Σχέδιο σύμβασης

6. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα **11 & 36** του **Π.Δ.118/2007. (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ)**

7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και **οκτώ (8) ημέρες** προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του **άρθρου 15 παρ. 2 περ. α** του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο **τρεις (3) ημέρες** προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός **έξι (6) ημερών** πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), και σε ηλεκτρονική μορφή (CD / DVD) εφόσον αυτό απαιτείται μαζί με τη διακήρυξη.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη αυτή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, και ειδικότερα ως εξής:

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: **φάκελος δικαιολογητικών (με όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 5,6,7,8,8^α)** και η εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τον Π.Δ. 118/2007. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη “**Τεχνική Προσφορά**”.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

1.4.2. Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά **συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”** και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

1.6. Η επιτροπή, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, που κατατέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σελίδα 3 παραγρ. 3 (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ) την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.6.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και στη συνέχεια παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

1.6. 3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο φάκελο δικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία των Νόμων, που αναφέρονται στη σελίδα 2 της παρούσας Διακήρυξης καθώς και αυτά που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα **5,6,7,8,8^α και 18 του Π.Δ. 118/2007:**

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στις οποίες θα δηλώνονται τα αναφερόμενα **στα άρθρα 6 και 8^α του Π.Δ. 118/2007.**

Συγκεκριμένα στις δηλώσεις, να περιλαμβάνονται απαραίτητως τα ακόλουθα, κατά περίπτωση (φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα):

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 (Αναφέρατε τα αδικήματα αναλυτικά)

- δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση (2) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (Αναφέρατε αναλυτικά).

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007

- Είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό και κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (αναφέρατε τις καταστάσεις αυτές αναλυτικά εφόσον σας αφορά)

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος.

δ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και εδαφίων α), β), γ), (κατά περίπτωση), του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007 κατά το στάδιο της κατακύρωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ημερομηνία δήλωσης των παραπάνω (του δηλούντος κι όχι του θεωρούντος το γνήσιο) θα πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι και την

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όπως αυτή αποδεικνύεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλου κατάθεσης του Νοσοκομείου

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, που υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής όπου να δηλώνεται ότι:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
- Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή
- Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του φορέα για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

6. Γραμμάτιο είσπραξης (20 €) για την αγορά της Διακήρυξης

1.8 Τεχνική Προσφορά

1.8.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

1.8.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαραίτους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.

1.8.3 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (σε υλοποίηση του άρθρου 9, και παρ. (ζ) του άρθρου 8 κατά περίπτωση), πιστοποιητικά σήμανσης CE, συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις της, του συμμετέχοντα και των κατασκευαστών του.

1.8.4 Η υπέρβαση του χρόνου ανταπόκρισης στη ζητούμενη υπηρεσία αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.8.5. Επισημαίνεται ότι:

1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Διευκρινίσεις που γίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.6 Εάν η προσφορά αναφέρεται σε περισσότερα τους ενός είδους, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς και η διακήρυξη, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε **επί ποινή απόρριψης** τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στην διακήρυξη και τον κωδικό είδους

1.8.7 Εφ' όσον τα είδη του διαγωνισμού είναι περισσότερα του ενός(1) οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν για το σύνολο ή για μέρος των ειδών

Απαγορεύονται ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

1.10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Απαγορεύονται ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.

1.11. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι τα είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκης του Νοσοκομείου. Απόκλιση από τον όρο αυτό, συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.

1.12. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.13.Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των κατασκευαστών του προσφερομένου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ' αναλογία.

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από τις ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

2. Οικονομική προσφορά - Προσφερόμενες τιμές

Η Οικονομική προσφορά να έχει απαραίτητως, την ακόλουθη μορφή: Αύξοντας αριθμός σύμφωνα με τη Διακήρυξη, Κωδικός Διακήρυξης, Κωδικός Εμπορίου, Είδος, Κωδικός Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει), Τιμή Παρατηρητηρίου τη στιγμή κατάθεσης της προσφοράς (όπου υπάρχει), Τιμή Προσφοράς

2. 1. Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ευρώ για παράδοση ελεύθερη στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

2.2. Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα, ως εξής :

α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το Φ.Π.Α.

β) ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

2.3. **Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ,θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την σύγκριση των προσφορών.**

2.4. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, **η τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά , αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό είδους και τον κωδικό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στην διακήρυξη.**

2.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Ο Φ.Π.Α. θα καταβληθεί όπως ορίζει ο νόμος.

3. ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

3.1 Φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που ανακηρύσσονται μειοδότες, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 εντός 20 ημερών από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης από την υπηρεσία, σε **σφραγισμένο φάκελο.**

2. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση στον ίδιο φάκελο, των δικαιολογητικών του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007, και συγκεκριμένα, των αναφερομένων στην παράγραφο 2, εδάφια α β και γ.. Επιπλέον προσκόμιση των υπολοίπων περιπτώσεων του άρθρου, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ζητούνται στους ειδικούς όρους – προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

3.2 Ημερομηνία Υποβολής/Παραλαβής του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης αναγράφονται υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον κυρίως φάκελο προσφοράς, και επιπρόσθετα η ένδειξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

3.3 Η αποσφράγιση του φακέλου γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, κατά τρόπο ανάλογο των σταδίων που προηγήθηκαν, ενώπιον των ενδιαφερόμενων παρευρισκομένων, που ενημερώθηκαν για την αποσφράγιση, με έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

4. Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει τα οριζόμενα υπό του άρθρου 21 Π.Δ. 118/2007.

5. Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος)

- Στον προμηθευτή /ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας , αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Με την έγγραφη ανακοίνωση στον ανάδοχο , η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

- Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια/συντήρηση των ειδών θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφ' όσον δεν έχει προκύψει ακόμη σύμβαση από νέα διαγωνιστική διαδικασία, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

- **Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων, του σχετικού διαγωνισμού σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν.**

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, **ως τόπος εκτέλεσης ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ**, υποβαλλομένων των προμηθευτών ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

6. Εγγυήσεις (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007).

6.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α) Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α σύμφωνα με το **άρθρο 25 παρ.4α του Π.Δ 118/2007**. Σε περίπτωση συμμετέχων στο διαγωνισμό προσφέρει για μέρος των υπό συντήρηση ειδών τότε αρκεί εγγύηση που καλύπτει το παραπάνω ποσοστό της αξίας των προσφερομένων απ' αυτόν υπηρεσιών συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.4β του Π.Δ 118/2007

β) **Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται με τις παραπάνω εγγυήσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

γ) Η Εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα(1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

δ) Η Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης .

6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α) Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η ανάθεση, **υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης**, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό **10%** της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

β) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο συντήρησης πλέον δύο (2) μήνες.

6.3 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Ελληνικό Προξενείο).

6.4. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. 150/10-7-2007/Τεύχος Α).

7. Παράδοση - Παραλαβή- Κυρώσεις

Π.Δ. 118.2007 (άρθρα 27,28,29,30,31,32,33,34).

7.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές της Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες του Νοσοκομείου και μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

7.2. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης του αναδόχου πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου.

7.3. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη, ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο που επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. 150/Τεύχος Α/10-7-2007).

8. Πληρωμή – Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τη σύμβαση, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου του Νοσοκομείου με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, με βάση τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή περιγραφή της εργασίας συντήρησης, σύμφωνα με την προσφορά του και την σύμβαση.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει με ευθύνη του Νοσοκομείου, ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4152 /2013 (107/9-05-2013)

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και ειδικότερα:

- Μ.Τ.Π.Υ και Ο.Γ.Α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ 3, 072 %
- ΦΟΡΟΣ 8%
- Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10%
- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2% Ν. 3580 / 2007 2%

8. Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές - Δικαστικές προσφυγές. Π.Δ. 118/2007.

Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ 118 / 2007

Η ενιστάμενη εταιρεία θα ενημερώνεται μετά την έγκριση της απάντησης της επιτροπής ενστάσεων από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

9. Κόστος Διακήρυξης

Με την λήψη της διακήρυξης του διαγωνισμού, **οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του Νοσοκομείου το ανάλογο ποσό και να προσκομίσουν την απόδειξη πληρωμής στα δικαιολογητικά τους.**

10. Γενικά

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

*** ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ	# 58.671,00 # € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

1. Για την **αξιολόγηση των προσφορών**, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή προσφοράς:
 - Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης
 - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
 - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και με την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
2. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο/ προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης
3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
6. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

- Gabro AK-10 με BMM: 26244 & UDM: 13252 & BCM: 1819 & FCM: 10238
- Gabro AK-90S με S/N 1392
- Gabro AK-200S με BM : 17875 & FM : 14301
- Gabro AK-200S με BM : 17876 & FM : 14302
- Gabro AK-200S με BM : 17877 & FM : 14303
- Nikkiso DBB-05 με S/N 63009-01
- Nikkiso DBB-05 με S/N 63009-02
- Nikkiso DBB-05 με S/N 63009-03
- Fresenius 4008 B/HDF με S/N 9V5AH922
- Fresenius 4008 B/HDF με S/N 0V5AL533
- Fresenius 4008S με S/N 3VCAQ 835
- Fresenius 4008S με S/N 3VCAQ 834
- Fresenius 4008S με S/N 7VCAFR95
- Fresenius 4008S με S/N 7VCAFR87
- Fresenius 4008S με S/N 7VCAFR88

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ / ΜΗΝΑ X 12 ΜΗΝΕΣ*	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ*
GABRO AK 10	1	265X12	3.180
GABRO AK 90S	1	265X12	3.180
GABRO AK 200S	3	265X12	9.540
NIKISSO DBB – 05	3	265X12	9.540
FRESENIUS 4008 B HDF	2	265X12	6.360
FRESENIUS 4008 S	5	265X12	15.900
ΣΥΝΟΛΟ			47.700
ΦΠΑ			10.971
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			58.671

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

1. Ο συντηρητής αποδεδειγμένα θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία για τις εργασίες συντήρησης, τα οποία να αποδεικνύονται με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

- Πιστοποιήσεις ISO του συντηρητή που αφορά στην εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν εκπαιδευτεί στα υπό ανάθεση μηχανήματα τεχνικού νεφρού. Στην περίπτωση όπου δεν διαθέτουν οι τεχνικοί του αναδόχου πιστοποιητικά εκπαίδευσης για τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία τουλάχιστον ενός Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει ικανοποιητικά εργασίες συντήρησης σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

2. Ειδικότερα ο συντηρητής πρέπει να εκτελεί οπωσδήποτε δύο (2) τακτικές συντηρήσεις (μία ανά εξάμηνο), όπως αναλυτικά περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστού των μηχανημάτων, λαμβανομένου υπόψη ότι τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης της Μ.Τ.Ν. λειτουργούν κάθε εβδομάδα τουλάχιστον **100 ώρες** και οσοδήποτε άλλες φορές ήθελε χρειαστεί ενδιάμεσα για την αποκατάσταση των διαφόρων βλαβών που θα προκύψουν.

Ο συντηρητής οφείλει επιπλέον να προβαίνει άμεσα σε τυχόν μετατροπές, αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις των μηχανημάτων (software updates) που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, προς τον χρήστη, χωρίς extra χρέωση.

3. Ο συντηρητής θα πρέπει να υποβάλλει με την προσφορά του το αναλυτικό πρόγραμμα με τις προληπτικές συντηρήσεις που θα εκτελεί και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων, με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των.

4. Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό των μηχανημάτων, και γενικά για τις εργασίες και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές για την συντήρηση κάθε μηχανήματος που αναφέρονται.

FLUID MONITOR

- Διαδικασία καθαρισμού και απασβέστωσης
- Ρύθμιση αισθητήρων πίεσης
- Ρύθμιση ανιχνευτού διαρροής αίματος
- Ρύθμιση αισθητήρων αγωγιμότητας
- Έλεγχος τάσεων αναφοράς
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Ρύθμιση Bicart select
- Εσωτερική ρύθμιση αισθητήρα υπερδιήθησης
- Ρύθμιση FRN
- Ρύθμιση ευθυγράμμιση UF

BLOOD MONITOR

- Ρύθμιση αισθητήρων φλεβικής πίεσης
- Ρύθμιση αισθητήρων αρτηριακής πίεσης
- Ρύθμιση αισθητήρα στάθμης
- Ρύθμιση αισθητήρα προετοιμασίας
- Έλεγχος πιεσομέτρων

5. Τον συντηρητή βαρύνουν τα υλικά καθαρισμού και λίπανσης, η εργασία των τεχνικών που θα απασχοληθούν για την συντήρηση, έλεγχο, ρύθμιση λειτουργίας, επισκευή βλαβών κλπ.

6. Τον συντηρητή βαρύνουν όλα τα ανταλλακτικά, πλην των αναλωσίμων τα οποία στην προσφορά του θα προκαθορίζονται επακριβώς.

7. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης **με το αρμόδιο τμήμα και το τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας**, χωρίς να διαταράσσεται η κανονική λειτουργία του τμήματος και κατ' επέκταση του Νοσοκομείου.

8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση του τμήματος Βιοϊατρικής τεχνολογίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

9. Ο συντηρητής πρέπει να επεμβαίνει για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα παρουσιάζεται στα μηχανήματα μέσα σε 4 ώρες από οποιοδήποτε έκτακτο κάλεσμά του, από το Νοσοκομείο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων αργιών και εορτών.

10. Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης λόγω επισκευών και προγραμματισμένων συντηρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, (υπολογίζονται 2 τακτικές συντηρήσεις), ο δε χρόνος αυτός θα ορίζεται με σαφήνεια στην προσφορά. Σε περίπτωση υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερόμενου συνολικού χρόνου των είκοσι ημερών.

11. Σαν ακινητοποίηση του μηχανήματος νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος του μηχανήματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, οπότε και θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στον συντηρητή. Το μέσον αναγγελίας μπορεί να είναι είτε τηλεφωνικό είτε με φαξ.

12. Για κάθε μηχανήμα με μέριμνα και ευθύνη του συντηρητή θα τηρείται βιβλίο συντηρήσεων-επισκευών, στο οποίο θα αναγράφονται ανελλιπώς και με πληρότητα (ημερομηνία, περιγραφή εργασίας κλπ), τις συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, ρυθμίσεις, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. Το βιβλίο αυτό θα τηρείται στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

13. Παράλληλα με το προαναφερόμενο βιβλίο και μετά από κάθε επίσκεψη τεχνικού του συντηρητή θα συμπληρώνονται ειδικά δελτία του συντηρητή και του Νοσοκομείου, και τα οποία θα υπογράφονται από τον συντηρητή και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου συντήρησης του Νοσοκομείου.

14. Η σύμβαση θα διακόπτεται αυτομάτως αν λόγω παλαιότητας του μηχανήματος δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο ή απο οποιονδήποτε τρίτο που διαθέτει γνήσια ανταλλακτικά.

15. Από την αποκατάσταση βλαβών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες όπως:

- Μη ενδεδειγμένη χρησιμοποίηση του μηχανήματος από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.
- Ζημιά, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή δόλο.
- Βίαιη καταστροφή.
- Όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας.
- Μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση.

16. Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό του νοσοκομείου, στο υπ' αυτόν ή τους ασθενείς, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου από υπαιτιότητα του ή δόλο.

17. Στην περίπτωση που ο συντηρητής αποδειχθεί ότι είναι ασυνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του το Δ.Σ. του νοσοκομείου ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου

συντήρησης θα τον κηρύσσει έκπιωτο και θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή “καλής εκτέλεσης της σύμβασης” υπέρ του νοσοκομείου.

18. Προσφορά που δεν απαντά με σαφήνεια και αναλυτικά σε όλα τα ζητούμενα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2^{ης} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
"Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο"

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

**ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

Στον Πειραιά σήμερα στις.....μεταξύ του Νοσοκομείου με την επωνυμία **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"**, που εδρεύει στον Πειραιά, (Ζαννή και Αφεντούλη), και εκπροσωπείται νόμιμα από τ ν κ , **Διοικητ** , και που στη συνέχεια θα αποκαλείται το **"Νοσοκομείο"** και αφ' ετέρου δε της εταιρείας " " που εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ. στη συνέχεια θα αποκαλείται ο **"προμηθευτής"**, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την **-20.... /ΘΕΜΑ** απόφαση του **Δ.Σ.** του Νοσοκομείου και ύστερα από δημόσιο ανοιχτό, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου συντηρητή **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, κατακυρώνεται** στην " " και αυτή στη συνέχεια αναλαμβάνει τη συντήρηση των στο άρθρο 1 οριζόμενων όπως παρακάτω περιγράφονται, με τους ειδικότερους όρους και τις συμφωνίες που ακολουθούν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο συντηρητής υποχρεούται να συντηρήσει τα παρακάτω μηχανήματα αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών από έως

Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων, του σχετικού διαγωνισμού σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν και ο προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να ζητήσει αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο συντηρητής υποχρεούται να συντηρεί τα μηχανήματα που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους στο τέλος της παρούσας όρους συντήρησης. Η συνολική ετήσια αμοιβή για την παρούσα σύμβαση διαμορφώνεται στο ποσό των € πλέον Φ.Π.Α

Η χρέωση ορίζεται ανά (χρον. διάστημα) στο ποσό των €

Η συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας και θα αποδεικνύεται με βεβαίωση επιτροπής που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.

Εξοδα μετακίνησης και μεταφοράς βαρύνουν το συντηρητή

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο συντηρητής κατέθεσε στο Νοσοκομείο την αριθμ. εγγυητική επιστολής της € η οποία θα του επιστραφεί μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

4° ΑΡΘΡΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συντηρητή θα γίνεται από το Νοσοκομείο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, με βάση των απαιτούμενων, για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικών
. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συντηρητή καθυστερήσει με ευθύνη του Νοσοκομείου, ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4152 / 2013 (107 / 9-5-2013)

ΑΡΘΡΟ 5°

Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει έτη μετά.

Το Γ.Ν.Πειραιά «Τζάνειο» δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου.
- (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Νοσοκομείου.
- (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ,
- (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
- (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας συντήρησης – **μετά από προειδοποίησή του** – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρος του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα συντήρησης.

.Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Για τις περιπτώσεις μη ανταπόκρισης ή πλημμελούς ανταπόκρισης του Αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6^ο**Περίοδος εγγύησης- συντήρηση-ανταλλακτικά**

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε (....) έτη (ή όσο επιπλέον χρονικό διάστημα αναφέρεται ενδεχομένως στην προσφορά του Προμηθευτή). Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου των μηχανημάτων που θα συντηρήσει, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού προς τα συμφωνηθέντα.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Συντηρητής οφείλει αναποφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου να αποκαθιστά τη βλάβη, τη δυσλειτουργία ή/ και ασυμφωνία των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με μερική ή ολική αντικατάσταση αυτού.

Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού, καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Συντηρητή

Ο χρόνος ανταπόκρισης του Προμηθευτή για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού είναι αυτός που ορίζεται στην οικεία θέση της διακήρυξης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συντηρητής δεν συμμορφώνεται με τις ως άνω υποχρεώσεις του, το Νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) με δικά του έξοδα, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα της παρούσας σύμβασης, ως τόπος εκτέλεσης ο Πειραιάς υποβαλλομένου του προμηθευτή ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

Για τα υπόλοιπα θέματα της παρούσας, ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις προμήθειες Δημοσίου.

Αφού αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αρχίζει από την υπογραφή της, σε τρία (3) πρωτότυπα, και το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Π.Ο.Υ.	ΥΠ/ΝΤΗΣ	Δ/ΝΤΗΣ

"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ", και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95(ΦΕΚ 19/Α/96) "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", το Π.Δ. 370/95(ΦΕΚ 199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατ. Προμηθειών προς Κοινωνικό Δίκαιο", το Π.Δ. 185/95(ΦΕΚ 102/Α/95) και το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) "Αναρμόζηση Προμηθειών Δημοσίου".

ΑΡΘΡΟ 10
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ-ΤΙΜΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ	ΦΟΡΕΑΣ
1	ΕΙΔΟΣ 1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΚ-95 του οίκου GAMBRO AB ΣΟΥΗΔΙΑΣ	3	9.391,00 ΦΠΑ 18%	28.173,00 5.071,14 33.244,14	Ν.Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2		4	9391,00 ΦΠΑ 18%	37.564,00 6.761,52 44.325,52	Ν.Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3		3	9.391,00 ΦΠΑ 18%	28.173,00 5.071,14 33.244,14	Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
4		3	9.391,00 ΦΠΑ 18%	28.173,00 5.071,14 33.244,14	Ν.Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5		2	9.391,00 ΦΠΑ 18%	18.782,00 3.380,76 22.162,76	Ν.Γ.Ν. ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
6		1	9.391,00 ΦΠΑ 18%	9.391,00 1.690,38 11.081,38	ΓΕΣ
7		3	9.391,00 ΦΠΑ 18%	28.173,00 5.071,14 33.244,14	Β' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ				219.546,22	

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΔΙΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΤΜΗΜΑ Γ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός:	4567/2003
Ποσό:	1.536.108, 00 ΕΥΡΩ
Προμηθευτής:	ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ - MEDICAL PRODUCTS
Είδος:	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία) ΓΕΣ και Β'ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σήμερα την 4η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Ε. Κάνιγγος), οι υπογεγραμμένοι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ - MEDICAL PRODUCTS, Δ/ση Γ. Γεννηματά 54, Τ.Κ. 16662 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΘΗΝΑ, ΠΛ. 210 9647500 και ΑΦΜ 095150743, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΛΑΧΟ του Αηλέου (Α.Τ. Ξ. 315272/85, Α.Τ. Α. Γλυφάδας), σύμφωνα με το 19596/7-12-1998 καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ 9929/29-12-1998), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την 8-7-2002 με βάση την Δ/ση 247/2001, διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ - ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια Συσκευών Τεχνητού Νεφρού, τύπου ΑΚ-95S και ΑΚ-200S, του οίκου GAMBRO LUNDIA AB ΣΟΥΗΔΙΑΣ για τις ανάγκες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία) - ΓΕΣ και Β' Νοσοκομείου ΙΚΑ Θεσσαλονίκης.
 Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την αριθμ. 57027-1-2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο όνομα της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ - MEDICAL PRODUCTS, ως αναλυτικά αναφέρεται στο Αρθρο 10.
 Υστερα από αυτό ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής στην παρούσα σύμβαση

Handwritten signatures and initials at the bottom of the contract document.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ	ΦΟΡΕΑΣ
1	ΕΙΔΟΣ 2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AK-200 του οίκου GAMBERO AB ΣΟΥΗΔΙΑΣ	4	11.005,00 ΦΠΑ 18%	44.020,00 7.923,60 51.943,60	ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΣΥΜΑΝΟΤΕΙΟ"
2		8	11.005,00 ΦΠΑ 18%	88.040,00 15.847,20 103.887,20	Π.Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
3		8	11.005,00 ΦΠΑ 18%	88.040,00 15.847,20 103.887,20	Π.Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4		5	11.005,00 ΦΠΑ 18%	55.025,00 9.904,50 64.929,50	Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
5		6	11.005,00 ΦΠΑ 18%	66.030,00 11.865,40 77.915,40	Ν.Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"
6		7	11.005,00 ΦΠΑ 18%	77.035,00 13.866,00 90.901,30	Ν.Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
7		4	11.005,00 ΦΠΑ 18%	44.020,00 7.923,60 51.943,60	Ν.Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8		7	11.005,00 ΦΠΑ 18%	77.035,00 13.866,00 90.901,30	Ν.Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
9		3	11.005,00 ΦΠΑ 18%	33.015,00 5.942,70 38.957,70	Ν.Γ.Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
10		4	11.005,00 ΦΠΑ 18%	44.020,00 7.923,60 51.943,60	Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
11		2	11.005,00 ΦΠΑ 18%	22.010,00 3.961,80 25.971,80	Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ


12		4	11.005,00 ΦΠΑ 18%	44.020,00 7.923,60 51.943,60	Ν.Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ
13		3	11.005,00 ΦΠΑ 18%	33.015,00 5.942,70 38.957,70	Ν.Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ
14		10	11.005,00 ΦΠΑ 18%	110.050,00 19.809,80 129.859,80	Ν.Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ
15		2	11.005,00 ΦΠΑ 18%	22.010,00 3.961,80 25.971,80	Ν.Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
16		8	11.005,00 ΦΠΑ 18%	88.040,00 15.847,20 103.887,20	Ν.Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
17		1	11.005,00 ΦΠΑ 18%	11.005,00 1.980,90 12.985,90	Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
18		5	11.005,00 ΦΠΑ 18%	55.025,00 9.904,50 64.929,50	Ν.Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ
19		5	11.005,00 ΦΠΑ 18%	55.025,00 9.904,50 64.929,50	Ν.Γ.Ν. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
20		2	11.005,00 ΦΠΑ 18%	22.010,00 3.961,80 25.971,80	Ν.Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
21		1	11.005,00 ΦΠΑ 18%	11.005,00 1.980,90 12.985,90	Γ.Ε.Σ.
22		3	11.005,00 ΦΠΑ 18%	33.015,00 5.942,70 38.957,70	Β' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
		102		1.324.561,80	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

3

4

Η τιμή μονάδος των υπό προμήθεια μηχανημάτων είναι για παράδοση αυτών (με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή) ελεύθερη στις αποθήκες των φορέων και περιλαμβάνει την αξία των μηχανημάτων, και τα έξοδα μεταφοράς των μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασης αυτών.
Θα επιβαρυνθεί δε με τον αναλογούντα ΦΠΑ ως ανωτέρω.



ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της παρούσης (εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου), ελεύθερα στις αποθήκες των Νοσοκομείων, με την υποχρέωση να τα μεταφέρει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία στο χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 394/96.
Ο χώρος εγκατάστασης των μηχανημάτων θα είναι έτοιμος, με μέριμνα των Νοσοκομείων, πριν από την παράδοση αυτών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεργασθεί με τα Νοσοκομεία, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, στην διόρθωση του χώρου εγκατάστασης, ασφάλεια λειτουργίας των μηχανημάτων (σχέδια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.).
Με την παράδοση των μηχανημάτων θα παραδοθούν και τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.

Η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την πλήρη εγκατάστασή του.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών εκ 1.535.108, 02 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, θα γίνει το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών.

Η δαπάνη βαρύνει για τα Νοσοκομεία :

1) Ν.Γ.Ν. ΕΛΕΙΣΣΑΣ, το Γ.Κ.Π.Σ. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
2) Π.Ε.Σ.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ν.Γ.Ν.ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ - Ν.Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Ν.Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) και Ν.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ " το Γ.Κ.Π.Σ.

3) Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ το Π.Δ.Ε. (ΠΕΠ Ηπείρου)

4) Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 091/1 Αριθ. έργου 9991310)

Για τα υπόλοιπα Νοσοκομεία η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό τους.

Η προμήθεια του είδους βαρύνεται με κρατήσεις:

1) Για τα Νοσοκομεία Π.Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ", Π.Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ", Ν.Γ.Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ " ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ", Ν.Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Ν.Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν.Γ.Ν.ΑΛΑΜΙΑΣ, Ν.Γ.Ν.ΚΥΤΑΡΙΣΣΙΑΣ, Ν.Γ.Ν.ΠΥΡΡΟΥ, Ν.Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ν.Γ.Ν.ΑΡΓΟΥΣ Ν.Γ.Ν.ΕΛΕΥΘΕΡΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ", Ν.Γ.Ν.ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ", Ν.Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" και Ν.Γ.Ν.ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 7,3216%.

ΜΠΠΥ	ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΑΚΠ	ΤΑΥΓΥΕ	Ν.2430/96	ΣΥΝΟΛΟ
3.072	0,256	0,1024	0,3072	7,3216%

2) Για τα Νοσοκομεία Ν.Γ.Ν. ΕΛΕΙΣΣΑΣ, Π.Ε.Σ.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Ν.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ και Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,1024%.

3) Γ.Ε.Σ 4,7616%

ΜΠΣ	ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΑΚΠ	ΤΑΥΓΥΕ	ΣΥΝΟΛΟ	
4.096	0,256	0,1024	0,3072	4,7616%

4) Ι.Κ.Α. 0,6656%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΑΚΠ ΤΑΥΓΥΕ ΣΥΝΟΛΟ
0,2660 0,1024 0,3072 0,6656 %

Από την πληρωμή του προμηθευτή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 26 του Ν.2198/94, φόρος εισοδήματος.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.394/96.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ.

Η προμηθευτρια θα παραδώσει τα μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία, τα δε έξοδα για την μεταφορά, εγκατάσταση και επίδειξη, βαρύνουν καθ' ολοκληρίαν την ίδια.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της προμηθευτριας, σε συνδυασμό με τους τεχνικούς όρους της δίεξης 247/2001 που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για τα ανωτέρω μηχανήματα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) χρόνων από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προμηθευτρια εταιρεία αναλαμβάνει την εκπαίδευση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων για τα οποία προορίζονται τα μηχανήματα, στην χρήση των προσαρμοσμένων μηχανημάτων στον τόπο λειτουργίας τους και για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο.
Όλα τα έξοδα εκπαίδευσης βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία.



MEDICAL PRODUCTS LTD

Γ. Γεωργιάδης 54
165 62 Αθήνα
Τηλ: +30 1 9647500
Fax: +30 1 9650500
E-Mail: info@medprod.gr



Προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
Γεν. Δ/νση Κρατικών Προμηθειών
Δ/νση Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλ.
και Επιστημονικών Οργάνων
Τμήμα Γ
Κάνινος 20, 101 81 Αθήνα

Αθήνα: 4/7/02

ΣΧΕΤΙΚΩΣ: Διακήρυξη σας με αριθ. 247/01, δημόσιου, ανοικτού, διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών Τεχνητού Νεφρού για το Φορέα Υπ. Υγείας- Πρόνοιας (διάφορα νοσοκομεία), που θα γίνει στις 8/7/2002 όπως ανακοίνωση 3124/10.5.02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αναφερόμενοι στην παραπάνω διακήρυξη σας τους όρους της οποίας, αφού λάβαμε γνώση, αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα και ενεργώντας αποκλειστικά αντιπρόσωποι και εισαγωγείς του Οίκου και Εργοστασίου

GAMBRO LUNDIA AB ΣΟΥΗΔΙΑΣ

έχουμε τη τιμή να σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη:

Handwritten signature and notes

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η προμηθεύτρια κατέθεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΚΔΙΔΕΙ	ΠΟΣΟ	ΥΠΕΡ ΤΗΣ
116/Δ22185/25894 1-4-2003	ALPHA BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΤΤΡΟΥ	130.094, 00 ΕΥΡΩ	ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των συμβάσεων (Επιτροπή Παραλαβής, Πληρωμή, κ.λ.π.), σύμφωνα με την απόφαση 570/27-1-2003, θα γίνει από τα Νοσοκομεία που η παρούσα σύμβαση αφορά.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια, η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης 247/2001, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 394/88 (ΦΕΚ 266/α/4-12-96). Υστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε δύο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Γραφείο του Υπουργείου Ανάπτυξης και το άλλο πήρε, σαν διπλόγραφο, ο προμηθευτής, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Για την Προμηθεύτρια
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ

Handwritten signature and stamp of the Greek State

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

Θεωρείται η παρούσα σύμβαση ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ
παραβρισμένη με αριθμό ΕΠΕΛΟΓΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ
3124/10.5.02 και κατατίθεται στο Τμήμα Γ Τηλ: 9647500 - ΑΦΜ: 095150749
ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΟΣ

Handwritten signature and stamp of the contractor

Handwritten signature of the contractor


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 21/04/60/0000
Για συμβατική αμοκθάραση E1

Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου

AK-95S Gambro
Για παραλλανές της συμβατικής αμοκθάρασης E2

Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου

AK-200S Gambro

Με Ενσωματωμένο αυτόματο πισόμετρο BPM

Ενσωματωμένο όργανο μέτρησης και ένδειξης PH

Μπαταρία εφεδρικής

Δύο αντλίες αίματος

Εξοπλισμό κατασκευής: Gambro Lundia AB, Σουηδίας.

Χώρα προέλευσης: Σουηδία.

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 2002 για το AK-95S

2001 για το AK-200S

Έτος κατασκευής: 2002

Ισχύς Προσφοράς:

Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως η διακήρυξή σας.

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας:

Τρία έτη από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία με τους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Σηρίξη. Αποδεχόμεθα όλους τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

Τεχνική Σηρίξη:

Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς μας και αναφέρεται στους όρους συντήρησης για το διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και σε τρόπους συντήρησης των προσφερομένων μηχανημάτων για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

...


Αντικατάσταση.

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα για τον οποίο γίνεται η προμήθεια, να αντικαταστήσουμε ολόκληρο το μηχανήμα εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.

Επάρκεια ανταλλακτικών:

Όπως στη συντημένη τεχνική στήριξη αναφέρεται, διαθέτουμε για μία δεκαετία. Για την παράδοση, stock ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία. Για την λειτουργία των προσφερομένων μηχανών δεν απαιτούνται αναλώσιμα ανταλλακτικά ή άλλα ειδικά εξαρτήματα.

Εκπαίδευση Τεχνικών:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προσφίρονται τα μηχαν/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα.

Εκπαίδευση Προσωπικού:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του Ιατρικού-Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσ/μείων για τα οποία προσφίρονται τα μηχαν/τα, στην χρήση των προσφερομένων μηχανημάτων στον τόπο λειτουργίας τους και για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο.

Επίδειξη:

Αναλαμβάνουμε να επιδείξουμε τα προσφερόμενα μηχανήματα, σε τόπο και χρόνο που θα μας υποδειχθεί από την Επιτροπή.

Παράδοση:

Τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι ασφαλισμένα μέχρι τις αποθήκες των διαφόρων Νοσ/μείων όπως διακηρύχθηκε, θα παραδοθούν στο χώρο που θα μας υποδειχθεί στα Νοσοκομεία, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πρωτότυπα εγχειρίδια δηλ.: (service manual - οδηγίες συντήρησης, operator's manual - οδηγίες χειρισμού στα Ελληνικά, ηλεκτρονικά τοπογραφικά σχέδια, κατάλογο ανταλλακτικών - spare parts list και εγχειρίδιο ρυθμίσεων-adjustment manual), όπου θα γίνει και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή (εγκατάσταση) χωρίς καμιά ξεχωριστή επιβάρυνση.

10

Τόπος Παράδοσης:

Στα διάφορα Νοσ/μεία, όπως η διακίχη σας παρ/μια Α1.

Χρόνος Παράδοσης:

Εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης για όλα τα ποσά των ζητούμενων μηχανημάτων.

Χρόνος Παραλαβής: Όπως η διακίχη σας.


Συνημμένα σας υποβάλλουμε:

1. Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές
2. Δήλωση περί αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού, περί συμμόρφωσης ή απόκλισης από τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης καθώς και επιστημοποίησης όλων των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει η προσφορά μας.
3. Δήλωση χρόνου παράδοσης.
4. Λίστα Νοσοκομείων που η Εταιρεία μας έχει εφοδιάσει με μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού Gambro.
5. Τεχνική στήριξη με όρους συντήρησης για το διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και προτάσεις συντήρησης για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.
6. Τεχνικές Περιγραφές.
7. Φύλλα συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της διακίχης.
8. Prospectus και πιστοποιητικά CE.

Με τιμή,

Για την Εταιρεία
 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠ.Ε.,

ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
 Διαχειριστής



Handwritten signature and date 11.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 21/04/50/00/0

Για συμβατική αποκόμηση:

Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου

AK-95S Gambro

έκαστο

Ευρώ: *****

Για παραλλαγές της συμβατικής αποκόμησης.

Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού τύπου

AK-200S Gambro

Με

Ενσωματωμένο αυτόματο πιεζόμετρο BFM
 Εναρμονισμένο όργανο μέτρησης και ένδειξης PH
 Μητάρια εφεδρείας
 Δύο αντλίες αίματος

έκαστο

Ευρώ: *****

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 18%

Εργοστάσιο κατασκευής: Gambro Lundia AB, Σουηδίας.

Χώρα προέλευσης: Σουηδία.

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 2002 για το AK-95S
 2001 για το AK-200S

Έτος κατασκευής: 2002

Ισχύς Προσφοράς:

Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως η διακήρυξη σας.

Handwritten signature and date 12.

Εννόηση Καλής Λειτουργίας:

Τρία έτη από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία με τους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Στήριξη. Αποδεχόμεθα όλους τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

Τεχνική Στήριξη:

Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς μας και αναφέρεται στους όρους συντήρησης για το διάστημα εννέα (9) ετών καλής λειτουργίας καθώς και σε τρόπους συντήρησης των προσφερόμενων μηχανημάτων για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Αντικατάσταση:

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα για τον οποίο γίνεται η προμήθεια, να αντικαταστήσουμε ολόκληρο το μηχανήμα ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.

Επίδοκεια ανταλλακτικών:

Όπως στη συνημμένη τεχνική στήριξη αναφέρεται, διαθέτουμε για άμεση παράδοση, stock ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία. Για την λειτουργία των προσφερόμενων μηχανών δεν απαιτούνται αναλύσιμα ανταλλακτικά ή άλλα ειδικά εξαρτήματα.

Προκατάλογος ανταλλακτικών:

Κατατίθεται προκατάλογος ανταλλακτικών.

Εκπαίδευση τεχνικών:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προσρίζονται τα μηχαν/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBERO στη Lunā Σουηδίας (μόνον για αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα.

Εκπαίδευση προσωπικού:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του Ιατρικού-Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσ/μείων για τα οποία προσρίζονται τα μηχαν/τα, στην χρήση των προσφερόμενων μηχανημάτων στον τόπο λειτουργίας τους και για όσο χρόνο κρίβει απαραίτητο.

Επίδειξη:

Αναλαμβάνουμε να επιδείξουμε τα προσφερόμενα μηχανήματα, σε τόπο και χρόνο που θα μας υποδειχθεί από την Επιτροπή.

Παράδοση:

Τα προσφερόμενα μηχανήματα είναι ασφαλισμένα μέχρι τις αποθήκες όπου διαφόρων Νοσ/μείων όπως διακίχη σας, θα παραδοθούν στο χώρο που θα μας υποδειχθεί στα Νοσοκομεία, συναδεδεμένα από τα απαραίτητα πρωτότυπα εγχειρίδια δηλ.: (services manual - οδηγίες συντήρησης, operation manual - οδηγίες χειρισμού στα Ελληνικά, ηλεκτρονικά τοπογραφικά σχέδια, κατάλογο ανταλλακτικών - spare parts list και εγχειρίδιο ρυθμίσεων adjustment manual), όπου θα γίνει και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή (εγκατάσταση) χωρίς καμιά ξεχωριστή επιβάρυνση.

Τόπος Παράδοσης:

Στα διάφορα Νοσ/μεία, όπως η διακίχη σας παρ/μα Α1.

Χρόνος Παράδοσης:

Εντός εφίντα (60) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης για όλη την ποσότητα των ζητούμενων μηχανημάτων.

Χρόνος Παραλαβής:

Όπως η διακίχη σας.

Τιμές:

Δίδονται τιμές σε Ευρώ, για παράδοση ελεύθερα στα διάφορα Νοσ/μεία, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αναφέρονται στην διακίχη σας, πλην του ΦΠΑ. Το ποσοστό ΦΠΑ είναι 18% επί της τιμής και βαρύνει το φορέα.

Τρόπος πληρωμής:

Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή, όπως η διακίχη σας.

Με τιμή,

Για την Εταιρεία
 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.,

ΚΩΝΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
 Διοχειριστής

14

Εννόηση Καλής Λειτουργίας:

Τρία έτη από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία με τους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Στήριξη. Αποδεχόμεθα όλους τους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

Τεχνική Στήριξη:

Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς μας και αναφέρεται στους όρους συντήρησης για το διάστημα εννέα (9) ετών καλής λειτουργίας καθώς και σε τρόπους συντήρησης των προσφερόμενων μηχανημάτων για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Αντικατάσταση:

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα για τον οποίο γίνεται η προμήθεια, να αντικαταστήσουμε ολόκληρο το μηχανήμα ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.

Επίδοκεια ανταλλακτικών:

Όπως στη συνημμένη τεχνική στήριξη αναφέρεται, διαθέτουμε για άμεση παράδοση, stock ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία. Για την λειτουργία των προσφερόμενων μηχανών δεν απαιτούνται αναλύσιμα ανταλλακτικά ή άλλα ειδικά εξαρτήματα.

Προκατάλογος ανταλλακτικών:

Κατατίθεται προκατάλογος ανταλλακτικών.

Εκπαίδευση τεχνικών:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προσρίζονται τα μηχαν/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBERO στη Lunā Σουηδίας (μόνον για αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα.


Εκπαίδευση προσωπικού:

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του Ιατρικού-Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσ/μείων για τα οποία προσρίζονται τα μηχαν/τα, στην χρήση των προσφερόμενων μηχανημάτων στον τόπο λειτουργίας τους και για όσο χρόνο κρίβει απαραίτητο.

15

Φύλλο συμμόρφωσης στους Ειδικούς Όρους της Διακείμενης

1. Κατατίθενται προσπερσιους των προσηφωρμένων μηχανημάτων απαιτείται από την διακίρυξη.
2. Κατατίθεται πιστοποητικό έτους πρώτης κυκλοφορίας και για τους τύπους των προσηφωρμένων μηχανημάτων. Και οι δύο μηχανημάτων είναι κατασκευής 2002.
3. Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι τρία έτη με πλήρη κάλυψη όλων των απαιτούμενων όρων της διακίρυξης.
4. Ο τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού, Ιατρικού-νοσηλευτικού και τεχνικού, αναφέρεται αναλυτικά στην σελίδα 3 της Τεχνικής Προσηφωράς.
5. Ανταλλακτικά θα βρισκονται σε έμμεση παραδοση για μία δεκαετία και θα παραδίδονται σε περίπτωση εισαγωγής, το αργότερο σε 15 ημέρες.
6. Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με την διακίρυξη.
7. Δίδεται Τεχνική Στήριξη που περιλαμβάνει όρους και προτάσεις για συντήρηση τουλάχιστον για δέκα χρόνια μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.
8. Κατατίθεται τιμοκατάλογος ανταλλακτικών στην Οικονομική Προσηφωρά.
9. Πιστοποητικό σύμφωνα με την Ε3/833 κατατίθεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής.



Παράρτημα Ε1

Μηχανήματα GAMBRO AK-95S & AK-200S

Φύλλο συμμόρφωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Τεχνητού Νεφρού για συμβατική αιμοκάθαρση



1. Οι προσηφωρμένες συσκευές Gambro τύπου AK-95S & AK-200S είναι καινούργιες αμεταχειριστές και σύγχρονης τεχνολογίας. Στην τεχνική προσηφωρά επισυνάπτονται αντίστοιχα προσπερσιους με τεχνικά στοιχεία την τεκμηρίωση όλων των στοιχείων.
2. Εργάζονται με ρεύμα πόλης 100-240 Volt, 50 ή 60 Hz.
3. Και οι δύο τύποι μηχανημάτων κάνουν αυτόματη αεριοδιόρθωση λειτουργιών-βλαβών-καλής λειτουργίας στην εκκίνηση τους πριν κάθε συνεδρία.
4. Έχουν τέλειους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας ώστε να προστατεύουν τον ασθενή είτε από ενδοχόμενη βλάβη είτε από κακό χειρισμό. Και στις δύο περιπτώσεις δίνουν γραπτές οδηγίες επεξεύρησης και επίλυσης του προβλήματος.
5. Και στους δύο τύπους μηχανημάτων εμπεριέχονται τα αντίστοιχα αυτοδιαγνωστικά προγράμματα (software) για τεχνικούς. Όλοι οι ελεγχόμενοι διαγνώσεις-ρυθμίσεις γίνονται μέσω των πάνελ χειρισμού των μηχανημάτων. Όλες οι παράμετροι λειτουργιών των συσκευών απεικονίζονται από τις συσκευές τόσο αναλογικά όσο και ψηφιακά, από τις αντίστοιχες οθόνες πλαστικών ενδείξεων που διαθέτουν. Όλα τα μηνύματα που απεικονίζονται στις οθόνες είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Μαζί με τις συσκευές θα παραδοθούν και προγράμματα επικοινωνίας για συμβατούς υπολογιστές, ώστε όλες οι ανωτέρω ενδείξεις να δύνανται να απεικονιστούν σ' αυτούς. Η σύνδεση γίνεται μέσω της ενσωματωμένης στα μηχανήματα θύρας RS-232.

6. Τόσο το AK-95S όσο και το AK-200S φέρονται σε τροχήλατες ανοξείδωτες μεταλλικές βάσεις με φρένα.

7. Και οι δύο τύποι μηχανημάτων έχουν ενσωματωμένους αναρτήρες φιαλών, φίλτρων και γραμμών που ρυθμίζονται σε ύψος.

8. Εργάζονται με οιοδήποτε τύπο φίλτρου-γραμμής οπιοιούδηποτε κατασκευαστή ανά τον κόσμο.

9. Έχουν ενσωματωμένα συστήματα κάθαρσης με μια βελόνα που ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός πλήκτρου. Εργάζονται με όποιο επιθυμητό συνδυασμό χρόνου ή και πίεσης (φλεβικής).

Το AK-95S εκτέλει μονή βελόνα με μια αντλία, το AK-200S με μια ή δύο κατ' επιλογήν.

10. Και οι δύο τύποι μηχανημάτων της Gambro διαθέτουν αντίλη ηπαρίνης τύπου σύριγγας υψηλής ακρίβειας κατάλληλη για σύριγγες έως και 30 cc κατ' επιλογήν του χειριστή.

11. Οι συσκευές διαθέτουν συστήματα μέτρησης και ελέγχου των ορίων της φθηριακής και φλεβικής πίεσης, με αντίστοιχα ασφαλολογικά όργανα αλλά και ψηφιακές ενδείξεις.

12. Και τα δύο μηχανήματα διαθέτουν ανιχνευτή αίματος ώστε να αρχίσουν τη μέτρηση όγκου αίματος, μόλις εισέλθει το αίμα στις γραμμές αίματος. Η ικανότητα μέτρησης συνολικού όγκου επεξεργασμένου αίματος είναι από 0-889,9 λίτρα. Ο έλεγχος ροής γίνεται από μικροηλεκτρονική μέτρηση των αντλιών αίματος και των αρτηριακών-φλεβικών αισθητήρων πίεσης που διαθέτουν οι συσκευές.

13. Είναι πλήρως αυτόματες και αυτόνομες ως προς την παραγωγή διαλύματος. Αυτό γίνεται με σερβοελεγχόμενους μηχανισμούς και ελαστικές ανάμιξης, μέσω μικροηλεκτρονικών, ώστε το τελικό διάλυμα να έχει σταθερότητα σύστασης άσχετα με την τυχόν διακόσμηση πικνωμάτων των συμπυκνωμάτων.

14. Είναι τύπου single-pass (απλής διέλευσης) διαλύματος από το φάρμακο κάθαρσης. Τα υδραυλικά τους κυκλώματα είναι ελάχιστα σε μέγεθος και όγκο νερού για καλύτερη υγιεινή των μηχανημάτων.

15. Παρασκευάζουν τόσο οξικά όσο και διττανθρακικά διαλύματα και επιλογή του χειριστή, μέσα από ένα κατάλογο (menu) έξι συνολικά διαθέσιμων τύπων συμπυκνωμάτων ώστε εάν τελειώσει ο ένας τύπος ο χειριστής να δύναται να επιλέξει άλλον, χωρίς καμιά άλλη επέμβαση ή ρύθμιση στο μηχανήμα. Οι έξι τύποι συμπυκνωμάτων προεπιλέγονται στο το νοσοκομείο ή προρυθμίζονται σε αντιστοιχες μνήμες του συσκευών.

16. Διαθέτουν συστήματα μεταβολής τόσο του Na⁺ όσο και των διττανθρακικών ριζών HCO₃⁻ του τελικού διαλύματος κατά την διάρκεια της κάθαρσης. Οι επιθυμητές αλλά και οι ενδοκυρίως τιμές είναι απευθείας σε χιλιοστομόδιονα Na⁺ και mmol για τις διττανθρακικές ριζές. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένδειξη σε mS (αγωγιμότητα).

17. Και οι δύο τύποι AK-95S & AK-200S έχουν ενσωματωμένα συστήματα παρασκευής διττανθρακικών από άνυδρο σκόνη νατρίου σε φύσιγγα Bicarb[®] της Gambro AB, όλες τις φύσιγγες των άλλων κατασκευαστών, πλην των ειδικά κατασκευασμένων και πατενταρισμένων για συγκεκριμένα και μόνον μηχανή, αλλά και από υγρά συμπυκνώματα τύπου B. Ενδεικτικά μερικές από τις φύσιγγες που δέχονται στην Ελληνική αγορά μέσω ανεξάρτητων από την Εταιρεία μας προμηθευτών είναι:

1. Doctcart της εταιρείας Doctum,
2. Vermacart της εταιρείας Verma Drugs
3. Niasocart της εταιρείας Nikisso
4. Altracart της εταιρείας Aithin-Drake Willock

18. Διαθέτουν συστήματα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης με μικροηλεκτρονικές μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού τύπου, χωρίς άμεση επαφή με το διάλυμα για ακριβέστερη μέτρηση και ευκολότερο καθαρισμό.

19. Με το πάτημα ενός πλήκτρου εκτελούν ξηρά κάθαρση αλλά και εναλλασσόμενη (sequential) σύμφωνα με την επιθυμία του χειριστή.

20. Διαθέτουν ενσωματωμένα ροόμετρα ροής διαλύματος, το AK-95S μηχανικό, το AK-200S ηλεκτρονικό.


21. Έχουν ενσωματωμένες αυτόματες λειτουργίες θερμικής-χημικής αποστείρωσης, απαεύωσης, πλυσίματος με νερό και αυτόματου αδεισίματος του νερού στο τέλος κάθε κύκλου πλυσίματος ή αποστείρωσης.

Σχετικά με σήμανση CE
Οι προσφερόμενες συσκευές τεχνητού νεφρού είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42 EOK /14-6-93 και τόσο αυτές όσο και τα manual που τις συνοδεύουν φέρουν την σήμανση CE.

[Handwritten signature and initials]

Παράρτημα Ε2
Μηχανήματα GAMBRO AK-200S

Φύλλο συμμόρφωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Τεχνητού Νεφρού για παραλλαγές της συμβατικής αιμοκάθαρσης



Επιπλέον των αναφερόμενων η συσκευή AK-200S

α) Εκτελεί την μέθοδο Haemodiafiltration τόσο με σκόνη όσο και με υποκατάστασης όσο και με την μέθοδο ON-LINE (προαιρετικά).

β) Διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα διαχρονικού προφίλματος (profiling) για τις παραμέτρους:

- 1) Na⁺
- 2) HCO₃⁻
- 3) υπερδιήθησης (UF)

Ο έλεγχος γίνεται με έγχρωμα γραφήματα από την έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.

γ) Η συσκευή AK-200S χρησιμοποιεί κάθε τύπο φίλτρου σχεδώς συντελεστή υπερδιήθησης, οιοδήποτε κατασκευαστή, ανεξάρτητα εάν προορίζεται για συμβατική ή για όπια παραλλαγή αιμοκάθαρσης.

Επιπρόσθετα:

δ) Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία επαναφορτιζόμενη που του δίνει αυτόνομα λειτουργίας 30 περίπου λεπτών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ε) Διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο πιεσόμετρο (BPM) λήψης και καταγραφής της πίεσης του αρώστου.

ς) Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα όγκου αίματος (BVS), για την αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή της αιμοσφαιρίνης του αρώστου.

η) Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα παρασκευής διαλύματος από ξηρά συμπυκνώματα (SELECT) ενεργοποιούμενο και επιλογήν του χειριστή.

θ) Διαθέτει ενσωματωμένο όργανο μέτρησης και ένδειξης του pH του διαλύματος αιμοκάθαρσης...

Σχετικά με σήμανση CE

Οι προσφερόμενες συσκευές τεχνητού νεφρού είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42 EOK /14-6-93 και τόσο αυτές όσο και τα manual που τις συνοδεύουν φέρουν την σήμανση CE.


[Handwritten signature and initials]

MEDICAL PRODUCTS LTD

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.

Γ. Γεωργιάδου 54
165 62 Αθήνα
Τηλ: +30 | 9647500
Fax: +30 | 9650500
E-Mail: info@mediproduct.gr

Προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
Γεν. Δ/ση Κρατικών Προμηθειών
Δ/ση Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλ.
και Επιστημονικών Οργάνων
Τμήμα Γ
Κόρινθος 20, 101 81 Αθήνα



Σημειώνεται: Διακηρυγή σας με αριθ. 247/01, δημόσιου, ανοικτού, διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών Τεχνητού Νεφρού για το φορέα Υπ. Υγείας- Πρόνοιας (διάφορα νοσοκομεία), που θα γίνει στις 8/7/2002 όπως ανακοίνωση 3124/10.5.02

ΔΗΛΩΣΗ

Ως μετέχοντες στο διαγωνισμό που γίνεται με βάση την παραπάνω διακήρυξη

δηλώνουμε

ότι όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού θα παραδοθούν εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

Με τιμή,

Για την Εταιρεία
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.,

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Διαχειριστής

MEDICAL PRODUCTS LTD

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.

Γ. Γεωργιάδου 54
165 62 Αθήνα
Τηλ: +30 | 9647500
Fax: +30 | 9650500
E-Mail: info@mediproduct.gr

Προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
Γεν. Δ/ση Κρατικών Προμηθειών
Δ/ση Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλ.
και Επιστημονικών Οργάνων
Τμήμα Γ
Κόρινθος 20, 101 81 Αθήνα



Σημειώνεται: Διακηρυγή σας με αριθ. 247/01, δημόσιου, ανοικτού, διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών Τεχνητού Νεφρού για το φορέα Υπ. Υγείας- Πρόνοιας (διάφορα νοσοκομεία), που θα γίνει στις 8/7/2002 όπως ανακοίνωση 3124/10.5.02

ΔΗΛΩΣΗ

Ως μετέχοντες στο διαγωνισμό που γίνεται με βάση την παραπάνω διακήρυξη

δηλώνουμε

1. Ότι αποδεχόμεθα χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους, γενικούς και ειδικούς της διακήρυξης του διαγωνισμού.

2. Ότι επιστημονούμε όλα τα συνημμένα της προσφοράς μας στοιχεία και δεχόμεθα ανεπιφύλακτα να αποτελέσουν στοιχεία κρίσεως μιας όπως η βασική προσφορά.

3. Ότι τα προσφερόμενα από εμάς μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού συμφωνούν απόλυτα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της παραπάνω διακήρυξης (αναλυτικά περιγράφονται στα φύλλα συμπόρωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους) και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από αυτές.

Με τιμή,

Για την Εταιρεία
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.,


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Διαχειριστής

20

Ανήκει στην Οικονομική Προσφορά

MEDICAL PRODUCTS LTD
 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ.
 info@medprod.gr

Γ. Γαβριηλάδ 54, 165 62 Αγία Ευφρόσ, Αθήνα ☎ +30 1 9647500 📠 -30 1 9647500 🌐 info@medprod.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Η τεχνική στήριξη όλων των προσφερομένων μηχανημάτων-συστημάτων και γενικά η συμμόρφωσή μας στις Μονάδες Τεχνικού Νεφρού είναι γνωστή ήδη στους αρμόδιους όλων των Νοσοκομείων που αναφέρονται στη Λίστα Πελατών μας.

Από πλευράς τεχνικών, έχουμε να σας γνωρίσουμε ότι διατίθενται στην Ελλάδα δεκατέσσερες πιπυούχοι ηλεκτρονικοί, εκπαιδευμένοι στο κατασκευαστή Οίκο, με βεβαίωση.

Εξή από αυτούς καλύπτουν τον χώρο της Β.Ελλάδας.

Ο χρόνος παρέμβασης των τεχνικών μας είναι, εντός 48ώρου, και καλύπτεται ο χρόνος Κυριακών και αργιών.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανών η αποκατάσταση τυχόν βλάβης περιλαμβάνει δωρεάν ανταλλακτικά εργασία - έξοδα μεταφοράς και επιστροφής. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις επισκευών και υλικών που οι βλάβες οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες φωτιά, νερό, σεισμό, και κακό χειρισμό των μηχανημάτων με σκοπιμότητα ή όχι π.χ. πτώση, κτύπημα από το προσωπικό ή επισκέπτες, ή τέλος από κακή λειτουργία τροφοδοσίας ρεύματος και νερού.

Διαθέτουμε stock ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία, η δε απόστολή τους θα γίνεται εντός 24 ωρών από έγγραφη ειδοποίηση.

Κάθε τρείς μήνες θα γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση.


Ο χρόνος παρέμβασης στην εκτός λειτουργίας συσκευή δεν ξεπερνά κάποιες ώρες. Σε περίπτωση όμως μεγάλης βλάβης της συσκευής θα την αντικαταστήσουμε με άλλη φεδρική που διαθέτουμε, μέχρι την επίκευή της. Πάντως, κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, η εκκρητοποίηση του μηχανήματος δεν θα ξεπερνά συνολικά τις πέντε μέρες τον χρόνο.

Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα παραδοθούν τα μηχανήματα σε εύρυθμη λειτουργία.

Μετά τον χρόνο της εγγύησης υπάρχουν οι παρακάτω τρείς τρόποι συνεργασίας για την τεχνική στήριξη των Μηχανημάτων μας.

Οι τμές που αναφέρονται παρακάτω και για όλες τις προτεινόμενες περιπτώσεις είναι σημερινές και αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο σύμφωνα με τον επίσημο Δ.Τ.Κ. (Δείκτη Τιμών Καταναλωτή).

(Handwritten signatures and notes)
 24



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΚ.96/S	ΑΚ.10	RCM	RCM	AK.90/S	AK.100	RCM
ΠΑΥΣΑΝΑΦΕΡΤΕΛΟ	2	7	2	2	2	1	1
ΠΑΥΣΑΝΑΦΕΡΤΕΛΟ	1	7	2	2	2		
ΠΕΡΕΤΕΛΟ	4	4	4	4	5	5	1
ΠΕΡΕΤΕΛΟ	1	2					
ΠΕΡΕΤΕΛΟ	2	5			4		
ΠΕΡΕΤΕΛΟ	3	7	7	9			
ΠΕΡΕΤΕΛΟ	3	10	10	9			
ΠΕΡΕΤΕΛΟ	1	6	7	7	2	1	1
ΠΕΡΕΤΕΛΟ		11	7	7	2		
ΠΕΡΕΤΕΛΟ		7	6	6	2		
ΠΕΡΕΤΕΛΟ		10	4	4			
ΠΕΡΕΤΕΛΟ		8	1	1	2	1	
ΠΕΡΕΤΕΛΟ		12	9	4	5	3	
ΠΕΡΕΤΕΛΟ	1	4	2	2			
ΠΕΡΕΤΕΛΟ	5	2					

(Handwritten signature and initials)
 24

A.- Ετήσιο πλήρες συμβόλαιο για συντήρηση και επισκευές χωρίς ανταλλακτικά.

Στην περίπτωση αυτή η κατά μήνα χρέωση είναι 161,41,- Ευρώ (εκατόν εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) ανά Μηχάνημα. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι επισκευές καθώς και τέσσερις υποχρεωτικές επισκέψεις τον χρόνο για συντήρηση.

Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής των τεχνικών μας.

Δεν περιλαμβάνονται τα αντικαταστάσιμα ανταλλακτικά των επισκευών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται το συμβόλαιο με εγγυητική επί ορισμένου χρόνου.

B.- Επίσης πλήρες συμβόλαιο για συντήρηση και επισκευές με ανταλλακτικά

Στην περίπτωση αυτή η χρέωση των επισκευών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών είναι 220,00,- Ευρώ (διακόσια είκοσι Ευρώ) ανά μήνα, ανά Μηχάνημα.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι επισκευές, όλα τα ανταλλακτικά καθώς και τέσσερις υποχρεωτικές επισκέψεις το χρόνο για συντήρηση. Η τιμή περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις πλήρη του ΦΠΑ. Το συμβόλαιο καλύπτεται με εγγυητική επιστολή.

Έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν εμάς.

Γ.- Τιμή κλήσης κατά περίπτωση

Σε αυτή την περίπτωση η κάθε κλήση χρεώνεται με 542,92,- Ευρώ (πεντακόσια σαράντα δύο Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά) η πρώτη μέρα και εφόσον παραταθεί η παραμονή η κάθε μέρα επί πλέον χρεώνεται με 161,41,- Ευρώ (εκατόν εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά).

Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και επιστροφής βαρύνουν εμάς. Σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς του μηχανήματος στο εργαστήριο, γίνεται επιπλέον χρέωση 176,08,- Ευρώ (εκατόν εβδομήντα έξι Ευρώ και οκτώ λεπτά).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Η αντροσαρμολή των τιμών γίνεται και εδώ τιμησιακά κάθε χρόνο.

Στην περίπτωση αυτή εγγυώμεθα μόνο την εργασία που εμείς κάνουμε και όχι τυχόν άλλες παρεμβάσεις που έγιναν από τρίτους στο μηχάνημα. Τα ανταλλακτικά βαρύνουν το Νοσοκομείο σας.

Αυτόνομο service στα Νοσοκομεία

Η, κατά την γνώμη μας, συμφέρουσα λύση είναι να οργανώσουμε εμείς το service του Νοσοκομείου, δηλαδή:


Να εκπαιδεύσουμε τεχνικούς (1-2) με τους παρακάτω όρους:

- Να είναι ηλεκτρονικοί.
- Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιάς ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο. Την υποχρέωση αυτή την έχουμε στο Νοσοκομείο.

Στη περίπτωση που θα συνεργαστούμε με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, θα συστήσουμε τα όργανα και εργαλεία που χρειαζονται και θα βοηθήσουμε για την οργάνωση του Εργαστηρίου Συντήρησης - Επισκευής Τεχνιτού Νεφρού.

Με το σύστημα αυτό και έχοντας πλήρη σειρά ανταλλακτικών, θα προσπαθήσουμε να γίνει το Νοσοκομείο αυτόνομος και ανεξάρτητος.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι για την απόδειξη των ισχυρισμών μας για την ύπαρξη τεχνικών είναι στη διάθεσή σας οι μεθοδολογικές καταστάσεις που αφορούνται οι παραπάνω τεχνικοί από χρόνια. Για την απόδειξη της ύπαρξης stock ανταλλακτικών για μια δεκαετία, είναι στην διάθεσή σας οι επίσημες καρτέλες αποθήκης και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας για την προσωπική σας αντίληψη.

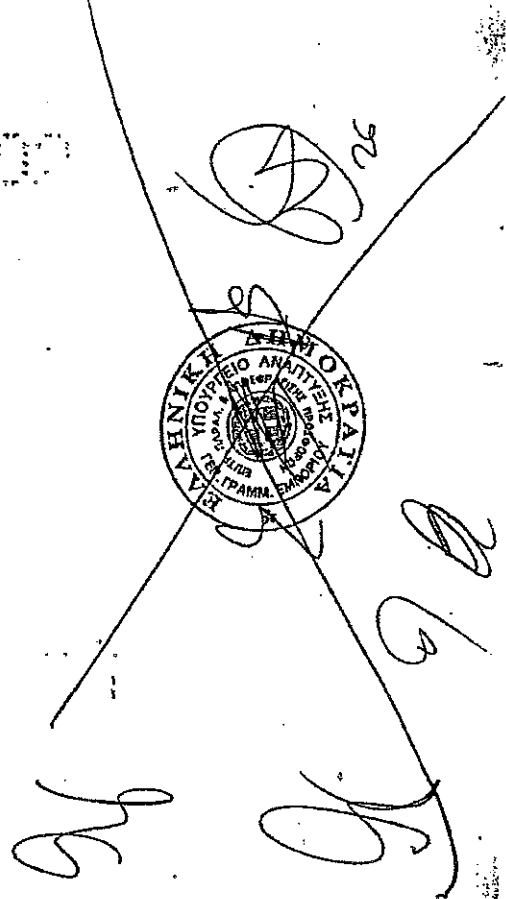

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100000001	TRANSISTOR BD677AR	2.22
100000018	TRANSISTOR BUZ 32	5.84
100000022	HEX DIP IRFD113 AK100	3.74
100000082	TRANSISTOR	5.38
100002009	DIODE 3051	0.88
100002026	BRIDGE RECTIFIER GA.70V	11.24
100002043	SCHOTTKY DIODE	2.78
100005026	OPTO SWITCH	34.75
100006055	OPTO SWITCH PS2501-2 AK100	4.80
100006111	OPTO-COUPLER	13.58
100007003	FILTER	38.61
100010032	IC MC1723CL	4.35
100010035	DRIVER ULN-2003A	5.58
100010037	AMPLIFIER LM324AN	5.88
100010038	IC MC1400BCP	4.13
100010039	IC MC14002BCP	1.63
100010046	CPU 8080 A	54.42
100010048	IC P8228	53.88
100010050	IC C8255	115.00
100010051	IC P8224	27.05
100010053	IC LM339N	2.74
100010057	IC LM 323K	26.28
100010062	IC DAC-08EZ	10.08
100010063	MC7812 CK	13.00
100010072	IC LM 148	21.04
100010073	IC REF 01CJ	14.46
100010074	IC MC14051BCP	2.46
100010081	IC AD 7550 BD	88.25
100010082	IC AD 7502 JD	25.80
100010091	TTL SN74LS138N	2.24
100010095	RAM MB8114N	28.68
100010097	D/A CONV AD 558 JN	47.51
100010098	IC MK50876N	124.24
100010100	IC RPWM SG 3526 J	20.19
100010103	PROGR.INTER.CONT.	15.74
100010112	RAM 6116	41.74
100010113	TIMER AM 8519APC	143.75
100010116	IC SPACE TL 074	17.67
100010118	VOLTAGE REF.	14.24
100010121	RPWN	6.33
100010137	IC MICROCOMP MPD 8039	19.15
100010138	EPROM 8755 (K08200)	89.71
100010143	VOLTF. MONITOR 5 G 3543	32.50
100010147	STEPPING MOTOR DRIVER	13.03
100010163	DQ 2816 A-350	44.87
100010198	OCTAL-D-TYP	4.60
100010199	SN 75437	11.17
100010200	V/F CONVERTER VFC32KP AK100	18.20
100010239	C-MOS 74HCT157AP AK100	3.01
100010240	C-MOS 74HCT245P AK100	5.02
100010276	HCT-MOS PCT74HCT14P AK100	2.13
100010288	IC PCD 8582	13.31
100010303	CPU AK100	92.00
100010318	IC AK 100	27.47
100010320	IC 4-PIN 1C16MHZ	23.22
100010326	CMOS DG509ACJ AK100	22.81
100010332	S RAM 32KB8	22.19
100010334	IC 18-PIN ULN2803A AK100	5


27




ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100010351	IC LT1014CN	37.78
100010357	IC PC 744CT	1.08
100010375	EEPROM 8KX8 2864 AE	95.41
100010421	EEPROM	11.61
100010438	S RAM AK100	153.66
100010460	V/F CONVERTER AK 100	127.60
100010534	NON-VOLATILE RAM AK100	34.83
100010564	SAFE RAM IC66	279.29
100010669	DRIVER	53.19
100010670	SRAM	148.57
100010709	DIL 40 KEYBOARD	41.84
100102008	RESISTOR 18 OHM	2.40
100104007	RESISTOR 3R3 OHM	0.58
100104009	RESISTOR 4R7	0.58
100104045	RESISTOR 1KOHM	1.08
100104046	RESISTOR 1K2	0.58
100104047	RESISTOR 1K5 OHM	0.58
100104060	RESISTOR 10K	0.58
100105051	RESISTOR 3K6	0.58
100105055	RESISTOR 7K2	0.58
100106010	TRIMPOT 5K	3.12
100106013	TRIMEK 50 KQ	3.12
100106014	TRIMPOT 1K	3.20
100106025	TRIMPOT 10K	3.12
100114930	CAPACITOR 47 mF	1.12
100114031	CAPACITOR 100 mF	1.11
100118032	CAPACITOR 150pf	1.11
100120018	TRANSIENT PROTECTOR 5V	7.32
100200019	RELAY 24 VDC, 8A, 220V	63.48
100200021	BAZER 12V 25MA	45.34
100200029	RELAY 12 VDC, 16 A, 380V	112.95
100200035	RELAY MONOIST SA - 24V	63.31
100200038	OPTO RELAY 240D 25	93.64
100200042	RELAY 24 VDC 53104	48.63
100200043	RELAY 12 VDC 16A 380V	54.76
100200046	RELAY	48.05
100200047	BUZZER 3-15V, 20MA	21.27
100200049	RELAY 6VDC 5A BIST	70.92
100200050	RELAY 12V DC 330Q	29.71
100200051	RELAY AK100	57.50
100200055	BUZZER AK-100	27.16
100200067	RELAY 24 VDC	29.80
100200070	RELAY	54.32
100202067	FLAT CABLE CONNECTOR	24.56
100202068	CONNECTION JOINT	19.71
100202071	CONNECTORS	1.50
100202072	CONNECTOR HOUSING	1.48
100202074	CON PCB 40-POLE	45.18
100202075	CON (50-POLE)	32.86
100202088	CONNECTORS	10.68
100202102	CONNECTOR	1.53
100202103	CONNECTOR HOUSING	1.15
100202105	CABLE CONNECTOR	9.77
100202108	CONNECTOR	10.68
100202130	PC CONNECTOR	7.89
100202158	CONNECTOR D-SUB 9 POL M	9.45
100202167	CONNECTOR	0.84
100203047	CONNECTOR 3 PIN	1.44

28



28



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΜΗΡ ΠΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100203048	CONNECTOR SLEEVE	1.34
100203063	CONNECTOR PIN	0.87
100205042	COVER	1.45
100206004	DIP SHUNT	2.85
100208015	SIGNAL PUSH BUTTON 52015	71.53
100208016	SIGNAL PUSH BUTTON 52016	85.43
100208017	SIGNAL SWITCH	87.77
100208047	SWITCH	48.90
100208048	PUSH SWITCH	41.57
100209020	CAP. RED	4.01
100209021	LAMP LENS	4.81
100209022	GUARD	11.99
100209025	LENS	4.01
100210010	SIGNAL LAMP HOLDER 51320	30.80
100212001	FUSE HOLDER	7.53
100212002	FUSE HOLDER	8.98
100212004	FUSE HOLDER	7.85
100212005	FUSE HOLDER	7.28
100212006	FUSE INSERT	4.01
100212007	FUSE INSERT	5.12
100212011	FUSE HOLDER	7.06
100213007	FUSE F 1A (MONITOR)	0.78
100213008	FUSE 2.0 A FAST	0.78
100213009	FUSE 3.15 A FAST	0.78
100213010	FUSE 315 UA MA SLOW	0.78
100213015	FUSE 4A SLOW	1.17
100213042	FUSE 630MA SLOW	4.70
100213052	FUSE 10A FASTOW	1.17
100213055	FUSE 125 MA SLOW	1.17
100213057	FUSE 2.5A SLOW	1.17
100213073	FUSE	2.68
100213100	FUSE 6.25	1.32
100214029	CABLE GLIP	0.63
100214082	CABLE GRIP	0.63
100216024	MOTOR (PUMP)	173.05
100218012	NONRETURN VALVE	48.88
100220081	FLAT CABELING	13.34
100222018	LAMP 14V	4.52
100222017	LAMP 36V 30MA	4.89
100222028	LAMP AK-100	6.13
100222029	LAMP (ORANGE) AK-100	5.72
100222031	LAMP (GREEN) AK-100	5.72
100222032	LAMP (YELLOW) AK-100	48.07
100224006	BATTERY 9V	20.15
100224012	ACC.LI 3V 160mah AK100	28.34
100228002	MICRO SWITCH	33.73
100228009	MICRO SWITCH	370.75
100228020	PRESS. TRANSDUC.	6.13
100300016	PLASTIC WHEEL	7.36
100300017	WHEEL	5.52
100300018	PLASTIC WHEEL	7.68
100300021	WHEEL	3.07
100300046	WHEEL	19.08
100300058	KNOB	2.63
100301002	DIAL PLATE	1.19
100301004	ROUND NUT	3.27
100301006	STATOR	1.49
100301011	ROUND NUT	1.49



2P


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΜΗΡ ΠΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100301012	COVER PLATE	2.51
100301013	COVER PLATE	0.89
100301014	COVER PLATE	0.69
100301015	DIAL PLATE	2.69
100301016	DIAL PLATE	2.79
100301017	STATOR	3.25
100301018	ROUND NUT	1.78
100301027	COVER CUP	1.79
100304065	BOARD GUIDE	7.48
100304064	WHEEL AK-90	13.80
100307001	RUBBER FOOT	1.89
100307011	RUBBER FOOT	6.41
100307012	RUBBER FOOT	8.82
100312010	SHRINK TUBE	9.22
100312012	SIK TUBE 6X1.6	8.67
100312017	SIK TUBE 8X2.1	29.33
100312020	SIK TUBE 3X1	8.84
100312031	SIK TUBING 2X1	8.20
100312032	SILICONE TUBING	10.19
100312037	SIK TUBING 1X1	11.98
100312066	TUBE 1.5X8	9.36
100312078	ARMOURD TUBE 1.0 6MM	11.98
100312084	DEGLASSING TUBE AK100	8.36
100312093	ARM.SIK.TUBING 5X30.0 MM	28.47
100312141	SANTOPRENE TUBE	7.53
100313253	PRESSURE REGULATOR	579.89
100314015	STRAP 0-18 MM	0.74
100314016	STRAP 0-30MM	0.74
100314060	BLISH	0.74
100314068	STRAP	0.74
100314189	INSULATE CASE	0.86
100314181	CLAMP BCH 10	1.18
100314184	CLIPS	1.26
100316001	PLASTIC SCREW 3X15	0.70
100316004	NYLON NUT M3	0.70
100316015	DISTANCE TUBE	0.50
100316027	INSERT AK90	3.23
100316030	SLEEVE	1.28
100316034	PLASTIC SCREW MCS 3X20	0.63
100316061	PLASTIC NUT 10M	1.26
100316074	SPACER	1.89
100316081	SPACER	3.84
100316107	FILTER HOUSING	119.72
100316134	PLASTIC NUT	0.77
100318010	O-RING 4.1 X 1.6	0.71
100318051	O-RING (15X24)	0.36
100318054	O-RING (5X1.6)	1.40
100318056	O-RING 86.6X1.6	3.78
100318061	ORING 22.1 X 1.6	0.70
100318064	ORING 11.5 X 1.9	0.70
100318085	O-RING (5.28X1.78)	0.85
100318086	V-RING-STIRER DFJUD	6.73
100318090	O-RING (3.2X1.78)	0.69
100318084	O-RING (10.5X1.6)	0.73
100318085	RING 107.32X5.34	3.08
100318086	V-RING 11.5-12.5	2.09
100318091	O-RING 19.1 X 1.6	1.85
100318102	WASHER	2.87



30

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤ/ΚΟΥ
100318107	O-RING 74.61X3.53	1.52
100318109	O-RING BICART	0.71
100318110	O-RING (BICART) AK-100	13.39
100318111	O-RING EPDM	4.78
100318001	O-RING (89.2X3) STIRER	2.93
100318002	O-RING 3.3X2.4	2.78
100318003	ORING 7.1 X 1.8	0.73
100318004	CEM O-RING	2.00
100318006	O-RING (42X2.5)	1.93
100318007	O-RING (19.2X3)	1.53
100318008	O-RING (8.3X2.4)	0.89
100318009	O-RING (12.37X2.82)	1.45
100318010	O-RING	1.53
100318011	O-RING (37.7X2.62)	2.78
100318012	O-RING (15.6X1.78)	3.35
100318013	O-RING (19.1X1.6)	3.35
100318014	O-RING (4.1X1.6)	2.18
100318015	O-RING (45X2)	2.78
100318016	O-RING 5.28 X 1.78	1.79
100318019	O-RING (6.1X1.6)	1.40
100318020	O-RING (10.1X1.6)	1.40
100318022	O-RING	2.01
100318023	O-RING	1.40
100318024	O-RING 10X3	3.68
100318025	O-RING 6.1X6.1	1.40
100318028	O-RING 7.3X2.4	1.40
100318027	O-RING 9.1X1.6	1.40
100318028	O-RING 10.3X2.4	2.01
100318029	O-RING 15.3X2.4	1.51
100318030	O-RING 59.5X3	3.70
100318031	O-RING 6.07X1.78	2.51
100318032	O-RING ELECTRODE	2.85
100318033	O-RING 13.3X2.4	3.53
100318037	O-RING 23X1.5	4.38
100318038	O-RING 27X1.5	4.31
100318039	O-RING 5.3X2.44	1.51
100318042	ORING 22.3 X 3 SILICON	2.09
100318044	ORING 34.2 X 3.0	3.23
100318046	O-RING AK-100	1.58
100318047	O-RING AK-100	2.51
100318050	O-RING 22.1X1.6	1.51
100318051	O-RING 44.2X3.0	2.79
100318054	O-RING 0.5X1	3.35
100318055	O-RING AK100	2.05
100318055	ORING 17.3 X 2.4	2.09
100318056	O-RING 6.3X2.4	1.40
100318051	O-RING 4.85 X 1.78	1.40
100320008	SA SP PIN	0.84
100320010	PIN AK-100	0.71
100320020	EXPAND PIN BMM	0.84
100320022	CYLINDRICAL PIN (DOWEL-PIN)	1.23
100320023	PIN	1.40
100320033	PIN 1.5X10	1.40
100320057	CYLINDRICAL PIN	1.40
100320061	CYLINDRICAL PIN	1.40
100320065	PIN	1.40
100320076	CYLINDRICAL PIN (BP COVER)	1.40
100320078	PIN	1.40



31

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤ/ΚΟΥ
100322003	LOCKWASHER	0.89
100322008	LOCKING WASHER	1.40
100322007	NYLON WASHER	1.40
100322012	WASHER 7.8 X 8 X 1 WJL.G.FIB	1.40
100322049	LOCKING WASHER	1.00
100322050	LOCKING WASHER	0.70
100322080	LOCKING RING	0.69
100328013	FAN AK-10	205.93
100329004	O-RING STIRER	6.57
100329008	GASKET	1.56
100329009	DRIVE MAGNET	28.33
100329056	(GEAR BOX (PUMP) BCM	220.42
100329059	BASE PLATE BCM	123.21
100329061	FRONT PLATE	138.62
100329062	COVER PUMP BCM	13.69
100329072	MOUNTING PLATE	105.42
100329087	PUMP WHEEL AK-100	61.81
100329083	BELT AK100	24.44
100330009	GROVER RIDER	1.47
100330012	LOCKING WASHER BCM PUMP	0.71
100330014	GROVE RIDER	1.28
100330015	GROOVE RIDER AK100	0.64
100330021	C-CLIP BCH	1.45
100332019	RUBBER PAD	8.07
100334016	TUBE CLAMP	4.03
100334037	ANGLE CONNECTOR	7.39
100334038	CONNECTORS	6.85
100334039	CONNECTOR STRAIGHT	8.49
100334040	STRAIGHT PIECE	9.26
100334041	INLET	13.86
100334042	V-JOINT PIECE	10.68
100334043	T-JOINT PIECE	15.11
100334044	T-CONNECTORS	12.59
100334049	TUBE CLAMP	4.22
100334067	PROTECTIVE PLUG	0.89
100334088	SA COVER (OBSOLETE)	2.57
100334198	Y-PIPE	8.62
100334199	SERVICE KIT FOR PRESS.REGULATOR	167.13
100335001	O-RING T-PIECE	1.23
100335002	LOCKING RING	1.40
100335003	EXPANDER RINET	1.26
100346002	PRESSURE SPRING	1.40
100346012	SPRING	0.61
100346020	SPRING BCH	8.38
100346045	SPRING AK-100	1.40
100346054	PRESSURE SPRING	2.79
100366308	SCREW PTKA 3 X 8	0.58
100366390	SCREW MCS 2X4	0.63
100370204	SCREW MCS 2X8	0.58
100370208	SCREW MCS 2X10	0.56
100370210	SCREW MCS 2X16	0.56
100370216	SCREW MCS 3X4	0.58
100370504	SCREW MCS 3X6	0.58
100370306	SCREW MCS 3X8	0.58
100370308	SCREW	0.58
100370310	SCREW	0.56
100370312	SCREW S 3X14	0.56
100370314	SCREW S 3X14	0.56



32

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
100370316	SCREW MCS 3X16	0.58
100370320	SCREW MCS 3X20	0.58
100370325	SCREW MCS 3X25	0.58
100370330	SCREW MCS 3 X 30	0.58
100370335	SCREW MCS 3X35	0.58
100370406	SCREW MCS 4 X 6	0.58
100370408	SCREW MCS 4 X 8	0.58
100370410	SCREW MCS 4X10	0.58
100370412	SCREW MCS 4X12	0.58
100370416	SCREW MCS 4X16	0.58
100370425	SCREW MCS 4X25	0.63
100370430	SCREW MCS 4X30	0.63
100370450	SCREW MCS 4X50	0.63
100370460	SCREW MCS 4X60	0.65
100370514	SCREW MCS 5X14	0.63
100370516	SCREW MCS 5X16	0.63
100370530	SA SCREW MCS 5 X 30	0.63
100370908	SCREW	1.22
100372609	SCREW 6X9	0.63
100372613	SCREW RXSB 6X13	0.63
100372616	SCREW RXSB 6 X 16	0.63
100372625	SCREW 6X25	0.68
100373420	SCREW N 4X20	1.88
100373432	SCREW RX-PTN 4X32	2.52
100374306	SCREW MFS 3X6	0.61
100374308	SCREW MFS 3X8	0.63
100374508	SCREW MFS 5X8	0.63
100374510	SCREW MFS 5X10	0.63
100378508	SCREW MRS 5X8	0.63
100378510	SDREW	0.61
100380304	SCREW	1.32
100380405	SCREW SK6SS 4X5	0.63
100388612	SCREWMV MC6S 6X12	0.63
100380200	NUT M6M2.5	0.63
100390901	NUT M8M2.5	0.61
100391003	NUT M16M 20X1.5	1.42
100391005	NUT	1.79
100392301	WASHER 3.2X6	0.63
100392902	WASHER 4.3X6	0.63
100392904	WASHER 8.4X16	0.63
100392906	WASHER	3.15
100630005	MEMBRANE FOR PRESS.REGULATOR	76.80
100650002	CONC.NIPPLE MALE A AK90	28.46
100650003	CONC.NIPPLE MALE B AK90	28.48
100650004	CONC.NIPPLE FEMALE A AK90	37.76
100650005	CONC.NIPPLE FEMALE B AK90	37.79
100650007	PICK UP TUBE "A" AK90S	41.07
100650008	PICK UP TUBE "B" AK90S	41.07
100650009	COVER CONC.INTAKE A AK90S	5.98
100650021	TUBE AK90	41.07
100650026	O-RING 2-8 AK90	1.53
100650027	O-RING 2-5 AK90	1.53
100660001	COVER PRESSURE GUARD	110.21
113911034	CONN.PANEL	20.07
113911001	MAINTENANCE KIT AK-10	798.43
113900552	BODY CASTING EB AEA/FEA	903.57
113502500	2500H MAINTENANCE KIT AK95S	151.37



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
113602500	2500H MAINTENANCE KIT AK 90S	151.50
113601500	1500H MAINTENANCE KIT AK100	151.82
120110120	PIPE 1/2 X3/4	2.52
120815040	PLUG-INTERNAL THREAD-1/4"	2.52
120816480	PLUG CONN.8MM	2.61
124462480	CONNECTOR 8MM	2.61
124463484	UNION Y HOSE CONNECTOR (8MM)	2.71
124468480	STR.CON.8MMX1/4	2.82
124468486	STR.CON.8MMX3/8	2.82
124468488	STR.CON.8MMX1/2	2.82
220800040	SOCKET	8.85
260010010	6X12 ARMURED TUBE	1.93
260010030	6X14 ARMURED TUBE	1.93
300333014	SAMPLING KIT (DX)	160.00
300333015	REF.SOL. 13.4mS/CM	51.13
300333018	REF.SOL.1000 US	51.13
00002555E	BATTERY 9V ALKALINE	5.86
040122800	FAN CLF825 8X8X2.5 24VDC 8025	15.84
10010564E	SAFE RAM	78.97
10030405E	POLES STAND	2.42
10031810E	ΦΙΛΤΡΟ SENIOR DUPLEX 3P 3/4"	36.75
10033404E	T-CONNECTORS 5/16"X1/8"PL	13.93
112200-0E	INITIAL PB SUNLIGHT POWER 12V-7.2 AH	30.42
1497-000E	ACCUMULATOR	322.22
1KKTPTL--	P. Φ100X32MM ΒΙΔΑ Μ10X25 ΓΡΠ	30.40
21-871576	BATTERY PD	105.28
21-87879R	OPTO BOARD PD100	435.72
2KPTPTL--	REPAIRED DISPLAY BOARD PD 100	684.55
3003331CR	P Φ100X32MM ΒΙΔΑ+ΦP Μ10X25 ΓΡΠ	37.33
3354-000E	CALIBRATION OF REFER INSTRUMENT	1020.98
500229001	MPAT.NC SAFT 9V 8.4 BLISTER	25.24
500248A--	HANDLE PUMP AK-10	10.18
K01515002	ROTOR PUMP	846.96
K02691001	NIPPLE	2.10
K0302800E	RUBBER MOUNTING	7.49
K03343A--	KNOB	1.22
K04274001	ARMURED TUBE AK-10	8.65
K04315001	COVER PANEL AK-10	21.60
K04387A--	COVERS FOR PW10	45.38
K04403001	LOCKING SLIDE AK-10	22.10
K04405001	CLAMPS	3.91
K04405003	COVER CLAMP	4.44
K04406001	COVER AK95	4.35
K04407002	HOUSING (CLAMP)	5.04
K04436001	HOUSING HALF AK95	12.59
K04436002	HOUSING + UFRER DEGASS	42.91
K04437001	HOUSING + LOW DEGASS	42.91
K04438001	BRACKET (VESSEL)	3.70
K04471C--	FLOATER (DEGASS.) DFUD	19.93
K04475004	CONTROL LOGIC BMM	492.17
K04502001	MOTOR CONTROL BOARD BMM	866.33
K04507A--	COVER DFMIUDM	39.70
K04508A--	COMPRESS SOLENOID(CLAMPS)	418.05
K04510A--	MAGNET ASS.CL UNIT	987.52
K04511A--	ARTERIAL PRESS MON BMM	49.29
K04513002	SWITCH ASS. (A.P. MONITOR)	166.34
K04578001	TRANSISTOR B0677AR	6.30
K04578001	MOUNTING PLATE	47.31



39

33

6/ AB

6/ A

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K04518001	VALVE INSETR	10.68
K04520001	VALVE HOUSING	112.61
K04521001	PLUG	25.63
K04528E-	ANALOG+GYAR BOAR DFM	1177.38
K04528ER-	PCB	427.14
K04538011	POWER SUPPLY BARD DFM	1240.90
K04538F-	POWER SUPPLY BOARD	287.88
K04538H-	POWER SUPL BMM	605.68
K04544E-	CABLING	94.46
K04551001	SPRING MOUNT	22.04
K04555001	SCREW AIR DETECTOR	15.66
K04557A-	KNOB+BMM	22.51
K04559A-	HEATING ELEMENT DFM	252.59
K04561A-	PUMP ROTOR HEP BMM	64.07
K04569A-	CABLING CHASSIS	41.07
K04571A-	FLAT CABLING (PANEL)	92.41
K04572C-	FLAT CABLING	95.83
K04621A-	CABLING+DFUD 117	425.98
K04622A-	FLOW METER 119.47	102.68
K04629BR-	COND. CELL A	566.79
K04629BR-	REPAIRED COND.CELL BCM	566.79
K04629BR-	REPAIR CONDUCTIVITY CELL BCM	291.98
K04630A-	TEMP.TR.HEAT	17.80
K04646A-	STRAINER DFUD	508.21
K04647001	BLOOD.FLOW METER BMM	1012.00
K04648001	VEN.PRESS METER	747.50
K04649001	NEG.PRESS METER	816.07
K04650001	TEMP METER DFUD	827.67
K04651001	CONTACT. METER	180.71
K04684A-	WATER VESSEL	7.23
K04706001	DIAL PLATE	1285.00
K04721A-	MOTOR AK-10	171.68
K04723005	PRESSOSTAT	127.38
K04723007	PRESSOSTAT	146.71
K04724001	PRESSOSTAT DFUD	20.95
K04737001	SCREW	2.05
K04749E-	AIR FILTER (REAR PANEL)	82.14
K04779A-	CABLING (BOARDS)	65.71
K04803001	SPACER	5.58
K04811001	PUMP HOUSING 112.28 DF	92.41
K04812001	PUMP MOUNTING PLATE DFM	25.74
K04813001	QUICK LOCK (MIGR.PUMPT) DF	16.77
K04817001	FLEXIBLE MOUNTING	18.26
K04818001	FLOAT	28.16
K04847A-	SA DIAL PLATE	3.27
K04857001	P7-100 TEMP TRAN SD	258.75
K04884001	COVER (P.PACK)	17.03
K04888003	CLUTCH HALF	97.20
K04888E-	CLUSH HALF AS	56.55
K04899001	CLUTCH HALF ASS.	81.67
K04901001	CLUTCH HALF	31.32
K04905001	CLUTCH INSERT	7.94
K04968001	POTENT.COVER (H.VESSEL)DF	5.69
K04969001	POTENTIOMETER	28.06
K0497001	SWITCH	11.19
K0497001	POTENTIOMETER	28.39



33

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K05041001	CHOKE BUUSE	11.83
K05047001	NIPPLE (H.VESSEL)DFUDM	17.41
K05230001	BUSHING	17.60
K0523000E	BUSHING	16.83
K05287A-	CABLING	14.24
K05288001	SHAFT STIRER	28.48
K05299001	HOLDER (STIRREK UDM)	28.90
K05314001	NIPPLE	3.56
K05316001	PLASTIC STOP	34.58
K05320EE-	STIRER ASS (114/51)	510.46
K05329A-	FLOW REDUCING BLOCK	13.81
K05359001	BUTTON TRAY (STAND)	172.50
K05397001	COVER PLATE	3.42
K05473001	PLUG	27.60
K0547900E	NUT	1.76
K05522001	SCREW	18.89
K05525001	PRESSURE BAR	62.40
K05571003	LEVEL BLOCK DF	39.87
K05788A-	TRANSIENT PROT.	19.17
K05780002	TUBE	8.82
K05795001	NIPPLE	54.16
K05796001	NUT	10.32
K05824A-	CABLING (BOARDS)	209.00
K05855001	ROTOR W+BMM FINGERGRIP	5.46
K058570-	CONCENTR.FILTER	24.35
K05989A-	CODE SWITCH HFM	370.49
K06014001	MOUNTING PLATE	11.98
K06124A-	FRONT PANEL HFM	219.98
K06155001	TEMP. TRAN.D HFM	62.98
K06184001	HOUSING B.L.D.	56.53
K06165001	FILTER	49.84
K06170B-	PRES. TRAN. BOARD	114.34
K06176A-	UPPER PART (STAD) AK-10	263.87
K06183002	RECEIVER BOARD AK-10	65.63
K06200001	RETAINING CATCH COVER	2.34
K06271001	PRES TRANS.D.H.	153.65
K06272001	CABLING	50.33
K06298001	COVER	13.63
K06511001	ADJUSTING RING	7.53
K06528001	COVER (B. PLATE)	99.06
K06734001	O-RING FILTER HSNQ	4.95
K06944001	10POLE EXTCABLE INB.	52.90
K07030001	STEP.MOTOR BMM	262.82
K07070001	PRESSURE REGULATOR	413.23
K07106001	DIAL PLATE	7.56
K07116001	TRANSMITTER BOARD	138.55
K07118001	RECEIVER BOARD HFM	157.44
K07155001	NIPPLE	65.93
K07315001	SPRING	1.59
K07316001	WASHER	1.56
K07329001	WASHER	16.90
K07421001	WASHER	2.85
K07422B-	OVERHEAT GUARD (H.VESSEL)	85.43
K07427001	FUSE BOARD	135.12
K07434001	PLUG	3.32
K07484001	DIAL PLATE	4.23
K07485404	GPU BOARD (2)	1047.94
K07571001	HOLDEF	28.39



36

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K07542001	NUT	18.62
K07642001	PRESSOSTATE	238.63
K07657001	HOLDER	27.52
K07689001	MOTOR 4.1 WRO 10-01	2036.55
K07674001	SLIDE BEARING	0.90
K07688002	BACK PANEL BOARD	124.66
K07688003	POWER SUP BCM	1136.75
K0768803R	REPAIR PCB	537.40
K07720001	SCALE PLATE	6.16
K077203R	PCB	626.98
K0772205R	COND.CONTROL	504.77
K07728001	STEERING	22.18
K07758005	POWER PACK	1275.30
K07843001	MAGNET HUB.LASS.	140.19
K07860001	COVER FCM BCM	42.17
K0790804R	REPAIR PCB	712.62
K07908003	DC-DC BOARD	1322.42
K0790803R	DC-DC BOARD UFM	662.46
K07915001	PANEL BOARD	330.57
K07918002	CABLING INT.	257.72
K07928001	CABEL SER.INT.	19.21
K07931001	WIRE SYSTEM	78.46
K07937001	CABLE STEM	57.84
K07994001	POTENTIOMETER	11.70
K08008001	PACKING	10.84
K08038001	PR.TRAD.HOUSING	12.22
K08056C-	DISTANCE PLATE	12.48
K08062002	VALVE MEMBRANE	372.30
K08083001	VALVE UNIT	244.75
K08137001	INTERFACE UFM 10-2	230.00
K08168001	PRES.TRAND.BOARD	7.39
K08171002	COVER 114.17 DFJUD	180.71
K08177001	CABLAGE 3.41 BCM	32.17
K08178001	SCREW	195.45
K08214001	DISPALY BOARD	72.56
K08215001	NIPPLE	56.13
K08219001	NIPPLE	24.84
K08227001	TUBE	1.61
K08296A-	SEALING WASHER	65.49
K08351001	TUBE FOR FCM	8.87
K08447001	CABLING	176.85
K08500A-	FRONT.PANEL DFJUDM	6.57
K08502001	FLOW REDUCER	11.59
K08542001	NON.RETURN VALVE	0.94
K08542002	SPRING	8.22
K08542002	LOCKING SLIDE	8.22
K0879800E	LOCKING SLIDE	103.15
K08840001	MAGN.VALVE (1L344S57X & 1L530A220AC)	105.84
K08861001	REB.KIT DFJUD	3.42
K08862001	TUBE A FOR BCM	2.90
K08865001	TUBE B	50.38
K08895001	TUBE KIT B.C.M.	39.10
K08952001	POSITION PLATE	31.49
K09032004	TULE-NIPPLE	36.62
K09033002	IFC KABLAGE 14P 210MM	125.95
K09057001	AIR DET.CABLING BMM	18.69
K09059001	CABLING DFJUD	7.81
K09059001	TUBE HOLDER	



37

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K09080001	NIPPLE	2.55
K09081001	NIPPLE	9.45
K09084001	BOTTOM PLATE	233.28
K09086003	MOTHER BOARD BMM	261.35
K09078001	VALVE HALF-M.V	6.13
K09078001	VALVE HALF-M.V	5.09
K09089001	VALVE HALF-M.V	5.91
K09097001	VALVE HALF-M.V	4.38
K09097001	TUBE HOLDER	77.46
K09099001	INF UNIT VALVE	450.73
K08210A-	PUMP ROTOR BCM	162.31
K08239001	BLOODLEAK DETECTOR FM AK100	489.43
K08347A-	BLOCK HALF UFM	28.60
K09351B-	BLOCK HALF FCM	34.23
K09365001	A/O CONVERTER	244.02
K09424001	PLATE	5.18
K09540001	POTENTIOMETER	46.00
K08863004	TUBE SENS.TRANSMITTER AK 100	103.50
K08866004	TUBE SENS.RECEIVER AK 100	113.97
K08881001	FAN COMPL.	129.48
K09890001	CONNECTORS	2.55
K09977B-	LEVEL SWITCH	157.30
K10010001	TRANUDGER	94.62
K10040001	CHOKE COIL AK100	28.92
K10091001	MAGNET	10.57
K10094001	MAGNET CUP	29.58
K10095001	MOUNTING PLATE	485.20
K10140001	MICROPROCESSOR	974.05
K10158001	TUBE HOLDER	65.06
K10229001	MICROPR.BOARD	970.24
K10229002	MICROPROS.BOARD	1088.69
K10345001	COVER PLUG PRES	22.45
K10488A-	MAGNET HUB	64.40
K10592001	UNIT SERV.KIT	324.33
K10607001	V-RING	11.58
K10640001	SERVICE KIT WRO	1701.58
K10668001	AIRFLT.HOLDER	18.55
K10677001	TUBE	43.15
K10707002	DC FAN	296.64
K10727001	NIPPLE	48.60
K10728001	IN-OUT BLOCK	8.88
K10731001	NIPPLE	45.38
K10768001	ARMOURED TUBE	12.32
K10771001	TUBE	11.06
K10784001	PUMP HEAD WRO STD	907.49
K10815001	TUBE NIPP.FCN	17.63
K1082401R	CONTROL LOGIC (R)HFM	320.47
K10857001	FILTER (SUCTION)	16.10
K10929001	HOUSING FOR KUWANO INSTR.	85.87
K10943A-	SCREEN FILTER UFM	25.60
K10988001	STRAIGHT CONNECTION	4.34
K10988002	TUBE CONNECTOR	6.82
K11014001	FLOATER HOUSING	15.09
K11021001	NIPPLE	101.25
K11437001	AIR DET.C.BMM.	5.58
K1137002	AIR DETECTOR HEAD (GREY)	5.58
K11222001	FRONT PANEL BMM	184.80
K11236001	BCM PUMP BRACK	19.58



38

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K1129201R	DISTR BOARD AK-100	415.64
K11332001	CLAMP DRIVER BOARD	304.75
K11335003	PRIMING+BOARD DET.	98.57
K11344004	DIS. BOARD AK100	881.25
K1134404R	REP.DISTR BOARD BPA	450.96
K11347004	DISTR BOARD BPV	861.41
K11415001	PH DRIVER BOARD FM AK-100	410.72
K11488001	CLAMP AK100	2.34
K1150300E	AIR FILTER	2.05
K11504A-	COVER FILTER AK100	66.45
K11504E-	COVER (FILTER)	8.22
K11505001	TUBE AK100	5.89
K11509001	HOUSING AK100	50.27
K11507001	SPACER AK100	6.90
K11509001	RUBBER PLATE AK-100	18.52
K11513001	KNOB AK-100	30.71
K11521001	NIPPLE AK100	14.18
K11562001	NIPPLE AK-100	10.71
K11579001	WASHER AK100	1.82
K11598002	FLOW REDUCER 500ML	95.38
K11615001	BRACKET	16.87
K11641001	SHAFT	28.18
K11643001	HOLDER HEP PUMP AK-100	95.03
K11647A-	PUMP HOUSING AK100	27.17
K11670001	COVER FILTER FM AK100	32.17
K11670002	COVER FILTER BM AK100	32.17
K11670003	AIR FILTER HOLDER	40.22
K11682001	LOCKING SLIDE AK100	12.87
K11682002	LOCKING SLIDE AK100	12.87
K11711001	GASKET	4.27
K11732001	DISTANCE	23.83
K11782001	MOTOR AK100	319.01
K11825001	COVER	12.31
K11830002	LUER NUT BLUE AK100	3.18
K11830003	LUER NUT RED	3.39
K11845A-	LEVEL S AK-100	368.41
K11849A-	TEMP. TRANSDUSER AK100	543.13
K11849C-	TEMP. TRANSD AK200	450.42
K11866A-	SOLENOID	970.87
K11874001	DISTANCE	29.90
K11876001	ADAPTER AK-100	62.8R
K11885001	FLEXIBLE MOUNTING DF/UDM	28.75
K11913A-	NIPPLE PP	59.10
K11982001	ANGLECONNECTOR	6.65
K11982002	ANGLED CONNECTOR	6.28
K11982003	ANGLED CONNECTOR	7.83
K12054001	SUCTION TUBE	37.02
K12055001	SUCTION TUBE A BCM	38.73
K12055002	SUCTION TUBE B BCM	38.73
K12073001	PIN	3.94
K12074001	HEPARIN PUMP HOUSING	123.87
K12105002	INTER BCM	471.09
K1210500R	INTERFACE BCM 10-3	256.53
K12138001	CLIP	18.51
K12138001	SHAFT COUPLING	32.53
K12164001	NIPPLE	29.90
K12185003	PAIR DET. HEAD	1




3P

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K12185005	AIR DETECTOR HEAD AK 85	176.20
K12185008	AIR DETECTOR HEAD AK-80	184.48
K12185008	AIR DETECTOR AK85 AK200	184.48
K12188001	WASHER	41.58
K12225001	GUIDE	56.24
K12233001	PLATE DEGASSING CHAMBERT	3.56
K12266A-	CLAMP	22.18
K12284001	CONTROL LOGIC BMM	709.49
K12284003	CONTROL L BMM	830.19
K12281001	MAGNET	92.00
K12299001	PH SENSOR	415.64
K12312002	REAL PANEL	47.45
K123820CH	ROTARY SWITCH	41.40
K12388A-	NIPPLE	3.76
K12508001	MAGNET FOR B.P.	287.50
K12540001	COVER LOWRAK 10	287.50
K12540003	COVER BMM	11.87
K12614001	ANGLE CONNECT.	10.10
K1261400E	ANGLE CONNECT.	33.54
K12711001	HANGER L AK80	58.87
K12712A-	ARM DIA-FILTER AK90	12.21
K12717001	SEALING STRIP AK 80	20.28
K127181001	HANGER R AK80	11.87
K12731A-	INSERT LEFT	8.80
K12732001	PIN AK 80	170.88
K12753A-	FAN COMPL BSM	252.48
K12763001	PRESSOSTATE BSM	255.88
K12763002	PRESSOSTATE	415.58
K12781A-	TEMP UNIT AK90	203.46
K12785001	PT-100 TEMP. TRANSD.	4.27
K12786001	SAFETY BYPASS HOUSE AK90	67.73
K12808001	HOUS LOWER BCH	20.29
K12807001	COVER LOWER BCH	36.88
K12806001	COVER UPPER BCH	63.09
K12809001	HOUS UPPER BCH	47.23
K12812001	FLOW REDUCER BSM	47.23
K12812003	FLOW REDUCER	47.23
K12812008	FLOW REDUCER (5B)	47.23
K12812011	FLOW REDUCER (1)	47.23
K12812012	FLOW REDUCER AK 200	48.27
K12813001	LOCKING +BCH KNOB	5.28
K12833001	NIPPLE AK90	23.40
K12841001	PACKING AK-100	9.43
K12833001	VALVE HOUSING	82.58
K12833002	VALVE HOUSING AK90	71.43
K12840001	COVER BCM 10-3	3.07
K12850001	DEGASSING UNIT BCM 10-3	188.83
K12850002	DEGASSING UNIT AK90S	195.77
K12850007	DEGASSING UNIT UDM	347.46
K12851001	TUBE CONNECTOR	5.56
K12861001	JOINT B.S.M.	9.29
K12861004	CONNECTOR	18.40
K12863A-	INSERT RIGHT AK 90S	24.56
K1286600E	AIR FILTER AK-80	2.05
K12870001	FILTER HOLDER	71.83
K12886002	VALVE HOUSING	12.87
K12890001	NUT FOR HANSECONN.	3.08
K12897001	NUT	12.57



40



AR

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K13036001	BATT.HOLDER	35.30
K13094001	RELAY BOARD AK90	434.26
K13257001	OVERLAY DISPAY GB AK100	248.18
K13272001	COVER AK 100 F.CELL	29.70
K13303001	VALVE HALF BICART	83.90
K13304001	VALVE HALF BICART	212.55
K13305001	NIPPLE ABC-10	10.15
K13321001	INNER MAGNET 100	123.21
K13325A--	MAGNET CUP AK-100	40.94
K13344001	CABLING BICART	60.37
K1334800E	CABLING BICART	74.69
K13350001	MAGNET SENSOR BICART	40.54
K13350002	MAGNET SENSOR BICART	65.30
K13355001	REDUCER MEMBRANE	30.48
K13357001	FLOW REDUCER AK100	65.81
K13412001	GASKET	3.18
K13429A--	END BRACKET AK100	57.50
K13451001	PIN AK-100	1.34
K13452001	VALVE HOUS- AK-100	4.85
K13452002	VALVE HOUSING	8.21
K13453001	VALVE HOUSING	4.53
K13453002	VALVE HOUSING	14.20
K13467001	SUCTION TUBE FM-100/102AK	79.40
K13467002	SUCTION TUBE FM-100/102AK-100	79.40
K13474001	COVER BICART	14.49
K13563A--	LEVELGUAD	176.68
K13568A--	WATER VESSEL AK100	138.77
K13569B--	WATER VESSEL AK200	132.05
K13574001	TUBE	11.34
K13588001	PROTECTION PLATE BM AK100	29.57
K13594001	FRONTNIPPLE	97.26
K13881001	BAR GRAPH-AK100	629.28
K13893001	KEY TOP (KEYBOARD) AK100	19.96
K13700001	LED DISPLAY (KEYBOARD) AK100	52.57
K13718001	LAMP AK 100	10.24
K13735001	FILTERHOUSE AK-100	3.28
K13736001	FILTER NIPPLE	3.28
K13739001	NIPPLE AK-100	2.93
K13799001	DISTANCE	19.52
K13828001	BLOOD PUMP COVER KIT	32.03
K13847001	NIPPLE AK-100	19.52
K13893A--	HOLDER BCH 10	70.45
K13895001	COVER (COND.CELL) AK-100	30.02
K13908001	POSITION BLOCK BCM 10-3	56.12
K13942001	INFO DISPLAY AK100	442.09
K14028001	NIPPLE AK 90	4.24
K14028002	NIPPLE AK 95	4.24
K14032001	NIPPLE FOR AK-10	5.18
K14033001	NIPPLE FOR GAMBERO CONN.AK100	5.94
K14034003	DRIP CHAMBER HOLDER	39.43
K14034005	DRIP CHAMBER HOLDER	33.95
K14041001	PRESSURE TRANSD.HOUSING AK100	7.63
K14057001	CABLING BCH	74.94
K14061001	QUICK CONNECTOR RED	86.99
K14061002	DIA CONN RED/GREY	66.99
K14082001	QUICK CONNECTOR BLUE	66.99
K14082002	DIA CONN BLUE/GREY	66.99
K14086001	HOLDER BCH 10	96.72

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K14131A--	NIPPLE FOR 6MM TUBE BCM	31.49
K14132A--	NIPPLE FOR 6mm TUBE	31.49
K14136001	NIPPLE	3.87
K14181001	MOTOR CONTROL BOARD	952.04
K14179001	PRESSURE TRANSD.HOUSING AK100	23.66
K14179002	PRESSURE TRANSD. HOUSING AK100	23.00
K14188001	EA-EE FROM ADAPTOR	153.14
K14207001	FETING PUMP BCM	1305.09
K14207006	DOSING PUMP AK 200	1540.18
K14318001	CABLING FCM	44.43
K1431900E	RELAY BOARD FCM	228.85
K14323001	B-CONCENTRATE NIPPLE AK-100	26.94
K14355002	CONTROL LOGIC 5MM 10-HP	1028.10
K14359001	ANALOG GUARD BOARD HP	1081.58
K14363001	CHONICAL TUBE AK-100	4.65
K14387A--	COVER AK-100	88.78
K14402001	TUBE HOLDER	14.57
K14425001	BYPASS VALVE BCH AK-90	31.05
K14437002	SPIKE HOUSING	126.38
K14509001	LAMP AK-100	9.20
K14540002	GASKET	2.68
K1450503R	UF-MEASURING UNIT AK100	1598.00
K1450601R	FLOW CELL FCM	177.20
K14508001	VALVE REPAIR KIT	42.80
K14609002	VALVE REPAIR KIT	2657.00
K14621001	STEPPING MOTOR	595.00
K1463601R	CONOCELL AK-100	575.28
K1463701R	COND.CELL 2 AK 100	862.50
K14648001	LAMP (RED) 24V	9.86
K14649001	LAMP(GREEN) 24V	9.86
K14850001	LAMP (YELLOW) 24V	9.86
K14651001	LAMP (ORANGE) 24V	9.86
K146780C	BLOOD FLOW KNOB AK200	14.05
K14697A--	AIR FILTER AC/DC UNIT AK100	18.25
K14711001	CHAMBER AK100	13.14
K14711002	CHAMBER AK100	13.14
K14711004	CHAMBER BUBBLETRAP 2 AK90S	13.80
K14712003	DIST.BOARD 90	416.27
K14715002	EXPANSION CONN.BOARD AK-90	832.34
K1471501R	REPAIR EXPANSION CONN.BOARD AK-90	385.40
K1471502R	REPAIR EXPANSION CONN.BOARD AK-90	377.04
K14723001	CABLING W.MICROSWITCH AK90	75.90
K14805001	NIPPLEL	2.52
K14834001	LIGHT GUIDE 1 AK100	41.09
K14835001	LIGHT GUIDE 2 AK-100	35.60
K14837001	PRIMING DETECTOR AK-100	102.92
K14837002	PRIMING DETECTOR AK-95	104.27
K14898001	OVERLAY AK90S ENGLISH	213.49
K14808002	SPIK HOUSING	145.10
K14908001	BYPASS NIPPLE	6.35
K14910001	CABLING BCH AK100	98.24
K14920001	QUAD-RING CONN.	3.22
K14944001	FILTER BCH AK100	13.84
K1494701R	COND.CELL OFMUDM	394.29
K1494702R	REPAIRED COND.CELL BCM	394.29
K15035001	MAGNET	89.44
K15035002	MAGNET	107.95
K15038001	GASKET	8.24

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΟΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K15049001	SPACER AK100	24.53
K15059001	TUBE SET	23.96
K15083002	MIXING H. COMPLET AK100 ULTRA	139.32
K15087001	WASHER FOR FEEDING PUMP AK-100	14.37
K15107A-	COVER AK100	9.45
K15107C-	COVER AK100	44.08
K15114001	COVER AIR DET.(WHITE)	7.25
K15114002	COVER AIR DET.GREY	7.25
K15120001	WASHER	1.51
K15120002	WASHER	1.51
K15131001	EXCENTER	176.08
K15143001	VENOUS PRESS.LINE AK100	24.56
K15144001	SYSTEM.PRESS.LINE AK100	25.18
K15146001	DISC FILTER AK-100	16.76
K15146A-	DISC FILTER AK100	16.80
K15162001	MOTOR HOLDER REDUC.	13.10
K15168001	PRESSURE MONITORING LINE BSM	17.80
K15170001	DEGASS.UNIT KIT	437.82
K15232001	NIPPLE	5.29
K15235A-	2 WAY VALVE HOUSING	79.88
K15267A-	PUMP HOUSING AK-100	34.01
K15284002	SIGN. AK 90S	10.51
K15300001	WASHER	23.66
K15318001	BLOOD PUMP MOTOR	1517.50
K15391C-	VALVE MOUNTING TOOL	163.00
K15393A-	MOUNTING PLATE AK100	111.47
K15457A-	MOUNTING PLATE RED.UNIT AK100	174.30
K15510001	REDUCING UNIT AK100	1341.67
K15514001	SPECIAL VALVEHOUSE AK100	113.30
K15514002	VALVEHOUSE	128.99
K15541A-	NIPPLE	24.53
K15541B-	LUNDIA ARM	23.66
K15552001	CLIP	20.26
K15595001	DIA CONNECTOR RED	76.67
K15595002	DIA CONNECTOR BLUE	76.67
K15610001	ART.BLD.PUMP BEARING	448.51
K15610002	VEN.BLD.PUMP BEARING(REPLACES B00292002)	448.51
K15610004	BEARING UNIT	236.13
K15622001	VALVE UNIT AK100	195.77
K15623001	VALVE UNIT AK100	156.62
K15627001	HOUSING LOWER	43.52
K15670003	ROTOR GUARD BRD.	59.89
K15684005	HEATER 220V	1232.14
K15691001	WASHER AK100	7.94
K15722A-	LOCK PIN	22.79
K15723001	PUMP HOUSE GABLE	85.44
K15724001	PUMP HOUSING STIRRER	101.84
K15740007	AC/DC UNIT 230V/AK95	2310.46
K1574001R	AC.DC.POWER SUP	1301.14
K1574004R	AC/DC UNIT REPAIRED 220V AK-85	1301.14
K1574007R	AC/DC UNIT 230V AK-95	1301.14
K15761001	HEPARIN PUMP COMPL.	1386.16
K1576101R	REP.HEP.PUMP	710.97
K15848A-	FLOATER AK 80	87.28
K15876002	HEAT EXCHANGER AK-90	542.14
K15937001	VALVE HOUSING	16.39
K15938001	TRANSM.BOARD	16.39
K15943001	BLOOD LEAK DETECTOR AK80	16.39

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2002

ΚΟΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K16001002	LUER HOUSING BLUE AK100	3.16
K16001003	LUER HOUSING RED	3.36
K16089001	GUIDE ROLLER	12.84
K16090001	GUIDE PIN	15.40
K16148A-	TUBE	73.04
K16162001	SUPP.NIPL. AK-80	21.36
K16179001	ENCODER UNIT HEP PUMP	476.84
K16211A-	TUBEUNIT AK100	168.56
K16214001	O-RING	5.67
K16215001	BLOOD LEAK DET.	30.72
K16232A-	STEPPING MOTOR	286.93
K16273002	OUTLET NIPPLE	16.28
K16273003	INLET NIPPLE	16.78
K16385001	NIPPLE	9.61
K16386001	NIPPLE	13.31
K16415002	POWER FAIL EXTENSION BOARD	278.00
K16513004	HOLDER AK95	11.86
K16538A-	FILTER (SUCTION TUBE)	15.93
K16655004	MM I/O BOARD AK 95	1231.44
K16656003	MM I/O BOARD AK 95	1410.71
K1665803R	I/O BRD AK 95	584.93
K16812001	PROTECTION COVER	47.23
K16884002	EXPANSION CHAMBER	35.49
K16884004	EXPANSION CHAMBER AK95	34.01
K16952A-	DEGAS TOP VALVE	29.75
K16963001	HOLDER FILTER	22.04
K16980001	PRESS. TRANS.AK200	585.06
K1710300E	AIR FILTER	0.81
K17113A-	LEVEL GUARD AK80	166.30
K17237001	T-CONNECTOR BCH AK 200	6.01
K17481001	SHAFT BCH AK 200	23.66
K17552002	PROTECTION DRIVER BOARD AK95	2020.70
K1755200R	REPAIRED PROTECTION DRIVER BOARD AK95	986.21
K17725001	SILICON CONNECTOR	10.69
K17878001	NON.RET.VALVE AK100	14.17
K17890007	CONC.NIPPLE MALE A AK90/85	35.85
K17890008	CONC.NIPPLE MALE B AK90/85	35.85
K17991007	COVER CONC.INTAKE A AK90/85	31.54
K17991008	COVER CONC.INTAKE B AK90/85	31.54
K18002001	TOPTRAY AK100	228.51
K18004002	AC/DC UNIT AK-200	2847.62
K1800401R	REPAIRED AC/DC AK200	1415.60
K1800402R	REPAIRED AC/DC AK 200	1536.07
K18047001	HOLDER PRIMING AK200	28.37
K18048001	DOOR	35.24
K18048002	DOOR	31.21
K18048002	CLAMP UNIT	132.25
K18084001	DRIP CHAMBER HOLDER	55.42
K18124001	COND.CELL 2	1637.38
K1812401R	REPAIRED CON CELL 2	891.67
K18189001	COVER BLOODPUMP	74.84
K18191001	NON RETURN VALVE	282.86
K18195001	CONDUCTIVITY CELL	1339.44
K18196001	TUBE HOLDER AK 200	5.69
K18205001	CABLING PT8H AK 95	98.57
K18206001	CABLING PT AK 90	98.57
K18222002	RELAYBOARD AK95	440.83
K18293001	TOP IT AK200	190.88

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K18264001	PT SENSOR BOARD AK 80/AK 95	57.93
K18310001	BLOODLEAK DETECTOR FM AK200	410.72
K18381001	SENSOR PIN	46.97
K18384001	SILICON COVER	35.05
K18401001	CABLING AK-200 -PC(O POL DSUB)	204.67
K18430001	CABLING AK-200 EXTERNAL ALARM	165.63
K18440001	CONCENTRATE CON.KIT AK90	413.90
K18457001R	REPAIRED DISTR BOARD AK 200	595.81
K18488A--	FAN COMPL. AK100	163.57
K18470A--	MOTOR WITH DRIVING GEAR	373.75
K18471A--	MOTOR (STIRRER)	186.46
K18472A--	MOTOR AK-100	288.32
K18483A--	REAR COVER AK95	904.28
K18608001	BCH CLIP KIT	44.37
K18630A--	AK 90 MOTOR	369.98
K18668001	PRESSURE TRANSDUCER	1201.15
K18670001	SET KNOB AK200	13.99
K18780001	LUER CONE	5.91
K1880802R	REP.CPU BOARD CPL BM AK 200	1637.38
K1880701R	AK-200 FM CPU REP.	1437.50
K1880702R	REP.CPU BOARD CPL FM AK-200	1437.50
K1889100E	FILTER AC/DC AK-200	2.05
K18913001	PLASTIC CYLINDER TW3	16.37
K19012001	ADAPTOR FOR PRESTAN	48.07
K19013001	WASHER	9.39
K19049001	MAGNET	21.22
K19101001	BOTTLE OGM SWEDEN	287.80
K19140001	BICART HOLDER KIT AK60	636.81
K19140002	BICART HOLDER KIT AK100/AK10	650.57
K19145001	FLUIDPUMP AK100/AK200	207.88
K19157001	AK95 PUMP HEAD+DRIVING MAGNET	468.21
K19282001	PRESSURE TRANSDUCER KIT	1196.76
K19312002	LCD DRIVER BRD AK200	1533.63
K19409001	DISPLAY KIT	323.55
K19439001	FLOW GUARD	45.04
K1943901R	REPAIRED OPERATORS PANEL AK 200	1471.74
K19893A--	BLOOD PUMP 200	78.50
K19893B--	BLOOD PUMP COVER AK200 (BLUE)	76.50
K19788001	ADAPTION KIT AK-95	1185.59
K19835001	FLOW SENSOR AK95	171.13
K19844001	PROTECTIVE COVER	52.90
K19880005	SPIKEHOUSE UPPER 200	157.44
K19880007	SPIKEHOUSE CPL (PEEKFLOWER) AK 200	119.52
K19880008	AK95 SPIKEHOUSE UPP	140.39
K19881001	Magnet	11.32
K19880001	BICART HOLDER	737.82
K19890003	BICART HOLDER AK-95	737.82
K20042002	STIRRER	584.31
K20442001	HOLDER	55.88
K2053502R	REPAIRED CPU COMPL SELECT	1739.20
K20855001	FLUID PUMP AK100/AK200	488.75
K20700001	MAINT.KIT AK 200 1500 HOURS	115.00
K20700002	MAINT.KIT AK 200 2500 HOURS	426.12
K20750003	MAINT.KIT AK 90 5000 HOURS(LED)	739.28
K20800001	MAINT.KIT AK 95 2500 HOURS	145.27
K20800002	MAINT.KIT AK 95 5000 HOURS	734.91
K21955B--	VALVE MEMBRANE	22.61
K21095002	PUMPHEAD KIT FOR AK 100/200	1128.53



45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΥ
K21095003	PUMPHEAD KIT AK 90/95	1104.02
K21131001	SERVICE KIT RUBBER STRIP	3.38
K21145001	AK-200 DRAINAGE KIT	18.14
K21168001	CABLE AIR DETECTOR AK 95	31.21
K21393001	Bicart arm assembly (AK200)	15.75
K21394001	Spike House Holder	12.60
K21400001	PRESSURE TRANSDUCER	1090.00
K21486001	Spacer	18.00
K21554001	BICART ARM ASSY upper steel AK200	282.86
K21554003	BICART ARM ASSY lower peek AK95/200	138.64
K21554006	BICART ARM ASSY	157.44
K21554007	BICART ARM ASSY	79.72
K21854008	BICART ARM ASSY	139.40
K21557004	Bicart Arm Complete	155.98
K21733001	SEAL KIT AC/DC AK 200	448.33
K30000004	MAINT.KIT AK 100 5000 HOURS (LED)	85.75
K30000006	MAINT.KIT AK 100 10,000 HOURS (LED)	157.38
L05172001	CONNECTOR	11.00
L07419001	SIK TUBING 4.75X1.6	2.00
L50668004	CAP CONG INTAKE	1.20
L50824001	FILTER	1.42
M90308461	XX OPTICAL SWITCH	95.22
N01870001	LUNDIA MULTI HOLDER	441.70
N07870003	MULTI HOLDER GREY	120.47
P03014101	PAL CIRCUIT	35.85
P03074102	PAL CIRCUIT AK-100	35.73
P03015102	POWERPAL AK-90	83.81
P03015105	POWERPAL	84.46
P03018102	PAL CIRCUIT	32.88
P03021102	PAL CIRCUIT 3.81 AK100	41.44
P03021104	PAL CIRCUIT	39.15
P03023103	PAL AK90	21.89
P03122103	PAL CIRCUIT AK95	32.88
P03124108	PAL CIRCUIT IC 48	170.94
P03128104	PAL CIRCUIT	35.59
P03144101	PAL CIRCUIT	20.91
P03183102	PAL CIRCUIT IC 48	141.70
P03217101	PAL CIRCUIT IC 3	31.49
P03217102	PAL CHIP AK95	36.24
P05035103	WATCH DOG AK100	103.28
Z530A24DC	THINIO Z530A-24DC	18.20



46

GAMBRO AK - 95 S

Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα

- Γρήγορες διαδικασίες προετοιμασίας
- Λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών
- Αυτόματο γέμισμα γραμμών φίλτρου αίματος με ορό
- Προρυθμιζόμενες παράμετροι καθαράσης
- Απλότητα αιματοκάθαρσης
- Επίβλεψη με μία ματιά
- Πρόσβαση σ' όλες τις παραμέτρους οποιαδήποτε στιγμή
- Έξυπνη διαχείριση συναγερμών
- Σχεδιασμένο για καθαράση με BiCart®
- Αυτόματη μεταγωγή από ξηρά καθαράση σε κανονική
- Έλεγχος υπερδιδήθησης
- Μονή βελόνα/μονή αντλία με πολύ μικρή επανακυκλοφορία αίματος
- Αποστειρώσεις όπως ο χειριστής επιθυμεί
- Αυτόματες αποστειρώσεις
- Προκαθορισμένο τύποι αποστειρωτικών
- Αποστειρώση με Clean Cart® (προαιρετικά)
- Θερμική αποστειρώση με προαιρετική χρήση Clean Cart®
- Μνήμη χημικής αποστειρώσης
- Αυτόματα άδειαση της μηχανής στο τέλος κάθε αποστειρώσης
- Απλότητα επισκευών
- Ελάχιστες ρυθμίσεις και ανύψωση βλαβών
- Σύνδεση RS - 232



gambro®

47

GAMBRO AK - 95 S

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το AK-95 S της Gambro είναι η νέα πρόταση για αιματοκάθαρση κατ' οίκον αλλά και στο Νοσοκομείο. Είναι τόσο απλό όσο και εύκολο στην λειτουργία του που είναι δυνατόν να το χειριστεί ο ίδιος ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά πληρεί τις αυστηρότερες απαιτήσεις για ακρίβεια, αξιοπιστία, υγιεινή και ασφάλεια στην αιματοκάθαρση. Μία και είναι τόσο εύκολο να λειτουργήσει στο σπίτι είναι και εύκολο να εργαστεί στο Νοσοκομείο επίσης. Όλες οι σημαντικές λειτουργίες χειρισμού γίνονται αυτόματα. Το συμπαγές της κατασκευής του (34 cm φάρδος, 60 Kg βάρος) το κάνουν εύκολο στην μετακίνησή του από κρεβάτι σε κρεβάτι ή και ακόμη σε άλλη αίθουσα.

Το AK-95 S αποδίδει τα μέγιστα αν και είναι μια μικρή σε μέγεθος συσκευή. Τα ενσωματωμένα κυκλώματα ευρύτητας του AK-95 S το καθιστούν ικανό να εκτελεί οποιοδήποτε είδος αιματοκάθαρσης. Η χωρίς συμβιβασμούς ακρίβεια των κυκλωμάτων παρασκευής υγρών και υπερδιδήθησης (UF) είναι χαρακτηριστικό της όπως όλων των μηχανημάτων της Gambro. Ομοίως το προσεκτικά σχεδιασμένο υδραυλικό τους κύκλωμα, η λειτουργία με BiCart® και η μοναδική αποστειρωτική Clean Cart® βεβαιώνουν για τα υψηλότερα διατηρούμενα standards υγιεινότητας.

Η απλότητα του AK-95 S ισχύει για όλα του τα σημεία. Εύκολο να λειτουργήσει, να συντηρηθεί. Η μακροζωία του χωρίς προβλήματα σημαίνει οικονομικότητα και εύκολο κόλλο ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που το καθιστά οικονομικό.

Το AK-95 S σκέπτεται. Γι' αυτό είναι τόσο εύκολο στη χρήση του. Απλώς ρυθμίζονται τα επιθυμητά επίπεδα βάρους και την ταχύτητα της αντίλασης αίματος και αφήστε το μηχανήμα να κάνει τα υπόλοιπα.

Το AK-95 S θυμάται. Όλες οι παράμετροι αιματοκάθαρσης της συγκεκριμένης Μ.Τ.Ν είναι αποθηκευμένες στην μνήμη και ενεργοποιούνται με την εκκίνηση της μηχανής.

Το AK-95 S γλυτώνει χρόνο. Σε κάθε έναρξη λειτουργίας της (άνοιξη) η μηχανή κάνει αυτοδιάγνωση όλων της των λειτουργιών. Όταν της δοθεί εντολή για λήξη της λειτουργίας της (σβήσιμο), πρώτα εκτελεί τον καθορισμένο κύκλο αποστειρώσης και κατόπιν τίθεται εκτός λειτουργίας (σβήνει) αυτόματα. Όλο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θερμικών - χημικών αποστειρώσεων και πλύσεων είναι δυνατόν να προκαθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χειριστών της.

Το AK-95 S είναι γρήγορο. Η λειτουργία γεμίματος γραμμών αίματος-φίλτρου με ορό είναι δυνατόν να εκτελεστεί αυτόματα. Κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας όλο οι συναγερμοί αποενεργοποιούνται ώστε να μην ενοχλούν.



gambro®

48

GAMBRO AK - 95 S

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για μηχανήματα βασισμένο στην τεχνολογική γνώση και εμπειρία της εταιρείας, το οποίο είναι ακόμα πιο απλό από τα προηγούμενα, πιο μικρό και εύκολο να ελεγχθεί και να θωακίζει τίποτα από την ασφάλεια του αρρώστου και τις διευκολύνει να ελεγχθεί χειριστή.

Το AK-95 S είναι μηχανήματα υπερσύγχρονα - υπεραυτόματα και το μικρότερο (σε όγκο βάρους) στον κόσμο. Με έτος έναρξης παραγωγής λοιπόν το 2021, είναι το νεότερο νόμοσα ότι είναι μελετημένο για την επόμενη δεκαετία.



Λειτουργικότητα

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του βασίζεται σε αυτή της σειράς AK-200. Δηλαδή να μπορεί ο χειριστής να το χειρίζεται εύκολα και με μια απλή κίνηση, με μια δε μπάτ στο ΠΑΝΕΛ να έχει πλήρη εστιαία του μηχανήματος. Ο έλεγχος γίνεται από το πάλνλ με την απλή μέθοδο των οκτώ εντολών. Με αυτόν τον τρόπο εκτός από την άμεση αντίληψη που έχει ο χειριστής, μπορεί να έχει και άμεσο έλεγχο στις περισσότερες παραμέτρους με μια κίνηση. Για τον παραπάνω επίσης λόγο, το AK-95 S διατηρεί σε εσωτερικές μνήμες, ακόμη και όταν είναι εκτός λειτουργίας, (αθήσιό) μεταξύ των χρήσεων, όλες τις σημαντικές παραμέτρους κάθε συνεδρίας. Αυτό διευκολύνει στην διατήρηση των σημειωτικών αυτών παραμέτρων στις μνήμες του και την εισαγωγή τους εκεί μία μόνο φορά. Το ως άνω πάνελ είναι τύπου πλήκτρων επαφής (touch button) αδιάβροχο και ανθεκτικότερο στην χρήση.

Όλες οι σπουδαίες παράμετροι εμφανίζονται συνεχώς στις οθόνες υγρών στοιχείων τύπου στήλης (LCD-bar-graphs). Όλες οι επιθυμητές τιμές έχουν πράσινο χρώμα, οι πραγματικές κίτρινο και τα όρια (μεγίστου-ελάχιστου) συναγερμών κόκκινο. Για αυτό και ο χειριστής έχει οπτική αντίληψη για αυτές, ακόμα και από απόσταση.

Η συνεχής ένδειξη του κυκλώματος ροής διαλύματος-αιμάτος, με αντίστοιχούς χρωματισμούς στο σχετικό διάγραμμα στο ΠΑΝΕΛ δείχνει την κατάσταση τους ανά πάσα στιγμή π.χ. by-pass του διαλύματος, αν οι τιμές τους δεν είναι σωστές.

Εργάζεται και πραγματοποιεί κάθαρση συμβατική - ξηρή ή και παραλλαγές αυτής (π.χ. High-Flux, single pump-Haemodiafiltration).

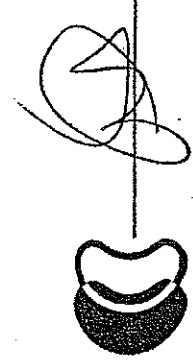

gambro®

13

ΚΑΝΟΝΙΤΕΣ

Το AK-95 S - λόγω της πλήρους των αυτοματισμών - διευκολύνσεων που παρέχει - είναι σε θέση να εκτελεί κάθε τύπου αιμοκάθαρση με οξικό ή διπτανθρακικό διαλύματα, ξηρή αιμοκάθαρση (χωρίς διάλυμα) και κάθε παραλλαγή τους. Εργάζεται με κάθε τύπου και είδους φίλτρα οιοδότησε κατασκευαστή με συντελεστή υπερδιήθησης (UF coef) έως 80 ml/h, ml/h. Αυτό το καθιστά ικανό να εργάζεται με φίλτρα High-Flux, Haemodiafilters ακόμη και Haemofilters.

Επίσης, εκτελεί κάθε είδους και τύπου αποστείρωση με οποιοδήποτε αποστειρωτικό μέσο αφού το αραιώσει στην επιθυμητή αναλογία με αποκλειστικά για κάθε είδος αποστειρωτικό αυτόματα προγράμματα αποστείρωσης.

Χρησιμοποιεί ένα από τρία συμπυκνώματα (επιλογή του χειριστή) για να παρασκευαστεί διάλυμα αντίστοιχα είτε οξικό είτε διπτανθρακικό (συνολικά έξι τύπους συμπυκνωμάτων). Είναι, δίνει την ευελιξία στο νοσοκομείο και στην χειριστή να αλλάξει τύπο συμπυκνώματος χωρίς επέμβαση τεχνικού στο-μηχάνημα ανά πάσα στιγμή (δεν δεσμεύεται από έναν προμηθευτή συμπυκνωμάτων).



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Μνήμη έναρξης

Το AK-95 S μπορεί να προγραμματιστεί με τις συγκεκριμένες προφίλ που χρησιμοποιούνται για την κάθαρση και κάθε φορά που ξεκινά μία συνεδρία απαιτούνται ελάχιστα χειρισμοί.

Αυτόματος έλεγχος

Πριν από κάθε χρήση η συσκευή κάνει έλεγχο λειτουργικότητας και ασφάλειάς της. Όλα της τα εξαρτήματα και υδραυλικά κυκλώματα. Είναι δεν υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί βλάβη κατά την κάθαρση.

Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο


Προγραμματίζοντας την ώρα και την ημέρα (υπάρχει ενσωματωμένο ρολόι) το AK-95 S, μπορεί, να προγραμματιστεί να εκτελεί ένα πλήρη κύκλο θερμικής αποστείρωσης ή πλύσιματος χωρίς την παρουσία του χειριστή. Μπορεί επίσης, αφού τελειώσει το προαπλεγμένο πρόγραμμα και να εθίσει αυτόματα.

Αυτόματο κλείσιμο

Μετά από κάθε λειτουργία αποστείρωσης το AK-95 S είναι δυνατόν, εάν ο χειριστής το επιθυμεί, να κλείσει μόνο του αυτόματα.

Αυτόματη αρραίωση διάφορων αποστειρωτικών

Τα διάφορα χημικά αποστειρωτικά που χρησιμοποιούνται στο AK-95 S, αραιώνονται αυτόματα στις επιθυμητές συγκεντρώσεις. Γιάντοι υπάρχει ενεργή μνήμη και μνήμη προηγούμενης αποστείρωσης. Για αυτό και δεν πρέπει να διακόπτονται οι κύκλοι αποστείρωσης πριν το τέλος τους. Το AK-95 S μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποστειρωτικό μέσο οποιαδήποτε χημική ουσία κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Η επευμητή αρραίωση προπρογραμματίζεται.



gambro®

50

Μνήμη συνεδρίας

Είναι ενεργή κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Σε αυτήν αποθηκεύονται συνεχώς οι σημαντικές τιμές παραμέτρων όπως π.χ. ο ολικός όγκος επεξεργασμένου αίματος ή ο χρόνος αναιμικής, που είναι ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο στην συνεδρία διακόπεται είτε η ροή αίματος είτε η ροή διαλύματος προς το φίλτρο.

Αυτόματος έλεγχος πίεσης

Τα όρια συναγερμών μεγίωτου-ελαχίστου για τις τιμές της αρτηριακής, της φλεβικής και της TMP ρυθμίζονται αυτόματα στις προκαθορισμένες τιμές με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Το μηχανήμα είναι σε θέση να εργαστεί με οιοδήποτε τύπο φίλτρου οιαδήποτε κατασκευαστή.

Μονή βελόνα
Στη λειτουργία με μια βελόνα είναι δυνατόν να εργαστεί με μία αντλία αίματος και με οποιοδήποτε συνδυασμό τύπου πίεσης - χρόνου. Το μηχανήμα υπολογίζει και δίνει συνολικό όγκο επεξεργασμένου αίματος αυτόματα.

Αυτόματος και κερβίβης έλεγχος υπερδιηθημάτων

Ο προκαθορισμένος από τον χειριστή του χρόνου καθαρισμού και επανηλεκτροποίησης υπερδιηθημάτων, πάντα τρέφεται από το μηχανήμα και επαληθεύεται από το αποτέλεσμα.

Το AK-95 S αυτόματα υπολογίζει και αφαιρεί τους χρόνους καθαρισμού και επανηλεκτροποίησης διακόπεται η υπερδιήθηση για διάφορους λόγους και ευσταθείζει το ρυθμίζοντας ανάλογα τον ρυθμό υπερδιήθησης.

Μνήμη αποστειρώσεως

Το AK-95 S αποθηκεύει και "θυμιάται" τον χρόνο που πέρασε από την προηγούμενη αποστείρωση. Μπορεί λοιπόν να προγραμματισθεί μέγιστος χρόνος χρήσης μεταξύ δύο αποστειρώσεων και όταν αυτός συμπληρωθεί, η μηχανή για ζητήσει από τον χειριστή την σχετική λειτουργία.

Ψηφιακή οθόνη επικοινωνίας

Σε αυτήν την οθόνη αναγράφονται όλα τα μηνύματα επικοινωνίας (στα ελληνικά εάν επιλεγεί). Επίσης, σε αυτή δίνονται όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες της συνεδρίας, π.χ. όπως οι πραγματικές ή επιθυμητές τιμές μιας παραμέτρου ή τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού για αυτή την παράμετρο.


Πλήκτρο συμβουλών

Όταν αυτό το πλήκτρο ανάβει, σημαίνει ότι το μηχανήμα έχει να μας δώσει μια συμβουλή, σχετική με τα όσα γίνονται. Πατώντας το, φαίνεται στην οθόνη η αντίστοιχη συμβουλή (σε κείμενο).

Αυτοαίσιμος σταματημένος αντλίας αίματος

Όταν η αντλία αίματος είναι προσωρινά σταματημένη, ο χρόνος αυτός καταγράφεται από τη μηχανή και εάν υπερβεί κάποιο μέγιστο (προκαθορισμένο) χρόνο θα δοθεί συναγερμός.

Όταν ξαναεναρμόσουμε την αντλία, τότε αυτή θα εργασθεί με την ίδια ταχύτητα που δούλευε και πριν.



Προσωρινή παύση υπερδιηθητήματος

Εάν για κάποιο λόγο το επιθυμούμε, ο ρυθμός υπερδιήθησης μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο με το πάτημα του αντιστοίχου πλήκτρου, για έναν μέγιστο χρόνο μετά τον οποίο θα έχουμε συναγερμό.


Αυτόματος καθαρισμός έναρξης - λήξης συνεδρίας

Το AK-95 S "βλέπει" αυτόματα την έναρξη της καθαρισμού (την στιγμή που πρωτακυκλοφορεί αίμα στις γραμμές) και ειδοποιεί αυτόματα για την λήξη της, κανονίζοντας να έχει όλα τα ζήτησιμα αποτελέσματα μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Ο χρόνος διάρκειας της συνεδρίας καθορίζεται από τον χειριστή.

Αυτόματη διεγνώση βλαβών μέσω δικτύου DTE

Ενσωματωμένο στο software του μηχανήματος είναι και ένα πρόγραμμα ανίχνευσης- εντόπισης βλαβών και ελαττωματικών εξαρτημάτων μέσω επικοινωνίας από το τηλεφωνικό δίκτυο με οποιαδήποτε υπολογιστή τύπου PC-IBM compatible. Αυτό γίνεται και από το ίδιο το μηχανήμα (ενδείξεις στην ψηφιακή οθόνη) είτε με PC επί τόπου.

Με το ίδιο πρόγραμμα, μπορούμε να πάρουμε και τα δεδομένα κάθε καθαρισμού για το τυχόν αρχείο ασθενών που χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή μας - και να ενημερώσουμε την καρτέλα του με το ιστορικό του.



Handwritten signature



gambro®

Handwritten signature




gambro®

15

52

ΟΙ ΟΚΤΩ ΕΝΤΟΛΕΣ

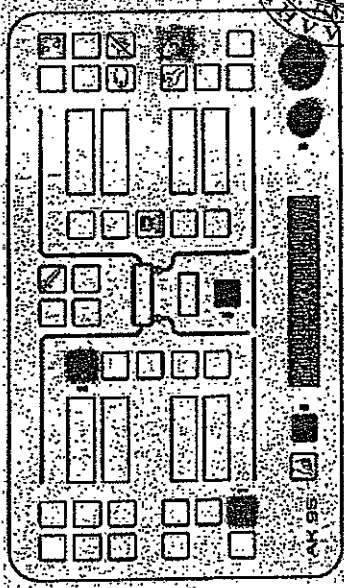

1. Όταν ανάβει ένα μπλε πηλίκτρο, δείχνει ότι η αντίστοιχη λειτουργία εκτελείται.
2. Όταν ανάβει ένα κόκκινο πηλίκτρο, υπάρχει αντίστοιχος συναγερμός.
3. Όταν ένα πηλίκτρο αναβοσβήνει, ζητά να το πιέσουμε.
4. Η ψηφιακή οθόνη δείχνει πληροφορίες μόνο όταν το ζητήσουμε.
5. Για να πάρουμε μια πληροφορία μιας παραμέτρου, πιέζουμε το αντίστοιχο πηλίκτρο.
6. Για να μεταβάλλουμε μια παράμετρο στην οθόνη, την επιλέγουμε πιέζοντας το πηλίκτρο που έχει το βέλος. Η αντίστοιχη παράμετρος αναβοσβήνει.
7. Η παράμετρος που αναβοσβήνει μεταβάλλεται με το ρυθμιστικό SET.
8. Η ταχύτητα της αντλίας αίματος ρυθμίζεται ανά πάσα στιγμή από το ρυθμιστικό BLOOD FLOW.



[Handwritten signature]

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΣΤΟ ΑΚ-95 S

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΑΚ-95 S σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα σημερινά standards για τα μηχανήματα αιματοκάθαρσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όλες οι μεταβαλλόμενες παράμετροι (π.χ. αγωγιμότητα, θερμοκρασία, υπερδιήθημα) ελέγχονται από ένα σύστημα και παρακολουθούνται από ένα άλλο ξεχωριστό προστατευτικό σύστημα, με δικό του αισθητήριο, ηλεκτρικά κυκλώματα και μικροεπεξεργαστές. Η λειτουργικότητα των προστατευτικών συστημάτων ελέγχεται από το ΑΚ-95 S πριν από κάθε συνεδρία. Εάν στον αρχικό αυτό έλεγχο διαπιστωθεί πρόβλημα τότε το ΑΚ-95 S "μπλοκάρει" και δεν επιτρέπει την διεξαγωγή συνεδρίας.

Για να βεβαιωθεί ο χειριστής ότι τα αντίστοιχα κυκλώματα ελέγχου και προστασίας εργάζονται σωστά, με τις σωστές τιμές παραμέτρων, το μηχανήμα τον οδηγεί στο να συγκρίνει τις ενδείξεις των οργάνων και της ψηφιακής οθόνης. Τα όργανα δείχνουν την επιθυμητή, την πραγματική τιμή και τα όρια συναγερμού της παραμέτρου, ενώ η ψηφιακή οθόνη δείχνει όλες τις αντίστοιχες τιμές που "βλέπει" το προστατευτικό κύκλωμα.

Το σύστημα μέτρησης και ελέγχου της φλεβικής πίεσης είναι το κύκλωμα που προστατεύει από τυχόν απώλεια αίματος προς το περιβάλλον. Το σύστημα αυτό αυτοελέγχεται πριν από κάθε συνεδρία για πίεση 0 mmHg. Εάν ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε δεν είναι δυνατόν η μηχανή να ξεκινήσει για κάθαρση. Επιπλέον, η χειριστής παίρνει οδηγίες για να ελέγξει το φίλτρο για τυχόν διασπορά μικροσφαιρίων ή τρίψης. Αυτός ο έλεγχος είναι και λειτουργικό test για το μηχανήμα συγκριτικά με την πίεση.

Το σύστημα ανίχνευσης διαρροής αίματος στο διάλυμα το οποίο εγχύεται στο αιμοκάθητρο, ελέγχεται αυτόματα πριν από κάθε συνεδρία για το εάν υπάρχει θέση να διακρίνει μεταξύ διαφάνειας (όχι αίμα) και αδιαφάνειας (αίμα), στο ίδιο χρόνο. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να διακρίνει αυτές τις καταστάσεις, τότε το μηχανήμα τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόματα και δεν μπορεί να κάνει αιμοκάθαρση. Επιπλέον, το σύστημα διαρροής αίματος ελέγχεται κάθε 6 λεπτά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για το εάν μπορεί να διακρίνει αδιαφάνεια. Εάν όχι, τότε η μηχανή θα θεωρηθεί ότι υπάρχει διαρροή αίματος και θα δώσει συναγερμό κάνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις για την ασφάλεια του αρρώστου.

Ο ανακυκλωτής αέρος εργάζεται με υπέρηχα αισθητήρια στα οποία ένας μικροεπεξεργαστής ελέγχει τον πομπό και ένας ξεχωριστός μικροεπεξεργαστής το δέκτη. Το όλο σύστημα ελέγχεται συνεχώς για το εάν μπορεί να αναχαιτίσει αέρα και σε περίπτωση αδυναμίας δίνει συναγερμό και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια του αρρώστου.

Για τον ηλεκτρικό συναγερμό χρησιμοποιεί δύο βοηθητές που ελέγχονται ηλεκτρονικά με υπερυψωμένο μικρόφωνο. Στην περίπτωση που ο ένας έχει βλάβη τότε αφ' ενός το μηχανήμα ενεργοποιεί αυτομάτως τον δεύτερο και αφ' ετέρου προειδοποιεί τον χρήστη.



[Handwritten signature]

GAMBRO AK - 95 S

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έλεγχος ροής αίματος

Διατάξι Βελόνι

Ταχύτης 0 & 15-500 ml/min (-150mmHg πίεση πριν από την ανάλυση με στοιχείο γραμμής 7,9 mm)
Ακρίβεια ροής ±10 ml/min ή ±10% όποιο είναι υψηλότερο
Ολικός όγκος αίματος 0-999 λίτρα
Ακρίβεια όγκου ±10%

Μονάδι Βελόνι

Ταχύτης 0 & 15-500 ml/min (-150mmHg πίεση πριν από την ανάλυση με στοιχείο γραμμής 7,9 mm)
Ακρίβεια ροής ±10 ml/min ή ±10% όποιο είναι υψηλότερο
Έλεγχος χρόνου 2-20 sec αρτηριακός και φλεβικός
Έλεγχος πίεσης 10-500 mmHg (±5 mmHg ή ±3% όποιο είναι υψηλότερο με έλεγχο της φλεβικής πίεσης)
Ολικός όγκος αίματος 0-999 λίτρα
Ακρίβεια όγκου ±10%


Επιτοπεία πίεσης αίματος

Φλεβική πίεση

Περιοχή πίεσης ±750 mmHg
Όρια συναγερμού 10-500 mmHg στην διάρκεια κθάρασης (-100) -500 στο γέμισμα γραμμών (priming)
Ακρίβεια ±500 mmHg (±5 mmHg ή ±3% όποιο είναι υψηλότερο)

Διαπιστική προστασία

-500 (-50) mmHg
Όρια συναγερμού μηχανικά ρυθμιζόμενα



Διαπιστική πίεση

Περιοχή πίεσης ±750 mmHg (-400) - 400 mmHg
Όρια συναγερμού ±500 mmHg (±5 mmHg ή ±3% όποιο είναι υψηλότερο)

Διανευτικής αέρας

Μέθοδος ανίχνευσης Υπέριχος αισθητήρας ενσωματωμένος στην βάση του φλεβικού θαλάμου (ποτηράκι) ανίχνευσης. Η καλή λειτουργία του εμπορεύεται-επιβεβαιώνεται από μικροπυλολογιστές 22 mm
Διάμετρος Διαστάσεις συναγερμός για +0,5 ml αέρα το λεπτό με ροή αντλίας αίματος 300ml/min

Χορήγηση ηπαρίνης

Ροή 0 -10 ml/h
Ακρίβεια ροής ±0,2 ml/h ή ±5 % όποιο είναι μεγαλύτερο. Η ακρίβεια βασίζεται σε μετρήσεις με σύριγγες 20 & 30 ml.
Μέγεθος σύριγγας Οι σύριγγες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ISO 7886. Το μήκονμα από το εργοστάσιο είναι ρυθμιζόμενο για σύριγγα 20 ml, είναι όμως εύκολο να ξαναρυθμιστεί για όποια σύριγγα οιοδήποτε κατασκευαστή.
Τέλος έγχυσης Ο ηπαρίνισμός σταματά από 0,00 - 9,59 h
Μέγιστη πίεση Max 400 mmHg
Όγκος ηπαρίνης 0-999 λίτρα

Παροχή νερού

Ροή Κατά την συνεδρία 550 ml/min
Κατά την απαστρεύση και πλύσιμο άδειασμα για ελάχιστη παροχή 550 ml/min απαιτείται 0,12 MPa (1,2 bar)
Ελάχιστη πίεση εισόδου 0,6 MPa (6 bar)
Μέγιστη πίεση εισόδου +5 - +30 °C
Θερμοκρασία νερού Διαμέτρου 8 mm
Συνδεσμοί νερού Το νερό θα πρέπει να πληρεί κάποιες διεθνείς προδιαγραφές όπως πχ. ANSI/AAMI. Για καλύτερα αποτελέσματα η μέγιστη αγωγιμότητα του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50μS/cm. Ιδανικό νερό είναι αυτό που παράγεται με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. Είναι δυνατόν να εργαστεί και με νερό πόλης με τις αντίστοιχες υποχωρήσεις σε ποιότητα αιμοκάθαρσης.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.



gambro®

55

Handwritten signature and initials on the right side of the page.



gambro®

Μέγιστο ύψος 1,2 m πάνω από τον σύνδεσμο του μηχανήματος χωρίς επαφή με την αποχέτευση για καλύτερη υγιεινή
< 5 m
Διάμετρος 1,3 mm

Αποχέτευση
Μήκος αποχέτευσης
Περιοριστής εξόδου

Παρασκευη διαλύματος

Ρυθμιστές πίεσης
1ος ρυθμιστής 80 KPa (0,8 bar)
2ος ρυθμιστής 120-125 mmHg

Θερμοκρασία
Ορια συναγερμού
Σταθερό όριο
Ακρίβεια
Ισχύς θερμαντικών στοιχείων

Ρυθμιζόμενη από 35 - 39 °C
Ρυθμιζόμενα από 33 - 41 °C
στους 41 °C
±0,5 °C στην έξοδο προς το φίλτρο
1000 W (±10 % / -5 %) στα 100 V
1300 W (±10 % / -5 %) στα 110 V
1750 W (±10 % / -5 %) στα 230 V
στους 80 °C κατά την κάθαρση μέσω προγράμματος
στους 89 °C κατά τις αποστειρώσεις μέσω προγράμματος

Προστασία υπερθέρμανσης

Ροή
Ακρίβεια ροής

500 ml/min
±10%
Με χρήση αρτημικής πίεσης -810 mmHg. Ρυθμιζόμενη από -500 έως -700 mmHg

Απασφάλιση

Περιοχή πίεσης διαλύματος Ανάμνη συμπτωκωμάτων
(-400) - +300 mmHg
Το σύστημα είναι ασφαλεγχόμενο από την αγωγιμότητα. Τα συμπτώματα αναφορώνται με μακρύ αποπνευσμένο-μενες συγκριτικές αντίλες. Τα υγρά αναφορώνται χωρίς εξωτερική υποβοήθηση με μέγιστη πίεση 150 KPa
Na+ 130-180 mol/l (οξικά υπολογιζόμενα από το νάτριο)


Οξικά

Na+ 130-160 mol/l
HCO₃ - 20-40 mol/l (± mol/l)
12-16 mS/cm

Περιοχή μέτρησης Ορια συναγερμού ±5% της υπολογιζόμενης επιθυμητής τιμής αγωγιμότητας





 gambro®

57

PH-ΜΕΤΡΟ (ορίων)
Ακρίβεια
Ορια συναγερμού

1-9,9 pH μετρούμενο πριν από το φίλτρο
±2 Ph
5,0 - 9,0 pH

Ελεγχος υπερδότησης

Ελεγχος όγκων

Απ' ευθείας μέτρηση όγκου διαλύματος πριν και μετά το φίλτρο με ηλεκτρομαγνητικό τρόπο
Ρυθμιζόμενος 0 - 10,00 λίτρα

Όγκος υπερδότη-θίματος

±50 ml/h ή ±10% όποιο είναι μεγαλύτερο
Max 80 ml/h / mmHg

Ακρίβεια όγκου Συντελεστής φίλτρου

0,0 - 4 l/h με δεδομένες τιμές όγκου υπερδότησης και διάρκειας συνεδρίας

Χρόνος συνεδρίας

Ελεγχος απομείνοντος χρόνου έως 9h 59 min

TMP


Ορια συναγερμού
Ακρίβεια

Ως TMP ορίζεται ως P_B-P_d όπου P_B είναι η φλεβοειδική και P_d πίεση διαλύματος πριν το φίλτρο
(-100) -500 mmHg
±500 (±10 mmHg ή ±5% όποιο είναι μεγαλύτερο)

Αναχνευτής διαφοράς σίματος


Μέθοδος ανίχνευσης
Ευστάθεια

υπερβύρος ανιχνευτής
+0,5 ml αίματος το λεπτό με ροή διαλύματος 500 ml/min
εργηγοποιείται συναγερμός μετά από 5 sec







 gambro®

58

Αποστείρωση και καθαρισμός

Χημική αποστείρωση

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Χρόνος	Χλωρίνη κοινή	Υποχλωριώδες 10%	Υπεροξικό οξύ 3,5-5%
47 min	47 min	47 min	57 min
Θερμοκρασία	+ 60 °C κατά το ξέπλυμα		
Ροή	550 ml/min (μέγιστη)		

Θερμική αποστείρωση

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Θερμική	Κιτρικό οξύ 20%	Clean Cart®
Χρόνος	Κιτρικό οξύ 20% <td>Clean Cart®</td>	Clean Cart®
100 V	55 min	72 min
110 V	45 min	61 min
230 V	41 min	57 min
Θερμοκρασία	+ 93 °C (μετρημένη στο θερμοκρασιακό στοιχείο)	
	≥ + 80 °C (μετρημένη στην αποχέτευση)	
	Οι θερμοκρασίες επαληθεύονται για κανονική τάση δικτύου και θερμοκρασία περιβάλλοντος + 20 °C	
Ροή	550 ml/min (μέγιστη)	

Ξέπλυμα/Αδειασμα/Αποσβέστωση

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Θερμική	Κιτρικό οξύ 20%	Clean Cart®
Χρόνος	Κιτρικό οξύ 20% <td>Clean Cart®</td>	Clean Cart®
10 min	52 min	47 min
Θερμοκρασία	+ 60 °C κατά το πλύσιμο με Clean Cart®	
Ροή	550 ml/min (μέγιστη)	

Καθαρισμός αεθρήτρα υπερδύλησης

Εξωτερικός καθαρισμός

Όλα τα εξωτερικά μέρη καθαρίζονται με αιθανόλη 70% ή ισοπροπανόλη 60%. Ο διακος στο πάνω μέρος της μηχανής και οι αντλίες αίματος είναι δυνατόν να αποστειρωθούν με κλίβανο

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Τάση δικτύου 100 V (50 ή 60 Hz), 110 V (50 ή 60 Hz), ή 230 V (50 ή 60 Hz), - AC ± 12%. Καθορίζεται πριν την εγκατάσταση

Κατανάλωση 2025 W στα 230 V
1575 W στα 110 V
1275 W στα 100 V

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 3 m

Εξωτερικές ασφαλειές για 100/110 V 2X10 AT για τα θερμοκρασιακά για 230 V 2X10 AT για τα θερμοκρασιακά τύπου IEC 83 AS-15 για 100/110 V

Ρευματολήπτης τύπου IEC 83 C4 με διπλή γείωση τύπου Σούκο για 230 V 150 μικροΑ (110 V), 205 μικροΑ (230 V)

Μέγιστη διαροή ρεύματος προς γη 11 μικροΑ (110 V), 20 μικροΑ (230 V)

Μέγιστη διαροή ρεύματος προς άρρωστο 11 μικροΑ (110 V), 20 μικροΑ (230 V)

Σημείωση Τα ρεύματα διαροής ισχύουν χωρίς συνδέσεις άλλων συσκευών πάνω στο AK- 95

Συνδέσεις άλλων συσκευών

Εξωτερικός σύνδεσμος 25 ακίδων τύπου D-sub με RS 232 ή βρόγχο ρεύματος Οπτικά απομονωμένος σύμφωνα με πρότυπο IEC 601-1

Εξωτερικές συσκευές Οι συσκευές που θα συνδεθούν στο AK-95S πληρούν τα διεθνή στάνταρς συμβατότητας με αυτολογιστές-Ακόμε τα τατρικά συστήματα πρέπει να πληρούν IEC 601-1-1




Εξωτερικός συννεγερμός RS 232 Max τάση 24V AC/DC Max-ρεύμα 100mA AC/DC Μέγιστη τάση εισόδου ±15 V DC Μέγιστο ρεύμα εφόδου ±5 mA DC Ρεύμα 20 mA DC Μέγιστο 50 mA DC

Διαστάσεις και βάρος

Πλάτος Μηχανής 35cm, Βάσης 57,4cm
Βάθος Μηχανής 42cm, Βάσης 62,6cm
Υψος 120cm
Βάρος 60 Kg

Αναπίεσης φιαλίων /ορών

Μέγιστο βάρος 2 Kg

Αποστείρωση και καθαρισμός

Χημική αποστείρωση

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Χρόνος	Χλωρίνη κοινή	Υποχλωριώδες 10%	Υπεροξικό οξύ 3,5-5%
47 min	47 min	47 min	57 min
Θερμοκρασία	+ 60 °C κατά το ξέπλυμα		
Ροή	550 ml/min (μέγιστη)		

Θερμική αποστείρωση

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Θερμική	Κιτρικό οξύ 20%	Clean Cart®
Χρόνος	Κιτρικό οξύ 20% <td>Clean Cart®</td>	Clean Cart®
100 V	55 min	72 min
110 V	45 min	61 min
230 V	41 min	57 min
Θερμοκρασία	+ 93 °C (μετρημένη στο θερμοκρασιακό στοιχείο)	
	≥ + 80 °C (μετρημένη στην αποχέτευση)	
	Οι θερμοκρασίες επαληθεύονται για κανονική τάση δικτύου και θερμοκρασία περιβάλλοντος + 20 °C	
Ροή	550 ml/min (μέγιστη)	

Ξέπλυμα/Αδειασμα/Αποσβέστωση

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες

Θερμική	Κιτρικό οξύ 20%	Clean Cart®
Χρόνος	Κιτρικό οξύ 20% <td>Clean Cart®</td>	Clean Cart®
10 min	52 min	47 min
Θερμοκρασία	+ 60 °C κατά το πλύσιμο με Clean Cart®	
Ροή	550 ml/min (μέγιστη)	

Καθαρισμός αεθρήτρα υπερδύλησης

Εξωτερικός καθαρισμός

Όλα τα εξωτερικά μέρη καθαρίζονται με αιθανόλη 70% ή ισοπροπανόλη 60%. Ο διακος στο πάνω μέρος της μηχανής και οι αντλίες αίματος είναι δυνατόν να αποστειρωθούν με κλίβανο

Ασφάλεια - Προδιαγραφές
 Το μηχάνημα πληρεί τις προδιαγραφές :

- α) IEC 601-1 και προστατεύει από ηλεκτροπληξία σύμφωνα με την τάξη αξιολόγησης B
- β) IEC 601-2-16 προδιαγραφές για συστήματα αιμοκάθαρσης
- γ) IEC 601-1, για ηλεκτρικό θόρυβο
- IEC 601-1-2, EN55011

Το μηχάνημα φέρει την σήμανση CE0086


Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία	+ 10 - + 35 °C
Σχετική υγρασία	30 - 85% RH
Ατμοσφαιρική πίεση	700 - 1060 hPa

Περιβάλλον αποθήκευσης-μεταφοράς

Θερμοκρασία	- 20 - + 70 °C
Σχετική υγρασία	10 - 96% RH
Ατμοσφαιρική πίεση	500 - 1060 hPa

Εάν ο χρόνος αποθήκευσης ξεπερνά τις 15 εβδομάδες πρέπει να πληθούν τα μεγέθη για το περιβάλλον λειτουργίας. Μέγιστη θερμοκρασία κατά την μεταφορά αποθήκευση σε σχετική υγρασία 96% είναι + 40 °C



Handwritten signature and logo of Gambro.

19

GAMBRO AK - 200S

Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα

- Άμεση προετοιμασία
- Λειτουργία αυτοδιόγκωσης βλαβών
- Προρρυθμιζόμενοι παράμετροι θεραπείας

Προσαρμογή στις ανάγκες αιμοκάθαρσης

- Προρρυθμιζόμενη σύσταση διαλυμάτων σε οξικά / διπυρροϊκά
- Ρυθμιζόμενη μη χημική αλκαλότητα
- Αυτόματα μειωμένα (ή zero) της συγκέντρωσης Na⁺ και K⁺
- Αυτόματα μειωμένα (ή zero) του ρυθμού Υπερδιήθησης
- Σχεδιασμένα ανά για το σύστημα αιμοκάθαρσης Eikapit[®] και τις επόμενες συμπακνωμένες SolactCar[®].
- Λειτουργία Μονής Σύνθεσης και δύο αντίστοιχα αίματα με πολύ μικρή επανακυκλοφορία
- Ξηρά κάρταρα
- Αιμοδιήθηση
- Ενσωματωμένο αλληλεπίδραση Σαλίνια (Συμπληρωματική) BVS
- Ενσωματωμένο αλληλεπίδραση ΒΡΜ
- Ενσωματωμένη ανακίνηση οξυγόνου

- Μπαταρία εφεδρικής

Τέλη υγιεινή - προσαρμοσμένα απαιτήσεις



- Χημικά καθαρισμού - προσαρμοσμένα απαιτήσεις
- Αυτόματα αλληλεπίδραση με φίλτρα
- Καθαρισμός Σελόνια με Clean Car[®], αποστειρωμένη αποστείρωση
- Μηνιαία χημική
- Επιδείξη



62

ΟΙ ΟΚΤΩ ΕΝΤΟΛΕΣ

1. Όταν ανάβει ένα μπλε πλήκτρο, δείχνει ότι η λειτουργία εκτελείται.
2. Όταν ανάβει ένα κόκκινο πλήκτρο, υπάρχει υπερθερμότητα συναγερμός.
3. Όταν ένα πλήκτρο αναβοσβήνει, ζητά να το πιέσουμε.
4. Η ψηφιακή οθόνη δείχνει πληροφορίες μόνο όταν το ζητήσουμε.
5. Για να πάρουμε μια πληροφορία μιας παραμέτρου, πιέζουμε το αντίστοιχο πλήκτρο.
6. Για να μεταβάλλουμε μια παράμετρο στην οθόνη, την επιλέγουμε πιέζοντας το πλήκτρο που έχει το βέλος. Η αντίστοιχη παράμετρος αναβοσβήνει.
7. Η παράμετρος που αναβοσβήνει μεταβάλλεται με 10 ρυθμιστικό SET.
8. Η ταχύτητα της ανάλυσης αίματος ρυθμίζεται ανά πάσα στιγμή από το ρυθμιστικό BLOOD FLOW.

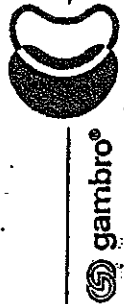

gambro®

63

GAMBRO AK-200S

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Η δημιουργία διαδόχου, για το Gambro AK-200, ήταν μια πραγματική πρόκληση για τους σχεδιαστές της Gambro. Η απαιτητική τους ήταν ο σχεδιασμός διαδόχου γενιάς σε μία γενιά μηχανημάτων που ξεχώρισαν για την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία τους. Η ακρίβεια στους ελέγχους και η τεχνολογία μεταρτίσεων ήδη υπήρχε. Ο τρόπος επεξεργασίας της κάρτας ήταν ήδη ευρέως γνωστός και αποδεδειγμένος. Βελτιώσεις Παρόλο που η σχεδιαστική φιλοσοφία παραμένει η ίδια, το Gambro AK-200S είναι ευδιάκριτα ένα νέο μηχανήμα αιμοκάθαρσης.

Οι αλλαγές στη σχεδίαση και στον τρόπο επικοινωνίας με τον χειριστή προέκυψαν από την απόδοση, την ταχύτητα και την ευκολία όλων των λειτουργιών. Για να γίνει ο χειρισμός διατετακτό, νέα, μεγαλύτερη έγχρωμη οθόνη (TFT) για την απεικόνιση των παραμέτρων κάρτας, ταυτόχρονα σε γραφική και ψηφιακή μορφή, τοποθετήθηκε πάνω διαθέτει επίσης, νέο τρόπο ελέγχου ροής του διαλύματος. Το ύψος της γωνία θέασης του πάνελ του μηχανήματος είναι ρυθμιζόμενο για να αεθριστεί η εργονομικότητα. Η σχεδίαση του επιτρόθιου μέρους είναι τέτοια ώστε να καθαρίζεται ευκολότερα.

Εμπειρία. Σαν φυσικός διάδοχος του AK-200, το Gambro AK-200 S, ενσωματώνει τεχνολογίες, αποδεδειγμένα αξιόπιστες, μετά από 10 εκατομμύρια καθάρσεις. Η συμβατότητα υλικών και κατασκευής με τα προηγούμενα μοντέλα, σηματοδότη απλούστευση στην εξυπηρέτηση βλαβών και συντήρησης. Όταν αφορά τον χειριστή η εμπιστοσύνη του προς το μηχανήμα έχει ήδη κερδίσει. Αυτό σημαίνει αξιοπιστία.

Για τον ασθενή, ο απλός χειρισμός του μηχανήματος AK-200 S, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν υπάρχουν άσκοποι συναγερμοί που να προκαλούν σύγχυση, καθώς επίσης και ο όθρυβος του μηχανήματος είναι σε πολύ χαμηλό στάθμη. Το πάνελ χειρισμού προσφέρει μια πλήρη εικόνα των παραμέτρων κάρτας. Η ύπαρξη της εφεδρικής μπαταρίας, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, σημαίνει περισσότερη ασφάλεια.

Προσαρμογή στις ανάγκες αιμοκάθαρσης. Ο σχεδιασμός του AK-200 S βασίζεται στις απαιτήσεις της κλινικής. Εκτελεί όλες τις παραλλαγές της αιμοκάθαρσης καθώς και αιμοδιαδιήθηση. Η λειτουργία μονής βελόνης γίνεται με μία ή δύο αντλίες.

Το μηχανήμα προσαρμόζεται πλήρως σε εξαντλημένη θεραπεία, διαθέτοντας συστήματα αυτόματης μεταβολής των συγκεντρώσεων στο διάλυμα κάρτας και του ρυθμού υπερδιήθησης. Επίσης διαθέτει έλεγχο υπερδιήθησης και εύκολη παρακολούθηση των παραμέτρων κάρτας. Νέα χαρακτηριστικά όπως ο έλεγχος ροής του διαλύματος κάρτας (300-700 ml/min), εντοπίζονται στο πάνελ χειρισμού.

Handwritten signature and the number 64.

Απλός χειρισμός. Ο έξυπνος σχεδιασμός του πάλιν χειρισμού του μηχανήματος προσδίδει άμεση επίβλεψη ακόμα και από μακρινή απόσταση.

Η ευκολία στον χειρισμό οφείλεται επίσης και στην βελτιωμένη σχεδίαση των καινούργιων βάσεων για τα φίλτρα των διαλυμάτων κθάρασης, στο BiCart®, στο Clean Cart® καθώς και όλες τις επόμενες γενεές συμπυκνωμάτων της Gambro, όπως το SelectiCart®. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, το μηχανήμα καταλαμβάνει μικρότερο χώρο.

Η πλήθώρα των αυτοματισμών που διαθέτει μελώνει το χρόνο προετοιμασίας. Η λειτουργία αυτοδιάνοξης βλαβών δεν απαιτεί επίβλεψη από τον χειριστή. Οι μεταβλητές και οι σταθερές παράμετροι της κθάρασης είναι προρυθμιζόμενες, όπως επίσης και οι διαφορετικά προγράμματα αποστείρωσης.

Οι λειτουργίες αποστείρωσης και πλύσιματος μπορούν να ρυθμιστούν να ξεκινήσουν αυτόματα, αρκετό χρόνο πριν την έναρξη της κθάρασης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και ημέρα.

Παρακολούθηση κθάρασης. Η επίτηρηση είναι εύκολη, ακόμα και από απόσταση. Το πάλιν χειρισμού προσδίδει στον χειριστή την δυνατότητα ελέγχου κλούθησης όλων των παραμέτρων οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι τιμές κθάρασης τα όρια συναγερμών απεικονίζονται γραφικά, ψηφιακά και ελαφρώς καθιστώντας εύκολη την ανάγνωση τους. Η ροή αίματος και διαλυμάτων απεικονίζεται συνεχώς, καθώς επίσης και ο εναπομένον χρόνος κθάρασης.


Όταν απαιτούνται λεπτομερείς πληροφορίες, όλες οι τιμές εμφανίζονται σε ψηφιακή μορφή. Στην οθόνη απεικονίζονται έγχρωμα γραφήματα να καιμπύλες για τον έλεγχο της αυτόματης μεταβολής της συγκέντρωσης του νατρίου και των διαπυρακικών στο διάλυμα κθάρασης καθώς και της υπερδιήθησης.

Επιπρόσθετα, καιμπύλες και διαγράμματα απεικονίζονται όταν ζητηθούν, ενώ όλες οι σημαντικές τιμές αποθηκεύονται στην μνήμη του μηχανήματος.

Ακρίβεια. Η σχεδιαστική φιλοσοφία του μηχανήματος έχει στόχο την ακρίβεια των λειτουργιών του. Το διάλυμα που παρασκευάζεται ελέγχεται ως προς την αγωγιμότητα και ρυθμίζεται και αναλογικά από δύο ξεχωριστές αντλίες με υψηλή ογκομετρική ακρίβεια.

Η απότρωση του διαλύματος παίζει βασικό ρόλο στην ακρίβεια. Για την απαέρωση του διαλύματος κθάρασης χρησιμοποιείται αρνητική πίεση. Ο αέρας στη γραμμή διέλευσης διαλύματος αντνέεται (με υπέρηχους) και αποβάλλεται σε δύο ξεχωριστούς θαλάμους φυσιοσταγίων.

Η ροή του διαλύματος κθάρασης μετρείται και παρακολουθείται πριν και μετά την διέλευση του από το φίλτρο, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια τον έλεγχο του όγκου. Η μέτρηση των ροών γίνεται με ηλεκτρομαγνητικό τρόπο 400 φορές το δευτερόλεπτο, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα για τον έλεγχο της υπερδιήθησης και της ροής. Ένα σύστημα που αποτελείται από τρεις διαφορετικές αντλίες, διασφαλίζει μια σταθερή ροή υγρών μέσα από το φίλτρο καθόλη τη διάρκεια της κθάρασης, διασφαλίζοντας σε εξαιρετικό βαθμό τον έλεγχο της διάχυσης και υπερδιήθησης.

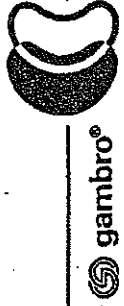

gambro®

65

διόφορος λόγω σταματά η κθάραση. Αυτός όμη ενεργός χρόνος και ο συνολικός όγκος αίματος κθάρασης υπολογίζονται και εμφανίζονται στην οθόνη.

Το AK-200 S διαθέτει έναν αισθητήρα όγκου αίματος (blood volume sensor), διασφαλίζοντας με απλό τρόπο την αποφυγή υπέρτασης και τον ακριβή υπολογισμό του ξηρού βάρους.

Ο σχεδιασμός του μπροσινού τμήματος του μηχανήματος είναι έξυπνος και διασφαλίζει εύκολα, την εξωτερική του καθαριότητα.

Βελτιωμένος ποιοτικός έλεγχος. Το πλήρη "Clinic Automation", στο πάλιν χειρισμό, χρησιμοποιείται για επικοινωνία με εξωτερικό συμβατό υπολογιστή. Όταν το μηχανήμα συνδέεται με τα συστήματα Gambro MedGSS® και MedRec®, το πάλιν του πλήτηρου παρουσιάζει όλες τις παραμέτρους κθάρασης του ασθενούς στην οθόνη.


Μετά την ολοκλήρωση της κθάρασης, οι παράμετροι συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ιατρικούς φακέλους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποιοτικό έλεγχο. Το σύστημα ελαγιστοποιεί την γραφική εργασία και προσφέρει κατάλληλη πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα της κθάρασης. Το φιλικό στον χρήστη πρόγραμμα, βασισμένο στα Windows, κάνει οποιαδήποτε ζητούμενη πληροφορία εύκολα προσσιμή.

Απλότητα επισκευών. Οι περισσότερες επισκευές δεν απαιτούν το "όνομα" του μηχανήματος: calibration, προρύθμιση, έλεγχος (-oi) λειτουργίας, κλπ. Η εύκολη η συντήρηση μηχανικών βλαβών, εκτελούνται από το πάλιν ή μέσω ΗΥ.

Το εσωτερικό του μηχανήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κλείνει εύκολη την πρόσβαση στα μέρη που το αποτελούν, οποιαδήποτε χρειαστεί. Κατά απόδειξη αποτελεί ο σχεδιασμός του μόνιμο διαλύματος.

Οικονομία. Το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό. Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά πολύ μέσω ενάλλακτη θερμότητας. Η χρήση ψηφιακής οθόνης (TFT, VGA), αντί λυχνιών, μειώνει τα έξοδα συντήρησης. Τα εξαρτήματα του μηχανήματος, έχουν μεγάλο χρόνο ζωής, μειώνοντας τις επιδιορθώσεις και αυξάνοντας τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των συντηρήσεων. Η συμβατότητα υλικών με άλλα μοντέλα μηχανημάτων της Gambro, απλοποιεί την συντήρησή τους και κάνει ευκολότερη την πρόσβαση στη χρήση ανταλλακτικών.

Επειδή "ο χρόνος είναι χρήμα", ο άνετος και απλός χειρισμός του μηχανήματος AK-200 S: η προρύθμιση, οι αυτόματες λειτουργίες, η μείωση χρόνου έναρξης, οι ευφυείς συναγερμοί, η αποτελεσματικότητα της ενάλλακτης αποστείρωσης με Clean Cart®, σημαίνουν οικονομία σε όλα τα επίπεδα.

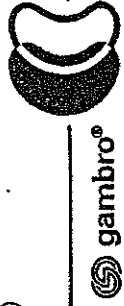

gambro®

66

Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο

Προγραμματίζοντας την ώρα και την ημέρα (υπάρχει ένσωματωμένο ρολόι) το AK-200 S, μπορεί να προγραμματιστεί να εκτελέσει ένα πλήρη κύκλο θερμικής αποστείρωσης ή πλύσιματος χωρίς την παρουσία του χειριστή. Μπορεί επίσης, αφού τελειώσει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα και να σβήσει αυτόματα.

Αυτόματα αραιώσεις διάφορων αποστειρωτικών

Τα διάφορα χημικά αποστειρωτικά που χρησιμοποιούνται στο AK-200 S, αραιώνονται αυτόματα στις επιθυμητές συγκεντρώσεις. Πάντοτε υπάρχει ενεργή μνήμη και μνήμη προηγούμενης αποστείρωσης. Για αυτό και δεν διακόπτονται οι κύκλοι αποστείρωσης πριν το τέλος τους. Το AK-200 S μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν αποστειρωτικό μέσο οποιαδήποτε χημική ουσία κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Η επιθυμητή αραιωση προπρογραμματίζεται.

Μνήμη συνεδρίας

Είναι ενεργή κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Σε αυτήν αποθηκεύονται συνεχώς οι σημαντικές τιμές παραμέτρων, όπως π.χ. ο ολικός όγκος επεξεργασμένου υγρού ή ο χρόνος αναμονής, που είναι ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο στην συνεδρία διακόπτεται είτε η ροή αίματος είτε η ροή διαλύματος προς το φίλτρο.

Αυτόματος έλεγχος πίεσης

Τα όρια συναγερμών μεγίστου-ελαχίστου για τις τιμές της αρτηριακής, της φλεβικής και της TMP, ρυθμίζονται αυτόματα στις προκαθορισμένες τιμές, με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Μονή βελόνα

Στη λειτουργία με μια βελόνα, είναι δυνατόν να εργαστεί με μία ή και δύο βελόνες αίματος και με οποιοδήποτε συνδυασμό τύπου πίεσης - Χρόνου. Οι ταχύτητες των αντλιών μπορούν να ρυθμίζονται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα.

Αυτόματος και ακριβής έλεγχος υπερδιηθήματος

Ο προκαθορισμός από τον χειριστή του χρόνου κθάρασης και της ποσότητας υπερδιηθήματος, πάντα πρέπει από το μηχανήμα και επαληθεύεται από το αποτέλεσμα. Το AK-200 S, αυτόματα υπολογίζει και αφαιρεί τους χρόνους κθάρασης τους οποίους διακόπτεται η υπερδιήθηση για διάφορους λόγους και ισοσταθμίζει το αποτέλεσμα ρυθμίζοντας ανάλογα τον ρυθμό υπερδιήθησης.

Μνήμη αποστείρωσης

Το AK-200 S αποθηκεύει και "θυμάται" τον χρόνο που πέρασε από την προηγούμενη αποστείρωση. Μπορεί λοιπόν να προγραμματισθεί μέγιστος χρόνος χρήσης μεταξύ δύο αποστειρώσεων και όταν αυτός συμπληρωθεί, η μηχανή να ζητήσει από τον χειριστή την σχετική λειτουργία.

Ψηφιακή οθόνη επικοινωνίας

Σε αυτήν την οθόνη αναγράφονται όλα τα μηνύματα επικοινωνίας. Η γλώσσα επικοινωνίας επιλέγεται από τον χειριστή. Μία από τις επιλογές είναι και η Ελληνική γλώσσα. Επίσης, σε αυτή δίνονται όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες της συνεδρίας, π.χ. όπως οι προγραμματικές ή επιθυμητές τιμές μιας παραμέτρου ή τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού για αυτή την παράμετρο. Είναι έγκυρη και εκτός των άλλων παρουσιάζει με πίνακες και γραφήματα κάθε μεταβολή (ζήτησή) ή εκτελεσθείσα όλων των παραμέτρων.

GAMBRO AK - 200S

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έλεγχος ροής αίματος

Οι τιμές για τις αντλίες βασίζονται σε πίεση -150mmHg πριν την αρτηριακή αντλία αίματος με στοχείο γραμμής 7,9 mm και σύριγγες 20ml ή 30ml

Διπλή βελόνα

Ροή αίματος στην μονή αντλία
αποδιόλυση ±15%
Ροή αίματος στην αποδιόλυση/αποδιήθηση ±15%
Ολικός όγκος αίματος 0-327 λίτρα (±15%)

Μονή βελόνα Μονή αντλία (αποδιόλυση, αποδιόλυση/αποδιήθηση μόνος)

αρτηριακή ροή 20-500 ml/min (±10 ml/min ή ±18%)
έλεγχος χρόνου 2-20 sec. Αρτηριακός & φλεβικός χρόνος 10-800 mmHg με έλεγχο της φλεβικής πίεσης (±50mmHg ή ±3%)
Ολικός όγκος αίματος 0-327 λίτρα (±18%)

Μονή βελόνα Διπλή αντλία (αποδιόλυση μόνος)

διπλή αντλία - A 20-800 ml/min (±10 ml ή ±10%)
διπλή αντλία - V 20-800 ml/min (±10 ml ή ±15%)
μέση ροή - SN/DP 10-400 ml/min (±10 ml ή ±15%)
Ολικός όγκος αίματος 0-99,9 λίτρα (±15%)
Ογκος κύκλου SN/DP 20-60ml/κύκλο (±15%)

Επιπλέον πίεσης αίματος

Φλεβική πίεση ±750mmHg περιοχή λειτουργίας (-50)...+10...+600mmHg
Όρια συναγερμού ρυθμιζόμενα ±500 mmHg (±5 mmHg ή ±3%)
Ακρίβεια ±750mmHg περιοχή λειτουργίας 250 - +250mmHg
Αρτηριακή πίεση ±500 mmHg (±5 mmHg ή ±3%)
Όρια συναγερμού ρυθμιζόμενα ±500 mmHg (±5 mmHg ή ±3%)
Ακρίβεια

gambro®



Handwritten signature and initials

Πίση συστήματος
 Ορια συναγερμού SN/DP ρυθμιζόμενα
 Ορια συναγερμού DN ρυθμιζόμενα
 Ορια συναγερμού HDF με σφάλους ρυθμιζόμενα
 Ακρίβεια

Ανίχνευση αέρα
 Δυναμική αέρα
 Ποιότητα φλεβικής (διάμετρος)

Χορήγηση ηπαρίνης
 Ηπαρίνας
 Τέλος έγχυσης
 Μέγεθος σύρραγος ρυθμιζόμενο
 Μέγιστη αντίθετη πίεση

Αισθητήρας Ογκού Αίματος
 Ακρίβεια ΔΒΥ

Παρασκευή διαλύματος
 Θερμοκρασία διαλύματος
 Συναγερμός θερμοκρασίας ρυθμιζόμενος
 Συναγερμός θερμοκρασίας σταθερός

Ροή διαλύματος
 Na+ οξικά
 Ορια συναγερμού στα οξικά
 Na+ διπυανθρακικά
 HCO₃- διπυανθρακικά
 Ορια συναγερμού στα διπυανθρακικά
 Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας συμprimνωμάτων
 Επιστροφή pH διαλύματος
 Πίεση απελευθέρωσης ρυθμιζόμενη


±750mmHg περιοχή λειτουργίας
 +10 - +175 (-200 - +300)mmHg
 +300 (0 - +800)mmHg
 -100 - +300 (0 - +800)mmHg
 ±500 mmHg (±5 mmHg ή ±3%)

≥ 0,5ml έγχυση αέρα στο αισθητήρα με ροή αίματος 300 ml/min θα προκαλέσει συναγερμό 22 mm
 Η ακρίβεια βασίζεται σε τεστ με σύρραγες γών 20 & 30 ml.
 0/0,5 -10 ml/h (±1 ml/5h ή ±5%)
 0-4 h
 6 - 30 ml
 + 400 mmHg

± 3%
 Ειδικός αισθητήρας για ροή αίματος ≥180 ml/min και Hp ≥ 80g/h

30 - 39 °C (+0,5/- 1,5 °C)
 28 - 40 °C
 28 και 40 °C

300 - 700 ml/min (±10 ml/min)
 115 -160 mmol/l (±4 mmol)
 ±5 % της επιθυμητής τιμής
 130 -150 mmol/l (±6 mmol)
 20 -40 mmol/l (±6 mmol)
 ±5 % της επιθυμητής τιμής
 +150 KPa
 1 - 9,9 μονάδες pH (±0,2)
 -630 mmHg (-500 - -700 mmHg)

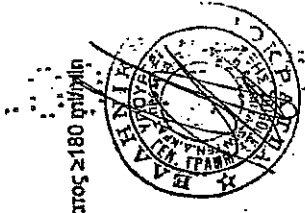

gambro®



gambro®

ΑΠΟΧΕΙΛΩΣΗ

Μέγιστο ύψος
 Μήκος σωλήνα
 Ικανότητα ροής

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Τάση δικτύου
 Συχνότητα
 Κατανάλωση

Καλώδιο τροφοδοσίας

Συνδεση
 Ρευματολήπτης
 Ρεύμα διαροής προς γη
 Ρεύμα διαροής προς άρρωστο

Σημείωση Τα ρεύματα διαροής που αναφέρονται ισχύουν χωρίς συνδέσεις άλλων συσκευών πάνω στο μηχάνημα Ασφάλειες 2 X T 10 A

Συνδέσεις εξωτερικών συσκευών

Εξωτερική ασφαλιστική θύρα

Βύσμα σύνδεσης Ρ03 8 ακίδων, REDEL μαύρο, RS 232 ή RS 422 σύμβατη σύνδεση. Οπτικά απομονωμένος σύμφωνα με την προδιαγραφή IEC 601-1

Εξωτερικές συσκευές

Καλώδια σύνδεσης 2,5 m
 Οι εξωτερικές συσκευές που θα συνδεθούν στο AK-200 S πρέπει να τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές (π.χ. IEC 950 για συσκευές επεξεργασίας δεδομένων). Οι καρτικές συσκευές πρέπει επιπλέον να τηρούν τις IEC 601-1. Ενα σπουδαίο θέμα που πρέπει να προσεχθεί είναι το ρεύμα διαρροής του συνθέτου συστήματος να μην ξεπερνάει τα επιτρεπτά όρια.

RS 232
 Μέγιστη τάση εισόδου ±15 V DC
 Μέγιστη τάση σήματος + 5 V DC
 Ελάχιστη τάση σήματος - 5 V DC
 Μέγιστο ρεύμα εξόδου ±5 mA DC



gambro®

gambro®

RS 422

Μέγιστη τάση εισόδου ± 7 V DC
Κατώφλι διαφορικής τάσης εισόδου ± 0,2 V DC
Μέγιστη διαφορική τάση εξόδου 5 V DC
Ελάχιστη διαφορική τάση εξόδου 2 V DC
Ρεύμα εξόδου σε βραχυκύκλωση 100 mA DC

Εξωτερική καλωδίωση

Βύσμα σύνδεσης P79 8 ακίδων, REDEL κίτρινο, δύο διακόπτες και μια μεταγωγική επαφή μέσω relay ή δύο μεταγωγικές επαφές Καλώδιο σύνδεσης 2,9 m
Εξωτερικές συσκευές Οι εξωτερικές συσκευές που θα συνδεθούν στο AK-200 S πρέπει να τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές (πχ. IEC 950 για συσκευές επεξεργασίας δεδομένων). Οι ιατρικές συσκευές πρέπει επιπλέον να τηρούν τις IEC 601-1. Ένα σπουδαίο θέμα που πρέπει να προσεχθεί είναι το ρεύμα διαρροής του συνθέτου συστήματος να μην ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια.

Ικανότητα επαφών

Μένιστη τάση 24 V AC ή DC
Μέγιστο ρεύμα 100 mA AC ή DC

Εξωτερική σύνδεση I/O

Βύσμα σύνδεσης P76. 8 ακίδων, REDEL μπλέ. Οπτικά απομονωμένα με την προδιαγραφή IEC 601-1 Καλώδιο σύνδεσης 1,5 m

Εξωτερικές συσκευές

Σύνδεση με την μονάδα ρύθμισης (calibration) UF της Gambio.
Μόνο για χρήση από το *sen*les.

Εξωτερική σειριακή σύνδεση

Βύσμα σύνδεσης P84 8 ακίδων, REDEL γκρι Καλώδιο σύνδεσης 2,0 m

Εξωτερικές συσκευές

Σειριακή θύρα σύνδεσης του συστήματος CCM-100 της Gambio.
Μόνο για χρήση από το *sen*les.

Επεξεργασία μπαταρίας

Τροφοδοσία 24 volt, 5110 Ah
Διάρκεια 15 min
Ασφάλεια T 15 A

 gambio®



71

Διαστάσεις και βάρος

Βάθος 610 mm
Πλάτος 570 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος 1080, 1190 ή 1300 mm
Ρυθμιζόμενο από 1175-1340 mm
573 x 753 mm
Βάρος μονάδας αίματος 16 -18 Kg
Βάρος μονάδας υγρών 40 Kg
Βάρος βάσης 24 -31 Kg
Σταύο μηχανής Υψος 1300 - 2150 mm
Μέγιστο βάρος 10 Kg
Μεταφέρεται από ένα άτομο και χωρά σε κανονικό αυτοκίνητο τύπου station-wagon

Περιβάλλον λειτουργίας

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +18... +35 °C
Σχετική υγρασία 15 - 85% RH
Ατμοσφαιρική πίεση 700 - 1060 hPa

Μεταφορά - Αποθήκευση

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 ... +70 °C
Σχετική υγρασία 10 - 96% RH
Ατμοσφαιρική πίεση 500 - 1060 hPa


Εάν ο χρόνος μεταφοράς - αποθήκευσης ξεπερνά τις 15 εβδομάδες πρέπει να τηρηθούν τα μέγιστα για το περιβάλλον λειτουργίας. Μένιστη θερμοκρασία κατά την μεταφορά - αποθήκευση σε σχετική υγρασία 98% είναι +40 °C

Ασφάλεια

Το μηχάνημα πληρεί τις εξής προδιαγραφές :

- α) IEC 601-1
 - β) IEC 601-2-16
 - γ) IEC 601-1-1
 - δ) IEC 601-1-2
 - ε) EN55011
- Γενικές προδιαγραφές ασφάλειας
Ειδικές προδιαγραφές για αιμοκάθαρση
Ασφάλειας για συστήματα
Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
Εκπομπής για συσκευές ISM και προστασία από ηλεκτροπληξία σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 601-1 τάξη Ι τύπος Β

Το μηχάνημα φέρει την σήμανση CE0086

 gambio®



72



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΕΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΟΘΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
ΚΑΝΙΤΤΟΣ 20 Τ.Κ. 101 81
ΠΑΡΟΡΦΟΡΙΣΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ. : 01033 05 029
ΑΡΙΘΜ. FAX : 01038 02 044

ΑΘΗΝΑ 10-5-2002
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3124
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την Δ/ση 247/2001

**ΘΕΜΑ: Καθόριση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού
Δ/σης 247/2001**

Ανακοινούμε ότι ο ανοικτός διαγωνισμός της Δ/σης 247/2001, με κτηρίο καταχώρισης την συμπεράστη προσφορά, περιλήψεις είδους ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΝΕΦΡΟΙ, για τις ανάγκες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία),

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

08-07-02

Σύμφωνα με την αριθ. 2642/9-5-2002 απόφαση μας για την 08-07-02 Ημέρα Δ/σης 247/2001 ώρα 10,30 π.μ. (Κάνοντας 20, Γραφείο 1) στο Ιατρείο του Υπεργενικού Ανάπτυξης με τις παρακάτω τροποποιήσεις των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης :

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α αντικαθίσταται με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 αντικαθίσταται με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Παράρτημα 17
"Να παρασκευάζει διάλυμα διττανθρακικών και από πικνό διάλυμα και από διττανθρακικό νάτριο σε στερεά μορφή (σκόνη), των περισσότερων μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργαστηρίων, ή τριών τουλάχιστον γνωστών τύπων και εργαστηρίων" (Να δηλωθούν ονομαστικός).

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 247/2001 Διακήρυξη.
Αρχειά στην Ε.Ε. 08.07.02
Παρούσα >> >> 114-05-02



Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Γ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ



ΑΝΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΝ 05-05-02 198

73

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΟΘΕΛΑ ΕΙΔΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΤΡΕΥΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ	21 / 04 / 50 / 00 / 0 /
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Α) 7 Στοιχεία Συμβατικής Αμοιβάθρονης Β) 86 Στοιχεία Παραλλαγών Συμβατικής Αμοιβάθρονης ΤΕΜΑΧΙΟ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Α) 1.282.946, 00 ΕΥΡΩ Από τον τακτικό προϋπολογισμό κάθε Νοσοκομείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1) Β) 234.776, 00 ΕΥΡΩ - Ν.Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" από Π.Δ.Ε. (Γ.Κ.Π.Σ.) Γ) 70.433, 00 ΕΥΡΩ - Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ από Π.Δ.Ε. (ΠΕΠ Ηασιδου) Δ) 29.347, 00 ΕΥΡΩ - Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ από Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 09/1/ Αριθ. Έργου 9991310)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Αποθήκες των Νοσοκομείων
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του είδους.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Α) 1024% Ν.Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ και Ν.Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β) 7.3216%. Από τα Νοσοκομεία Παραρτήματος Α1
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.2198/94 ΑΕΦΡΟ 24	Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.

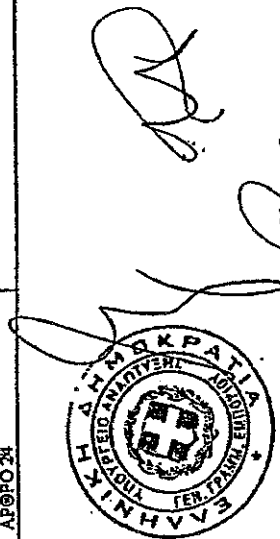


74

75

(Handwritten signatures and scribbles)

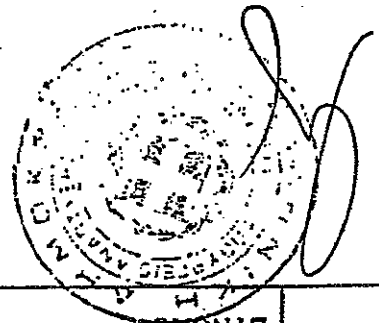

A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΜΑΛΤΩΝ ΣΥΜΒΑΙΜΕΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
1	Ν.Τ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"	-	5	5	51.944,24
2	Π.Τ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΗΟΚΡΑΤΕΙΟ"	-	8	8	234.776,00
3	Π.Τ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	-	8	8	190.755,69
4	Π.Τ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"	-	5	5	70.432,87
5	Ν.Τ.Ν. ΠΙΘΑΓΕΜΑΙΩΣ "ΜΠΟΔΟΞΑΚΕΙΟ"	-	6	6	105.649,3
6	Ν.Τ.Ν. ΑΕΥΚΑΑΣ	-	7	7	102.714,6
7	Ν.Τ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	3	4	7	123.257,52
8	Ν.Τ.Ν. ΑΑΜΙΑΣ	-	7	7	113.279,53
9	Ν.Τ.Ν. ΚΥΤΑΡΙΣΣΙΑΣ	-	3	3	46.955,25
10	Ν.Τ.Ν. ΠΕΡΕΒΑΣ	-	-	-	70.432,87
11	Ν.Τ.Ν. ΤΡΙΚΛΑΩΝ	-	-	-	29.347,03
12	Ν.Τ.Ν. ΗΥΠΟΥ	-	-	-	70.432,87
13	Ν.Τ.Ν. ΚΑΑΜΑΤΑΣ	4	-	-	88.041,09
	Ν.Τ.Ν. ΑΡΦΟΥΣ	-	3	3	44.020,54
	Ν.Τ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	-	10	10	146.735,14
	"ΟΡΙΑΣΙΟ"	-	-	-	-
	Ν.Τ.Ν. ΖΕΦΡΩΝ	-	2	2	33.273,66
	Ν.Τ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	-	8	8	117.390,00
	ΣΥΝΟΛΟ	7	86	93	1639438,20

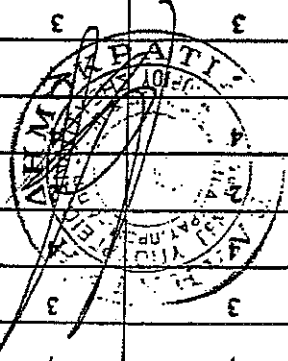

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

Ανήκει στη Δίξη 247/2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

ΑΘΗΝΑ 7-11-2001
Αριθ. Δίξης 247/2001
Αριθ. Πρωτ : 7890

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(Διάφορα Νοσοκομεία)
ΕΙΔΟΣ :
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Κάνιγγος 29
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Ιωάννα Παπαθανασίου
Τηλέφωνο : 33 05 029
FAX : 38 02 044

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Ημερομηνία αποστολής	Ημερομηνία
ΝΑΙ	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Για δημοσίευση στην	Δημοσίευσης
	ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ	Εφημερίδα της Ε.Ε.	Στον Ημερ. Τύπο
ΔΕΙΓΜΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	08-11-01	09-11-01
ΟΧΙ		ΦΕΚ 16-11-01	

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
- 1.2. Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου πρὸς το Κοινοτικό Δίκαιο".
- 1.3. Του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (Κ.Π.Δ. 394/96).
- 1.4. Του Π.Δ. 397/98 (Φ.Ε.Κ 185/Α/88) Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου
- 1.5. Του Π.Δ. 196/95 (ΦΕΚ 102 /Α/95) Οργανισμός Γεν. Δίνας Κρατικών Προμηθειών.

Προμηθειών.

2. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ191/1-2-96). Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

76

3. Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/96) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της."
4. Την Κοινή Απόφαση 303/5-5-2000 (ΦΕΚ 594/Β/5-5-2000) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης."
5. Την υπ' αριθμ. Β3/135/26-7-2000 (ΦΕΚ 977/Β/9-8-2000) απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης "Περί Εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού.
6. Το άρθρο 24 του Ν.2188/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.3.1994) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος" στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
7. Το άρθρο 84 του Ν. 2362/95 " Περί Πρακταθρολών Δημοσίου"
8. Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-97) περί Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/685 Ε.Ο.Κ.
9. Την κοινή απόφαση Π1/1346/9-4-2001 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Ανάπτυξης περί "έγκρισης ενιαίου πλθτος προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2001.
10. Την κοινή απόφαση Π1/1937/2001 των Υφυπουργών Ανάπτυξης περί "Εφαρμογής Ε.Π.Π. 2001".
11. Τον Ν. 2842/00 περί " λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ", καθώς και τις ΚΥΑ αριθ. Ζ-288 και Ζ1-412 περί εφαρμογής του.
12. Τα ΔΥΔοικ.Γ.Π.6926/24-9-2001 και ΔΥΔοικ.Π.Οικ. 23516/31-10-2001 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


1. Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και απαιτούν αναπόσπαστο μέρος της Δίξης αυτής.
- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από "κανονική προθεσμία Πενήντα Δύο (52) ημερών απο την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο και στο τεύχος Δίξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της κυβερνήσεως.

2

Ανήκει στη Δίηλ/2001

2. ΤΟΤΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΤΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης Κάννυος 20 Γραφείο 1 Ισόγειο	14-01-02	Δευτέρα	ΜΕΧΡΙ 10.30 π.μ.



Προσφοράς που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

3. Δικαιώματα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) όλοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
- γ) συνεταιρισμοί.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

- 4.1. "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
- 4.2. "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
- 4.3. "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
- 4.4. "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
- 4.5. "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - Ε.1
- 4.6. "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΥΓΗΤ. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
- 4.7. "ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
- 4.8. "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑ 310/96". ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

5. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' απαιτείται κατάθεση χρημάτων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Κ.Π.Δ.

Ανήκει στη Δίηλ/2001

6. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα αυτά παροδίδονται ή αποστέλλονται σ'αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες, από τη Δίηλ της αντίστοιχης.


7. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Δίηλς παρέχονται από την Υπηρεσία.

9. Τα έξοδα δημοσιεύσεως, στο μεν Ελληνικό, τόσο βαρύνουν το Δημόσιο στη δε επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε. ΡΕΤΕΜΗ

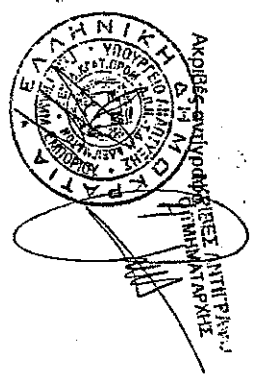

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ανήκει στη Διακήρυξη 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ	21 / 04 / 50 / 00 / 0 /
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Α) 8 Συσκευές Συμβατικής Αιμοκάθαρσης Β) 52 Συσκευές Παραλλαγών Συμβατικής Αιμοκάθαρσης ΤΕΜΑΧΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Διάφορα Νοσοκομεία) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	1.022.157,01 ΕΥΡΩ Από τον τακτικό προϋπολογισμό κάθε Νοσοκομείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Αποθήκες των Νοσοκομείων
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του είδους.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	7,3216%.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24	Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάση της μείξης του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επεξεύρεσης της προυπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί και η προμήθεια θα επαναπρογραμματιστεί.

Ανήκει στη Διακήρυξη 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

Α/Α	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΛΑΜΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
1	Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"	-	5	5	51.944,24
2	Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΛΝΙΚΗΣ "ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"	-	8	8	146.735,14
3	Π.Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	-	8	8	190.755,69
4	Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"	-	5	5	70.432,87
5	Ν.Γ.Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"	-	6	6	105.649,3
6	Ν.Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	-	7	7	102.714,6
7	Ν.Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	3	4	7	123.257,52
8	Ν.Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ	5	2	7	113.279,53
9	Ν.Γ.Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ	-	3	3	46.955,25
10	Ν.Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	-	4	4	70.432,87
	ΣΥΝΟΛΟ	8	52	60	1.022.157,01

Ανήκει στη Διακήρυξη... 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 1.1. Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελλο σφραγισμένο, δικτυολογρημένο σε δύο αντίγραφα και στην Ελληνική γλώσσα,
- 1.2. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσημεριούμενες από την επίτευξη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 1.3. Στο φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- 1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- 1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- 1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
- 1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- 1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Μέσα στο φάκελλο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

- 1.4.1. Στον κυρίως φάκελλο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί πλαισίωτης απορριψίμης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
- 1.4.2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.

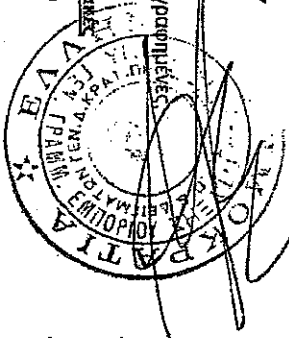

Ανήκει στη Διακήρυξη... 2001.

- 1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατά, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
- 1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυσθείσας ποσότητας ή για κάθε είδος χωριστά.
- 1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.
- 1.7. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
- Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- 1.7.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελλοι καθώς και οι φάκελλοι των τεχνικών προσφορών, μόνον αφού φέρουν δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.
- Οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μόνον γράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελλο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- 1.7.2. Οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτήν σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διασμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.
- 1.7.3. Οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κλήθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών

Ανήκει στη Δίεση...../2001.

στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.8 Η προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 και 18 του Π.Δ. 394/96 δικηολογητικά.

1.8.1. Στοιχεία πιστοποιητικά και δικηολογητικά που αφορούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των τεχνικών προδιαγραφών υποβάλλονται συνημμένα στην τεχνική προσφορά.

1.8.2. Επίσης στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και δύο(2) αντίγραφα της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ.

1.9 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

1.10 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επιουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης απαιτείται ορισμένη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.12.2. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες αποτελούνται μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ανήκει στη Δίεση...../2001.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

2.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εντύπη συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

2.3 Η εντύπη πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητείται.

2.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το

10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.394/96).

Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συννημένο υπόδειγμα.

Επίσης οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα ισχύουν έως την επιστροφή τους στην Τράπεζα.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αναγραφή της ανα μονάδα τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία(άνευ ορίου), εφ' όσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο

Ανήκει στη Δίεση 9117/2001

δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

3.4 Προσφορά που έστιν δύο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.5 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τους % στο οποίο υπέρκειται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένως Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

3.6 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά κατά φορέα.

3.7 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος σύμφωνα με την παράγραφο 3.5.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του είδους και όχι στις τιμές των μερών.

3.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


4.1 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το αργότερο μέχρι του 1/4 αυτού με επιβάρυνση των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (Άρθρο 26 του Κ.Π.Δ).

4.2 Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράδοσης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπρόσωτο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

- α) Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους,
- β) 1. Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης με κατέβαση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής



Ανήκει στη Δίεση 9117/2001

Προκαταβολής που θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΚΠΔ (Π.Δ. 394/99).

Ι. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εσπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήξεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του υλικού.

Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου προσυμφημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες δωδεκάμηνης διάρκειας (απόφ. 2037288/808/0026/90-5-96 Υπ. Οικονομικών).

ΙΙ. Το υπόλοιπο 50% της αξίας με τον αναλογούντα στη συνολική συμβατική αξία Φ.Π.Α, μετά την οριστική παραλαβή του είδους.

Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

Υ) Ως πτός τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/99).

δ) Σύμφωνα με την Π1/1347/6-3-01 εγκύκλιο Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, οι πληρωμές μέχρι 31-12-2001, θα γίνονται μόνο σε όρχ. και από 1-1-2002 μέχρι 28-2-2002 σε όρχ. ή σε ΕΥΡΩ, ονδολογα με τις δυνατότητες, μετά τις 28-2-2002, μόνο σε ΕΥΡΩ.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με την ΚΥΑ Ζ1-412, τα τιμολόγια μέχρι 28/2/2002 θα εκδίδονται μόνο σε δραχμές ή σε δραχμές και ΕΥΡΩ.

ε) Η "τιμή μεταρροπής" είναι η συνολογιστική ιστιμία δραχμής-ΕΥΡΩ και συγκεκριμένα 1ΕΥΡΩ=340,750 όρχ.

6. ΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενοστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 394/1998 ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/Β-9-97)

7.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.1 Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Ανήκει στη Διεθνή Διακήρυξη 247/2001

7.2 Η Υπηρεσία διατηρεί τοδικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%.

7.3 Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστό 30% άπως και αύξηση της προκηρυσθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 30%

7.4 Ο προμηθευτής στον οποίο ανακοινώνεται η κατακύρωση, κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ (που επισυνάπτεται στην παρούσα) με την υποχρέωση να τηρήσουν απόρρητα τα αναφερόμενα σε αυτό στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Λ= Συγκριτική τιμή : Σταθμισμένη βαθμολογία

1. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης – λειτουργίας και συντήρησης αν προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή.

2. Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόματα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των ομάδων .

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς


Ανήκει στη Διακήρυξη.../2001.

217

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΕΙΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Γεωτρώσεις που απαιτείται εγύνηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, σαν χρόνος εγύνησης, καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο αναγραφόμενος στο παράρτημα Ε των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα, για τον οποίο έγινε η προμήθεια, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.

2. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα εντολής στον προπαρατω διαγωνισμό και άλλων Νοσοκομείων, πέραν των δατών αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'1, είτε κατά το στάδιο της κατακύρωσης, είτε κατά τη διαδικασία των συμβάσεων, κατόπιν αιτήματος των Νοσοκομείων στην Υπηρεσία μας και με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠ.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ανήκει στη Διακήρυξη.../2001.

217

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τα προαναφερθέντα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που απορρέουν ανατρεπταστο μέρος της Δ'Ετης αυτής.

83


[Handwritten signature]

13 - ΑΝΗΛΕΙ ΣΗΜ. 247/01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

1. Η συσκευή να είναι πλήρης, καινούρια, αμεταξέριστη και σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τεχνικά κ.λ.π. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται απαραίτητα με αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση.
2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz.
3. Η λειτουργία της να βασίζεται σε μικροπεξεργαστές (microprocessors) και η συσκευή να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης.
4. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη είτε από εσφαλμένο χειρισμό.
5. Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για τη γρήγορη επίσκεψη από τους τεχνικούς. Οι ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής μπορούν να παρέχονται είτε από ψηφιακά είτε από αναλογικά όργανα είτε από φθόνη. Στην περίπτωση της φθόνης οι αναγραφόμενες ενδείξεις είναι επιθυμητό να είναι στα Ελληνικά (Ο προμηθευτής να αναφέρει εάν όλες ή μέρος των παραμέτρων θα αναγράφονται στα Ελληνικά).
6. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση και να είναι εύκολη στη μεταφορά της με δυνατότητα ακινητοποίησης των τροχών.
7. Να φέρει ανωτέρως φιαλών, φίλτρων και γραμμών.
8. Να χρησιμοποιεί φίλτρα και γραμμές όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων.
9. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με μονή βελόνα.
10. Να έχει ενγλή ακριβούς χορήγησης ηπαρίνης.
11. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων της αρτηριακής και φλεβικής πίεσης του αίματος.
12. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου της ροής του αίματος. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μέτρησης του συνολικού όγκου αίματος που επεξεργάστηκε η συσκευή.
13. Να είναι, ως προς την παρασκευή του διαλύματος, αυτόματη και αυτόνομη.
14. Να είναι τύπου Single pass (απλή διέλευση) διαλύματος από το φίλτρο κάθαρσης.
15. Να παρασκευάζει διάλυμα οξείων και διττανθρακικών.
16. Να έχει σύστημα μεταβολής τόσο του Na⁺ όσο και των διττανθρακικών ριζών (HCO₃⁻) του τελικού διαλύματος, κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες εκάστου αρρώστου.
17. Να παρασκευάζει διάλυμα διττανθρακικών και από πυκνά διάλυμα και από άνωρο διττανθρακικό νάτριο σε σκόνη, όλων των μέγεθων σωμάτων τύπων.
18. Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης.
19. Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος (ξηρά κάθαρση).
20. Να έχει ροόμετρο ροής του διαλύματος αιμοκάθαρσης.
21. Να έχει ενσωματωμένες αυτόματες λειτουργίες θερμικής και χημικής αποστείρωσης και πλυσίματος με νερό.

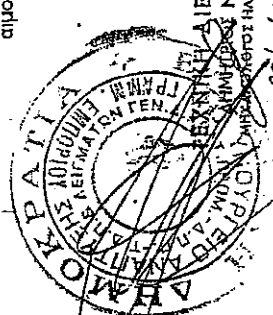

14 - ΑΝΗΛΕΙ ΣΗΜ. 247/01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΖ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
(Hemodiafiltration)

Επι πλέον των αναφερομένων για τη συσκευή συμβατικής αιμοκάθαρσης:

- Να εκτελεί τη μέθοδο Hemodiafiltration.
- Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με διαχρονικό προγραμματισμό (profile) αγωγιμότητας (Na⁺) και υπερδιήθησης.
- Να χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα φίλτρα για παραλλαγές της συμβατικής αιμοκάθαρσης.

Ε.Δ.ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΗΣ-ΜΕΤΡΩΤΗΣ
22/12/97 *[Signature]*

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΤΡΗΣ ΜΕΤΡΩΤΗΣ
12/11/98 *[Signature]*

Ε.Δ.ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΗΣ-ΜΕΤΡΩΤΗΣ
21/9/99 *[Signature]*

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΤΡΗΣ ΜΕΤΡΩΤΗΣ
21/9/99

Ε.Δ.ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΗΣ-ΜΕΤΡΩΤΗΣ
22/11/2000 *[Signature]*

Ε.Δ.ΚΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΗΣ-ΜΕΤΡΩΤΗΣ
10/8/05 *[Signature]*

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΤΡΗΣ ΜΕΤΡΩΤΗΣ
9/8/01

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΤΗΣ
ΝΙΚ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΑΣ
22/12/97 *[Signature]*

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
21/9/97 *[Signature]*

ΚΑΡ. ΣΑΛΑΜΠΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η ΔΙΟΙΚΤΡΙΑ
02/11/2000
Π. Ζάβιτση

21/4/00

21/4/99

17

18

Σχετικά με αίτηση ΟΕ

Διευδίνεται ότι οι συγκεκριμένες Τεχνικοί Μετρώσι θα είναι

ούμωρες προς τις απαιτήσεις της ΔΥΤ/2480/94 (ΦΕΚ

679/Β'/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β'/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β'/10-10-

94) Κοινά Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) περί ενδεδειγμένης της

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93


κατά τον χρόνο παράδοσης των, και θα φέρουν οποιοδήποτε την

προβλεπόμενη από την ανωτέρω Κ.Υ.Α. σήμανση ΟΕ.

Αριθμός 21/11/00 21/7/01

-16-

Αριθμός 21/11/00 21/7/01

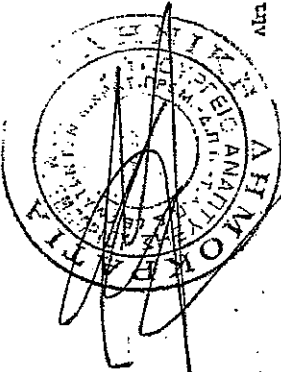

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

1. Οι προσφερόντες είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να καταθέσουν ειδικό έντυπο (prospectus), στο οποίο θα απεικονίζονται σε σχεδιάγραμμα ή σχέδιο τα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος για να πιστοποιείται η τωρινή του προσφερόμενου είδους.
2. Οι προσφερόντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου (το οποίο να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου).
3. Να προσφέρεται εργασία καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Η εργασία καλής λειτουργίας θα περιλαμβάνει δωρεάν service, ανταλλακτικά και αναλώσιμα - ανταλλακτικά του μηχανήματος. Να αναφέρεται ο χρόνος αναπόδοσης ανεξάρτητα εσόδων ή αργιών.
4. Οι προσφερόντες να αναφέρουν τον τρόπο εκπαίδευσης του Ιατρικού - Νοσηλευτικού και Τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου στο χερισμό του μηχανήματος.
5. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση παράδοση, για μία δεκαετία. Σε περίπτωση εισγωγής θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο σε 15 ημέρες.
6. Η παράδοση και οριστική παραλαβή των μηχανημάτων, σε πλήρη λειτουργία, θα γίνει στις Μ.Τ.Ν. του κάθε Νοσοκομείου. Τα μηχανήματα θα συνοδεύονται, κατά την παράδοση, απαραίτητα από πρωτότυπο (χει φυσιολογία), τεχνικό εγχειρίδιο (service manual), κατάσταση κυδιστοποιημένων ανταλλακτικών (part list), εγχειρίδιο ρυθμίσεων (adjustment manual), οι οποίοι στην Ελληνική γλώσσα.
7. Να δοθεί το πλήρες κόστος συντήρησης (τακτική συντήρηση και επισκευή, βαζών, service, ανταλλακτικά και αναλώσιμα ανταλλακτικά μηχανήματος), για τα επόμενα οκτώ (8) χρόνια, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η πρόταση πλήρους συντήρησης, θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, εφόσον το Νοσοκομείο την κρίνει συμφέρουσα και την επιλέξει.
8. Να κατατεθεί τιμοκατάλογος ανταλλακτικών, αναλωσίμων ανταλλακτικών μηχανήματος και λοιπών αναλωσίμων. Να αναγράφεται η συχνότητα αλλαγής των παραπάνω υλικών και να δίνεται πρόταση επίσης αναπροσαρμογής του τιμοκατάλογου.
9. Οι προσφορές θα είναι έγκυρες για 90 μέρες να υποβληθούν με την Υ.Α. Ε3/833/99 όπως τροποποιήθηκε με: (Α) Περ. σ. 10/99, (Β) Δ.Α. 10/99, (Γ) Δ.Α. 10/99 των εταιρειών διακίνητες υπηρεσιών υγείας.

Handwritten signatures and dates: 21/11/00, 9/8/01, 21/9/99, 19

Handwritten signatures and dates: 21/11/00, 9/8/01, 21/9/99, 20

101/ΕΠΧΕ/2001
21/1/2001

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α'	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Σύγχρονη Τεχνολογία Αυτελέγχος - Μικροαπολογιστές Αυτοματιερμής αυτοδιάνγνωσης - ενδείξεις βλαβών για ασφαλεία & προστασία ασθενούς	Εργασια οργάνωση ελέγχου - ενδείξεων διπτανθρακικών	35%
2. Αυτόματη - αυτόνομη παρασκευή διαλύματος οξακών και Ρύθμιση συγκέντρωσης Na ⁺ HCO ₃ ⁻ Παραγωγή ΗCO ₂ από πυκνό διάλυμα και από άνυδρο διπτανθρακικό Na ⁺ σε σκόνη. Single pass	Πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς διαδο διαλύματος	15%
3. Ελεγχόμενη υπερδιήθηση	4. Ελεγχος αρτηριακής - φλεβικής πίεσης	5%
4. Αντλία ηπταρίνης	5. Σύστημα μέτρησης ροής αίματος - Συνολικού όγκου αίματος	10%
5. Θερμική και Χημική αποστείρωση	Μονή βελόνη	5%
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ Β'	70%
ΟΜΑΔΑ Β'		
1. Χρόνος παράδοσης		5%
2. Τεχνική υποστήριξη - Service (επίσκεψη - εξιτισσία)		10%
3. Ενύπνση		10%
4. Εκπαίδευση προσωπικού		5%
ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ		30%

Για τις συσκευές παραλλαγών της συμβατικής αιμοκάθαρσης προστίθενται:

στη παρ. 3 της Α' ομάδας: Hemodiafiltration και στη παρ. 4 της Α' ομάδας: Profiling Na⁺ και υπερδιήθηση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΥΝΙΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΗΡΩΤΙΚΑΙ 21/1/99
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας...
Κατόστημα.....
Ημερομηνία Εκδόσεως.....
ΕΥΡΩ.....

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ.
ΚΑΝΙΓΩΣ 20
101 81 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τήρη να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, απαιτούμενοι του δικαιώματος της διαρπάσεως και δι' ορισμένως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... υπέρ της Εταιρείας..... ΔΙΝΣΗ..... για την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της..... για την προμήθεια..... σύμφωνα με την υπ' αριθμ..... Διάτ. σας.....

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή, εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της..... Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνην την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντήρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάρτισης της εγγύησης, το ποσό της κατάρτισης υποκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χρεωστήσιμου.
Αποδεχόμεστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την..... Βεβαίως αιτερούμε να επιστολιών μας επιστολιών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβάνει το όριο των εγγυησιών που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑ.ΠΗ.ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διάτ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Σχετικές πληροφορίες για την επιχείρηση και σχετικές με την προμήθεια που κατακυρωθήκε

υπό της εταιρίας για τα τρία τελευταία έτη

Ανίκη στη Δ/ση...../2001

22/7

Όνομασία της εταιρίας _____ Fax: _____

Τηλ: _____


Αριθμός σύμβασης _____ Κωδικός προϊόντος*

Είδος προμήθειας _____ Τμή κατακύρωσης

Τιμή κατακύρωσης _____ Κωδικός προϊόντος*

Είδος προμήθειας _____ Τμή κατακύρωσης

Τιμή κατακύρωσης _____ Κωδικός προϊόντος*



* συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

Σχετικές με την προμήθεια πληροφορίες				
Επίσημο σύνολο πωλημάτων προς το δημόσιο (προς όσους τους φορείς) προέβλεψαν που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προμήθειών				
Επίσημο σύνολο πωλημάτων στις ιδιωτικές αγορές (εσωτερικού εξωτερικού) προέβλεψαν που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προμήθειών				
Επίσημες εξαγωγές του υπό προμήθεια προϊόντος				
Επίσημες εισαγωγές του υπό προμήθεια προϊόντος				
Προστιθέμενη αξία/συνόμενη αξία που αναλαμβάνεται στην τιμή πώλησής του υπό προμήθεια προϊόντος				
Γενικές πληροφορίες				
Επίσημες συνολικές πωλήσεις της εταιρίας				
Επίσημες συνολικές εξαγωγές της εταιρίας				
Επίσημες συνολικές εισαγωγές της εταιρίας				
Συνολικός αριθμός προσωπικού της εταιρίας				
Αριθμός τεχνικό προσωπικό				
Αριθμός επιτυχημένου προμηθευτικού				
Επίσημες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό				
Επίσημες επενδύσεις σε κτίρια				
Επίσημες δαπάνες για Τεχνολογική έρευνα				
Επίσημες δαπάνες για αγορά Συσκευών				
Επίσημο ύψος πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου				
Επίσημο ύψος εξαγωγών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου				

Σημειώσεις

Ανίκη στη Διακήρυξη...../2001

22/7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΤΟΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑ 310/96.

Μεφωσμεν με το φεβρουάριο 10 του ΠΛΑ 310/96, καθώς και τους Ν.2328/95, Ν.2372/98 και το ΠΛΑ 82/96, απαιτείται η ανάδοση μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου και η διασφάλιση στοιχείων των από την κατακύρωση των σχετικών διαγωνισμών με τα στοιχεία που προδίδονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Ρ.Σ. Η διασφάλιση αυτή αφορά σε κάθε ανάθεση προμήθειας, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 100.000.000 δρχ. Ειδικά για προμήθεια ύψους μεγαλύτερη του 1.000.000.000 δρχ., οι μετοχές των ελλειψικών ανωψύμων εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες διαγωνισμών και ανάθεσης, πρέπει να είναι ονομαστικές. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει, ανάλογα με την κοπή της επιχείρησης, να συνηχοβώθηκαν οι διαγωνιζόμενοι τα παρακάτω.

87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Αθήνησ τη Δέση 2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 2

Περιεχόμενο δήλωσης ΝΑ 1599/86 από ΑΕ με μετοχές ανώνυμες

Ότι

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "....." και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των μετόχων.....

..... που αντιπροσωπεύουμε από κοινού ποσοστό..... του κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και στο πρόσωπο των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχει το συμμεβαστο της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/95 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2644/98.

Στην παρούσα επισυνάπτω

- α) Καδικτοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία
- β) ΦΕΚ ανακάλυψης του Διοικητικού Συμβουλίου
- γ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου , περί εκπροσώπησης της εταιρείας επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία

Αθήνα

Ο ΔΗΛΩΝ

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος

Σημείωση

Σε περίπτωση που μεταξύ των μετόχων περιλαμβάνεται ΑΕ απαιτείται ανάλογη δήλωση με δικαιολογητικά του νόμιμου εκπροσώπου αυτής κ.ο.κ. μέχρι φυσικού προσώπου.

Αθήνησ τη Δέση 2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 1

Περιεχόμενο δήλωσης ΝΑ 1599/86 από ΑΕ με μετοχές ανωνυμικές

Ότι

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "....." και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των λοιπών μετόχων και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συντρέχει το συμμεβαστο της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/95 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2644/98.

Στην παρούσα επισυνάπτω

- α) Καδικτοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία
- β) Μετοχολόγιο
- γ) ΦΕΚ ανακάλυψης του Διοικητικού Συμβουλίου
- δ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου , περί εκπροσώπησης της εταιρείας επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία.


Αθήνα

Ο ΔΗΛΩΝ

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος

Σημείωση

Σε περίπτωση που μεταξύ των μετόχων περιλαμβάνεται ΑΕ απαιτείται ανάλογη δήλωση με δικαιολογητικά του νόμιμου εκπροσώπου αυτής κ.ο.κ. μέχρι φυσικού προσώπου.

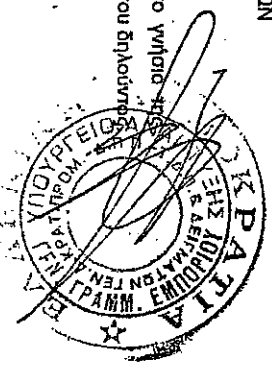

Ανήκει στη Δέση 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 4.

Περιεχόμενο δήλωσης ΝΑ 1599/86 από Ο.Ε.

δηλώνω ότι

Είμαι Ομόρρυθμος εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ".....Ο.Ε." και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των λοιπών Ομόρρυθμων εταίρων δεν συντρέχει το συμβιβαστο της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/95 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2644/98.

Επισυνάπτονται

- α) Καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις νομίμως θεωρημένο
- β) Κατάσταση Ομόρρυθμων εταίρων
- γ) Νομιμοποίηση διορισμού εκπροσώπου

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής.

Ανήκει στη Δέση 2001.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 3.


Περιεχόμενο δήλωσης ΝΑ 1599/86 από Ε.Π.Ε.

Δηλώνω ότι Είμαι Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ".....ΕΠ.Ε." και υπό την ιδιότητα μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των λοιπών εταίρων δεν συντρέχει το συμβιβαστο της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/95 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2644/98.

Επισυνάπτονται

- α) Καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις νομίμως θεωρημένο
- β) Κατάσταση εταίρων
- γ) Φ.Ε.Κ. διορισμού διαχειριστού

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής.

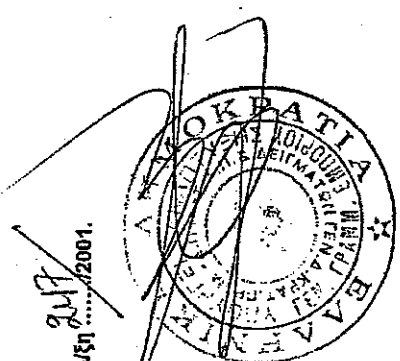

ΔΙΑΚΑΝΤ

Ανήκει στη Δ/ση: 2001.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 5.

Περιεχόμενο δήλωσης ΝΑ 1699/86 από Ε.Ε


δηλώνω ότι

Είμαι Ομόρρυθμος εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ".....Ε.Ε." και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο των Ετερορρυθμίων εταίρων δεν συντρέχει το συμβιβαστό της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν.2329/85 και της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2644/88.

[Handwritten signature]

- Επισημαίνονται
- α) Καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις νομίμως θεωρημένο
- β) Κατάσταση Λογίων εταίρων
- γ) Νομιμοποίηση διορισμού εκπροσώπου.

0

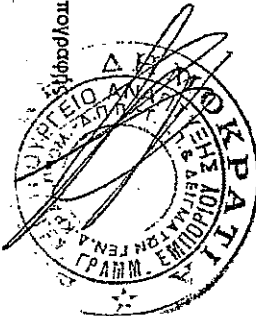

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφή

Ανήκει στη Δ/ση: 2001.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' 6.

Περιεχόμενο δήλωσης Ν.1599/86 από Α.Ε. εισηγμένη στο Χρηματιστήριο

Ότι

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία και υπό την ιδιότητά μου αυτή ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και τα διευθυντικά στελέχη αυτής δεν συμπεριέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο ως μέτοχοι και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε επιχείρηση παροφωφώνις ή τήλεφωφώνις ή έκδοσης εφημερίδας από τις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2329/85.

- Στην παρούσα επισημαίνω
- α) Καδικτοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία
- β) Μετοχολόγιο
- γ) Φ.Ε.Κ. ανακάλυψη του Διοικητικού Συμβουλίου
- δ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκπροσώπησης της εταιρείας, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία.

29

30

[Handwritten scribble]

~~Handwritten text, possibly a signature or name, crossed out with a large X.~~

1960

1961

1962

1963

1964

1965


1966

1967

1968

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης: 5667/2013

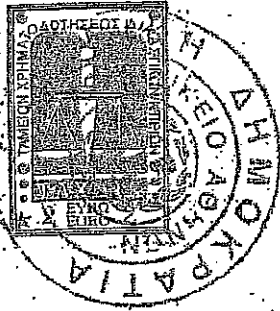

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ευαγγελία ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χριστίνα ΑΥΓΕΡΗ, Πρωτοδίκη, Ευαγγελία-Μαρία ΘΩΜΑ, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, τους οποίους όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη γραμματέα του Μαρριάνθη ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24-4-2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α' ΑΓΩΓΗ: ΣΤ5-16 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 12358/463/2012)

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές -Αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Δημητρίου ΤΕΜΠΕΡΗ και Ιλβας ΜΙΣΙΟ.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: 1. Εταιρείας με την επωνυμία «GAMBRO LUNDIA AB», που εδρεύει στην πόλη Lund της Σουηδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Παυλίνας ΓΑΛΑΤΗ και Αντωνίου ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, 2. Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ», και το διακριτικό τίτλο «MEDICAL PRODUCTS LTD», που εδρεύει στην Άνω



Γλυφάδα Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε μετά των νομίμων εκπροσώπων της Κων/νου ΒΛΑΧΟΥ και Αγγέλου ΒΛΑΧΟΥ, οι οποίοι διόρισαν τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, Κωνσταντίνο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ και Δόμνα ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΥ.


Β' ΑΓΩΓΗ: ΣΤ5-18 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012)

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές -Αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Δημητρίου ΤΕΜΠΕΡΗ και Ιλβας ΜΙΣΙΟ.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «GAMBRO LUNDBIA AB», που εδρεύει στην πόλη Lund Σουηδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. 2. Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ», και το διακριτικό τίτλο «MEDICAL PRODUCTS LTD», που εδρεύει στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε μετά των νομίμων εκπροσώπων της Κων/νου ΒΛΑΧΟΥ και Αγγέλου ΒΛΑΧΟΥ, οι οποίοι διόρισαν τους πληρεξούσιους δικηγόρους Κωνσταντίνο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ και Δόμνα ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνουν δεκτές οι από 19-1-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 12358/463/2012) και 6-12-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012) αγωγές αντίστοιχα, που κατατέθηκαν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης απόφασης και γράφηκαν στο πινάκιο με αριθμούς ΣΤ5-16 και ΣΤ5-18 αντίστοιχα.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.



στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των σχετικών παραγγελιών με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής 30.000 ευρώ. Το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να γίνει δεκτό, διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει οικονομική ζημία στην ενάγουσα (άρθρο 908 παρ. 1 εδ. στ' ΚΠολΔ). Τέλος τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, ύστερα από αίτημα, που υποβλήθηκε με τις προτάσεις της, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της δεύτερης εναγομένης, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ) όπως ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

Θεωρηθιεν
Η
Εισηγητρια
Αεα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ καταργημένη τη δίκη ως προς την πρώτη εναγομένη της δεύτερης από 6-12-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012) αγωγής.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αγωγές.

ΑΠΘΡΡΙΠΤΕΙ την πρώτη αγωγή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ενάγουσας τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, που ορίζει σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τη δεύτερη αγωγή ως προς τη δεύτερη εναγομένη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ-Επίσημονικά-Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές-αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και ανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ-Επίσημονικά-Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές-αντιπροσωπείες-Service)» και το

Handwritten signature or initials at the bottom left.

1708

13^ο φύλλο της υπ' αριθμόν 5667/2013 απόφασης του Πολυμέλους Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία)

διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω διάταξη.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της δεύτερης εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, που ορίζει σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Θεωρ
H
Εισηγή
ΕΟ

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2-10-2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στις 7-11-2013 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη
σήμανση και έκδοσή του κατά τη
σειρά της παραγγελίας

ΑΘΗΝΑ, 15 ΙΑΝ 2014

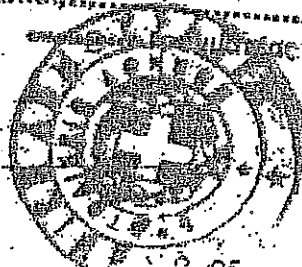

15 ΙΑΝ 2014
[Handwritten signature]

Ενημερωτικό δελτίο σέρβις

AK-95/AK-95S

Γενικές πληροφορίες 249

Ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου 2013

Σχετικά με: AK 95

Γ. ΚΑΡΥ
 C.o. κ.β. Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
 ΑΜ ΔΣΑ
 ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ
 ΑΦΜ: 997603842 ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ.: 210 8211393 211395

Τέλος υποστήριξης για τα AK 95

Η περίοδος της υποστήριξης συντήρησης για τα AK 95 θα φθάσει σύντομα στο τέλος της. Η υποστήριξη για τεχνικές ερωτήσεις, ανταλλακτικά και επισκευή ανταλλακτικών θα συνεχιστεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013. Οι παραγγελίες για μοναδικά ανταλλακτικά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, κατά προτίμηση πριν την 1^η Απριλίου.

Έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013, δεν θα εξεταστούν ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή οποιοδήποτε άλλου είδους βελτιώσεις, εκτός αν υπαγορεύονται για λόγους ασφαλείας.

Σημείωση! Δεν συνιστάται πλέον η χρήση των προϊόντων μετά την 31^η Δεκεμβρίου 2013 και τα παράπονα, που θα αφορούν αυτά τα προϊόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Με εκτίμηση,

Hakan Ohlsson

Karl Henrik Forsland

Αφιέρωση / μεταφράση εις του Γεννημένου στην Αγγλική πρωτοτύπου.

Αθήνα, 30/01/2014

Η μεταφράστρια Διευθύντρια

ΙΛΒΑ Α. ΜΗΣΙΟ
 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
 Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
 και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
 ΑΜ ΔΣΑ 80352
 ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 11527 - ΑΘΗΝΑ
 ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΕΥ.
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 80352
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ.: 997603842
ΤΗΛ.: 210 8211395

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΝΟΟΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 80352
ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ.: 997603842 - ΔΟΥ: 1Α ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211395 - FAX: 210 8211395

Η ΕΣ
ΗΥΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΟ
803
106 82 ΑΘΗΝΑ
ΔΟΥ: ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
FAX: 210 8211395

Service Newsletter

AK 95 / AK 95 S

General Information 249

Date: 23 January 2013

Concerning: AK 95

C.o. no.

End of support for AK 95

The maintenance support period for AK 95 will soon come to its end. The support for technical inquiries, spare parts and spare parts repair will continue until 31st December 2013. Orders for unique spare parts should be placed as soon as possible, preferably before 1st April.

Up to 31st December 2013, no updates, modifications or any other type of improvements will be considered unless dictated by safety issues.

Note! After 31st December 2013, the use of the products is no longer advisable and complaints concerning these products will not be taken into consideration.

Best regards

Håkan Ohlsson

Karl Henrik Forslund

Ενημερωτικό δελτίο σέρβις

Γενικές πληροφορίες 403

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
 και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
 ΑΜ: ΔΣΙΑ 80352
 ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
 ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: 1Α ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

Ημερομηνία: 21 Ιουνίου 2007 Σχετικά με: Όλα

C.o. no.

Περίοδος της υποστήριξης συντήρησης για τα AK 100

Η περίοδος της υποστήριξης συντήρησης για τα AK 100 και AK 100 ULTRA θα φθάσει σύντομα στο τέλος της. Η υποστήριξη για τεχνικές ερωτήσεις, ανταλλακτικά και επισκευή ανταλλακτικών θα συνεχιστεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2007. Οι παραγγελίες για ανταλλακτικά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

Έως την ημερομηνία που αναφέρεται ανωτέρω δεν θα εξεταστούν ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους βελτιώσεις, εκτός αν υπαγορεύονται για λόγους ασφαλείας.

Σημείωση! Δεν συνιστάται πλέον η χρήση των προϊόντων μετά την ημερομηνία που αναφέρεται ανωτέρω και τα παράπονα που θα αφορούν αυτά τα προϊόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Με εκτίμηση,

Hakan Ohlsson

Johan Ekdahl

Αυριβίνα μεταφράστρις ει τα ελληνικά στην Αγγλική πρωτοτύπου.

*Αθήνα, 23/8/2014
Η μεταφράστρια διευχόρος*

ΙΛΒΑ Α. ΜΙΣΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
 και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
 ΑΜ: ΔΣΙΑ 80352
 ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
 ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: 1Α ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
Α. ΑΜ. ΔΙΑ
997603892
210 8217395

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
Α. ΑΜ. ΔΙΑ
997603892
210 8217395
ΑΘΗΝΑ

997603892
210 8217395

Y2 HE
AKN: OPKKA Etaiqsa
4 8 0302
106 02 - AOHVA
2 - AOV JA AOHNGN
93 - FAX

AK 100

Service Newsletter

General Information 403

Date: 21 June 2007

Concerning: All

G.o. no.

AK 100 maintenance support period

The maintenance support period for the products AK 100 and AK 100 ULTRA will soon come to its end. The support for technical inquiries, spare parts and spare parts repair will continue until 31st December 2007. Orders for spare parts should be placed as soon as possible.

Up to the date stated above, no updates, modifications or any other type of improvements will be considered unless dictated by safety issues.

Note! After the date stated above, the use of the products is no longer advisable and complaints concerning these products will not be taken into consideration.

Best regards,

Håkan Ohlsson

Johan Ekdahl

Από: "Kokkinos, Vasilis" <Vasilis.Kokkinos@gambro.com>
Προς: <serco1@otenet.gr>; "cms" <cms@scs-net.org>; "Customer Support Unit - Conventional Equipment" <csu-ce@intermedic.com.lb>; "medical" <medical@darmangar.co.ir>; <Avi.Peleg@teva.co.il>

Αποστολή: Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009 9:35 πμ

Επισύναψη: SP_AK10_AK100_AK90_091120.xls

Θέμα: Τα ανταλλακτικά για τα AK10/AK100/AK90 θα απορριφθούν

Αξιότιμοι κύριοι,

Η περίοδος υποστήριξης για τα ανταλλακτικά των AK10, AK90 και AK100 έχει λήξει. Για ορισμένα ανταλλακτικά έχουμε ακόμη απόθεμα στο DC Lund (βλ. συνημμένο αρχείο).

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε κάποια από τα υλικά που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο, επικοινωνήστε μαζί μου πριν από τις 2 Δεκεμβρίου. Ειδάλλως τα προϊόντα θα απορριφθούν πριν από το τέλος του έτους.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκινος
 Συντονιστής Τεχνικής Υποστήριξης
 Τηλ.: +30 210 6621360
 Φαξ: +30 210 6621361
 Κιν.: +30 6948 234434
www.gambro.com

**** Δήλωση αποποίησης ευθύνης από την Εταιρεία Gambro ****

Αυτό το μήνυμα ενδέχεται να περιέχει προνομιακές/εμπιστευτικές πληροφορίες. Εάν δεν είστε ο παραλήπτης που αναγράφεται σε αυτό το μήνυμα (ή υπεύθυνος για την παράδοση του μηνύματος στο εν λόγω πρόσωπο) δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε ή να παραδώσετε αυτό το μήνυμα σε κανέναν. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να καταστρέψετε αυτό το μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα με απαντητικό e-mail. Παρακαλείστε να ενημερώσετε αμέσως εάν εσείς ή ο εργοδότης σας δεν συναινείτε σε διαδικτυακό e-mail για μηνύματα αυτού του είδους. Οι γνώμες, τα συμπεράσματα και οι άλλες πληροφορίες αυτού του μηνύματος που αφορούν τον εργοδότη του αποστολέα και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του αντιπροσωπεύουν τη γνώμη του αποστολέα και δεν εκπροσωπούν ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις και γνώμες του εργοδότη.

**** Τέλος δήλωσης αποποίησης ευθύνης ****

Η εσωτερική βάση δεδομένων ιών είναι παρωχημένη.

Ελέγχθηκε από το AVG.

Έκδοση: 7.5.560 / Βάση Δεδομένων Ιών: 270.10.6/1891 - Ημερομηνία Έκδοσης: 13/1/2009 8:17

Πιστή και ακριβή μετάφραση του
 συνημμένου εγγράφου από την
 Αρχική στην Ελληνική
 γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 39
 του κώδικα Δικηγορίας.
 Αθήνα, 23/11/2014
 © Επικοινωνιών-Βεβαίωτων Δικηγόρος

ΘΩΤΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΜΠΑΝΗΣ
 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΜΔΣΑ: 18705
 ΜΑΧΗΤΩΝ 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 1854
 ΑΦΜ: 087385570 - ΔΟΥ: ΣΤ' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 ΤΗΛ.: 210 4210.272 - 210 66.66.986
 ΚΙΝ.: 6945 38 26 52

©OTICE ©
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΜΑΧΗΤΩΝ 21
Τ.Κ.Μ.: 097388531
ΝΑΥ.: 210 42.10
ΚΗΜ.: 8

©OTICE © ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΜΑΧΗΤΩΝ 2 ΠΕΡΑΙΑΣ
ΜΑΤΑ: 18705
ΤΗΛ.: 210 278 2109
ΚΗΜ.: 210 278 2109
ΝΑΥ.: 097388531

SERCO LTD

Από: Vasilis Kokkinos, Vasilis
Προς: serco1@otenet.gr; "cms" <cms@scs-net.org>; "Customer Support Unit - Conventional Equipment" <csu-be@intermedic.com.lb>; "medical" <medical@darmangar.co.ir>; <Avi.Peleg@teva.co.il>

Αποστολή: Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009 9:35 πμ
Επισύναψη: SP_AK10_AK100_AK90_091120.xls
Θέμα: Spare parts for AK10/AK100/AK90 to be scrapped
Dear all.

The support period for AK10, AK100 and AK90 spare parts has ended. For some spare parts we still have stock in DC Lund (see attached file).

If you still have need for any of the materials in the attached file please get back to me before Dec 2nd. Otherwise the products will be scrapped before the year end.

Best regards

Vasilis Kokkinos
Technical Support Coordinator
Tel: +30 210 6621360
Fax: +30 210 6621361
Mob: +30 6948 234434
www.gambro.com

**** Disclaimer from Gambro Corporation ****

Privileged/confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for the delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply e-mail. Please advise immediately if you or your employer does not consent to Internet e-mail for messages of this kind. Opinions, conclusions and other information in this message that pertain to the sender's employer and its products and services represent the opinion of the sender and do not necessarily represent or reflect the views and opinions of the employer.

**** End of disclaimer ****

Internal Virus Database is out-of-date.

Checked by AVG.

Version: 7.5.560 / Virus Database: 270.10.6/1891 - Release Date: 13/1/2009 8:17 δλ

Γενικές πληροφορίες 168

Ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου 2013

Σχετικά με: Όλα

C.o. no.

Τέλος υποστήριξης για τα AK 200 / AK 200 ULTRA

Η περίοδος της υποστήριξης συντήρησης για τα AK 200 / AK 200 ULTRA θα φθάσει σύντομα στο τέλος της. Η υποστήριξη για τεχνικές ερωτήσεις, ανταλλακτικά και επισκευή ανταλλακτικών θα συνεχιστεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013. Οι παραγγελίες για μοναδικά ανταλλακτικά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, κατά προτίμηση πριν από την 1^η Απριλίου.

Έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013 δεν θα εξεταστούν ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή οποιοδήποτε άλλου είδους βελτιώσεις, εκτός αν υπαγορεύονται για λόγους ασφάλειας.

Σημείωση! Δεν συνιστάται πλέον η χρήση των προϊόντων μετά την 31^η Δεκεμβρίου 2013 και τα παράπονα που θα αφορούν αυτά τα προϊόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Με εκτίμηση,

Hakan Ohlsson

Johan Ek Dahl

Ακριβής μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
εκ του συνημμένου στην αγγλική πρωτότυπου

Αθήνα, 30/9/2014


Η Μεταφράστρια Δικηγόρος


ΙΑΒΑ Α. ΜΙΣΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ

και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
AM ΔΣΑ 80352
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ
και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
AM ΔΣΑ 80352
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 106 82 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997603842 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8211393 - FAX: 210 8211395



Γ. Κ. ΣΥΔΗΣ
ΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ.
ΑΘΗΝΑ: 99760384
ΤΗΛ.: 210 8211331

Γ. Κ. ΣΥΔΗΣ
ΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΝΟΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΑΪΜΗ 45, Τ.Κ. 11527
ΑΘΗΝΑ: 99760384 - ΤΗΛ.: 210 8211331
ΤΗΛ.: 210 8211335 - FAX: 210 8211395

8100000000
106 552
301 82
FAX: 210 821439
ASHNA
ASHNQN

Service Newsletter

AK 200

General Information 168

Date: 23 January 2013

Concerning: All

C.o. no.

End of support for AK 200 / AK 200 ULTRA

The maintenance support period for AK 200 / AK 200 ULTRA will soon come to its end. The support for technical inquiries, spare parts and spare parts repair will continue until 31st December 2013. Orders for unique spare parts should be placed as soon as possible, preferably before 1st April.

Up to 31st December 2013, no updates, modifications or any other type of improvements will be considered unless dictated by safety issues.

Note! After 31st December 2013, the use of the products is no longer advisable and complaints concerning these products will not be taken into consideration.

Best regards

Håkan Ohlsson

Johan Ekdahl

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από APOSTOLOS SINIS
Ημερομηνία: 2015.07.24 13:54:16 EEST



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αβέρωφ 12Α, 10433 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132037545
Φαξ: 2102037531

Αθήνα, 24/07/2015

Αρ. πρωτ. : 2889

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αποφάσισε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο) συνεδρίασή της τα εξής:

1. Η Ε.Π.Υ. αυτοδεσμεύεται, ώστε η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ως προς όλους τους διαγωνισμούς που αυτή διεξάγει να διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη, υπό στοιχεία (α) έως και (δ), διαδικασία και απαιτήσεις:

(α) Ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για κάθε προϊόν και υπηρεσία αναρτάται στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ανακοίνωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με την ανακοίνωση αυτή καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ανάρτησης, πρώτον, όλοι οι προμηθευτές του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν, να υποβάλουν στο Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τις επίσημες, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και δεύτερον, οι επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών να υποβάλουν στο ίδιο Τμήμα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τις προτεινόμενες από αυτούς, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από τους ανωτέρω προμηθευτές και τους ανωτέρω επισήμους φορείς ή/και ενώσεις αυτών γίνεται ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως,

είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)]. Στην ίδια αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας συλλέγει από επίσημους φορείς πιστοποίησης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εγκεκριμένες από αυτούς τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν.

Το σύνολο του υλικού που κατά τα ανωτέρω υποβάλλεται στο Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και συλλέγεται από αυτό, πρώτον, παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας στην Επιτροπή Προδιαγραφών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ολοκλήρωσης της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, και δεύτερον, αναρτάται από το ίδιο Τμήμα στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών.

(β) Κάθε τελικό σχέδιο κάθε Επιτροπής Προδιαγραφών τίθεται υποχρεωτικώς σε δημόσια διαβούλευση.

(γ) Κάθε τελική απόφαση κάθε Επιτροπής Προδιαγραφών πρέπει να διαλέγεται τουλάχιστον με το ως άνω, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (α), υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, τις εν γένει διεθνείς, παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, τις παραδοχές της επιστήμης, την εμπειρία, τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου.

(δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.

2. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ως προς όλους τους διαγωνισμούς που διεξάγονται από δημόσιους φορείς υγείας πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, με τις εξής δύο διαφοροποιήσεις:

(α) Η προβλεπόμενη στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1 ανάρτηση λαμβάνει χώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

(β) Αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 1 για την εν γένει συλλογή του υλικού που παραδίδεται στην Επιτροπή

Προδιαγραφών λογίζεται η υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. Οι απαιτήσεις των στοιχείων (γ) και (δ) της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν από την 17^η Ιουλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ενέκρινε το σύνολο της διαδικασίας και των απαιτήσεων της παραγράφου 1, μόνον τις Επιτροπές Προδιαγραφών που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και δεν έχουν ακόμη, έως την ως άνω ημερομηνία, παραδώσει υπογεγραμμένες, από όλα τα μέλη τους, τις προτεινόμενες από αυτές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, πλην της ειδικότερης απαίτησης του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα να διαλέγονται με το υλικό που το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1, να παραδίδει σε κάθε Επιτροπή Προδιαγραφών.

Ο Αντιπρόεδρος

Απόστολος Κ. Σίνης

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΣ : ▪ **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**
 - **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - **Πρόεδρος / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία**

 ▪ **Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για
 την εξέταση της παρούσας**

Θέμα : Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή και συντήρηση
 μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του οίκου **GAMBRO**

Σχετικά με το έγγραφό σας με αριθμ. πρωτ. 2889/24-07-2015 που αφορά την ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), σας υποβάλουμε τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που δραστηριοποιείται και προσφέρει η εταιρεία μας για 30 και πλέον χρόνια στα Δημόσια Νοσοκομεία στην Ελλάδα, ήτοι **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO.**

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO.

1) Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου **GAMBRO** της **M.T.N.** του Νοσοκομείου .

2) Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο .

3) Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα υπό ανάθεση μηχανήματα (συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων) ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε όμοιους τύπους μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου **GAMBRO.**

4) Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά τρίμηνο). Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασιών ημερών της **M.T.N** (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο)

με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

- 5) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν., μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίησή της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.
- 6) Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων, αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το νοσοκομείο.
- 7) Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
- 8) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.
- 9) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.
- 10) Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά κάθε μηχανήματος τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.
- 11) Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
- 12) Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:
 - Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει αμέριστα την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO του Νοσοκομείου .

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχάνημα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως .

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο .

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, εν μέρει, περιλαμβάνονται σε πρόσφατη διακήρυξη με αριθμ. 5402/23-06-2015 (Σχετ. 1) του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», ο οποίος διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, οι προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής συντάχθηκαν από το νοσοκομείο, μέσω δημόσιας διαβούλευσης που διενέργησε και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το πρακτικό υπ' αριθμ. 64/14-05-2015.

Επίσης παρόμοιες προδιαγραφές περιλαμβάνονται και στις διακηρύξεις του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 2) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 3), όπως και στις δύο τελευταίες διακηρύξεις της Ν.Μ. Μεσολογγίου 2860 (Σχετ. 4) και 11898 (Σχετ. 5) στις οποίες δεν υφίστανται αδικαιολόγητα εμπόδια ανάπτυξης και λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο) και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (δ) της παραγράφου 1 αναφέρεται:

«(δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.»

Ενώ λοιπόν βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και όχι ο περιορισμός του ...μέσω τεχνικών προδιαγραφών ... που ευνοούν ένα συγκεκριμένο προμηθευτή με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων και οικονομικότερων τιμών καθώς και ποιοτικότερων υπηρεσιών, παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποια Δημόσια Νοσοκομεία να θέτουν ακριβώς προδιαγραφές τέτοιες οι οποίες φωτογραφίζουν απόλυτα ένα συγκεκριμένο προμηθευτή, κατακρεουργώντας κάθε έννοια ανταγωνισμού και οδηγώντας τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς επί της ουσίας σε κεκαλυμμένες απ' ευθείας αναθέσεις ανεξαρτήτου ποιότητας και προσφερόμενης τιμής, ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Για τα φαινόμενα αυτά η εταιρεία μας έχει καταθέσει στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας πλήθος εγγράφων που τα καταγγέλλει.

2. Φωτογραφικές προδιαγραφές και όροι που πρέπει να αποφευχθούν.

2.1. Όρος «Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει απαρέργκλιτα ο κατασκευαστής, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές

απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί (μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντι ανταγωνιστικό μπουϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι *«Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 6).*

Ακολουθώς, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο *service* στα Νοσοκομεία ως συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

2.2. Όρος «Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος».

2.2.1 Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι

αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούσαν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ.7), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα

(εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσκορπεί στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον

αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

2.2.2 Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από τα Νοσοκομεία απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλλει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

2.3. Όρος : *«Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού».*

Ο εν λόγω όρος στο βαθμό που απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς προϋποθέτει συμβατική σχέση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρίας και του αναδόχου συντηρητή, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο νόμιμο στόχο, ήτοι για την πιστοποίηση της πραγματικής δυνατότητας του αναδόχου συντηρητή για συντήρηση και επισκευή των σχετικών ιατρικών μηχανημάτων. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρίας με την κατασκευάστρια εταιρία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες

αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους. Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από δημόσια νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την

τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας , έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 4) και αρ.πρωτ. 11898/17-11-2014 (Σχετ. 5) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Υπογραμμίζουμε δε, ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων, όλων των ετών, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, που αφορούν την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro, πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι, πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθεταν οι σημερινοί περιούσιοι συντηρητές, που αντιπροσωπεύουν το εν λόγω ΚΑΡΤΕΛ. Τέτοιοι όροι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, και ξεκάθαρα τέθηκαν από κάποια νοσοκομεία με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΚΑΡΤΕΛ.

Γ. Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού από το 1976. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία μας ήταν το μοναδικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο

επισκευών της Gambro στην Ελλάδα, καθώς και ο αποκλειστικός διανομέας ανταλλακτικών. Ουδέποτε όμως χρησιμοποιήσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε την ιδιότητα μας αυτή για να μονοπωλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αθέμιτα την Ελληνική Αγορά των επισκευών και συντηρήσεων των Μ.Τ.Ν. του οίκου Gambro. Αντιθέτως δίναμε απλόχερα σε όποιον μας ζητούσε τόσο τα ανταλλακτικά όσο και την τεχνολογία της Gambro, ως αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη εταιρεία που ήμασταν, χωρίς να δημιουργούμε το παραμικρό εμπόδιο εισόδου και παραμονής σε κανέναν στην εν λόγω αγορά.

Η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (MEDICAL) έχει αποδυθεί σε απόλυτη σύμπνοια και συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο Gambro Lundia AB (GAMBRO) επί τετραετία και πλέον, σε ανηλεή εμπορικό πόλεμο κατά της εταιρείας μας με αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές, προκειμένου να πετύχει την μονοπώληση της ελληνικής αγοράς παροχής υπηρεσιών service στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του ως άνω κατασκευαστικού οίκου, επί ζημιά του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Επί των ως άνω παράνομων πρακτικών και επιδιώξεων των δύο εταιριών έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011, η GAMBRO παράνομα και αντισυμβατικά έπαψε να μας τροφοδοτεί με ανταλλακτικά και μας παρέπεμψε στη Medical, τον νέο διανομέα της ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά. Πλην, όμως αργότερα και η Medical διέκοψε την τροφοδοσία της ΣΕΡΚΟ, την οποία όπως μας δήλωσε (προσχηματικά όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων) θα διατηρούσε μόνο για τις εκκρεμείς συμβάσεις μας. Εν συνεχεία, στις 16 Φεβρουαρίου του 2012 η GAMBRO, σε πλήρη σύμπλευση με τη MEDICAL κλιμακώνοντας τις αντιανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές τους, αιφνιδίως διέκοψε στη ΣΕΡΚΟ την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματά της προκειμένου να δυναμιτίσει την παροχή υπηρεσιών από μέρους μας.

Η εταιρεία μας προσέφυγε αμέσως στη Δικαιοσύνη, η οποία δια της υπ' αριθμ. 5667/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απεφάνθη μεταξύ άλλων κατά το διατακτικό της:

- *ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ* ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά –

Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

- ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπτώξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Η εταιρεία μας είναι από τις λίγες εξαιρέσεις στην ελληνική αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων που προσπαθεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάποια νοσοκομεία ενώ βλέπουν ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων δεν αναπτύσσεται καθόλου ανταγωνισμός και λειτουργεί το απόλυτο μονοπώλιο προσπαθούν, αντί να συνδράμουν στην ανάπτυξη ανταγωνισμού και στο άνοιγμα της αγοράς και σε μικρές εταιρείες όπως η εταιρεία μας, να προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες υπέρ της στεγανοποίησης της αγοράς, βοηθώντας και συμμετέχοντας στις εναρμονισμένες παράνομες αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές των πολυεθνικών κατασκευαστών και των βραχιόνων τους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε Διαγωνισμό Δημόσιου Νοσοκομείου για την συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στον οποίο δεν συμμετείχαμε, λόγω του

παράνομου μπουϊκοτάζ προμήθειας ανταλλακτικών, που προαναφέραμε, και έχουμε ήδη δικαιωθεί, η διαφορά - ζημιά - για το Δημόσιο συμφέρον φθάνει τις 13.500 €, παραπάνω κόστος από τη μονοπωλιακή σύμβαση που υπέγραψε με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Σε όλο τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή inhouse). (βλ. αντίστοιχες εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) (Σχετ. 8).

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε. και της Gambro, θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπανανία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε κοινοποιήσει και είναι εν γνώση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, καθώς και μέσω των καταγγελιών μας και Αγωγών είναι εν γνώση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Οράτε ενδεικτικά:

Στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-

2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας: Αρ. πρωτ. 2210/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2211/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2335/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 2336/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 321/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 406/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 621/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 622/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 1009/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1010/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1011/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1207/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1208/19-5-2012, Αρ. πρωτ. 1209/19-5-2015.

Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Αρ. πρωτ. 2280/22-5-2014, Αρ. πρωτ. 2344/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2345/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2427/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2624/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 2793/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 2887/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 2888/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3222/30-7-2014, Αρ. πρωτ. 3255/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 3588/4-9-2014, Αρ. πρωτ. 3938/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 3993/26-9-2014, Αρ.

πρωτ. 4086/2-10-2014, Αρ. πρωτ. 4170/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4169/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4218/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 4247/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 4666/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 5401/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5402/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5403/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5404/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5405/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5406/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 658/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 659/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 842/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 1140/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1142/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1963/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1964/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1965/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1966/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1967/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 2213/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2214/19-5-2012 Αρ. πρωτ. 2215/19-5-2015.

Στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης: Αρ. πρωτ. 23836/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 25335/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 26642/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 26643/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 27771/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 27772/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 3387/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 4175/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 5611/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 5613/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 9919/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9920/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9922/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9923/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9924/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 11347/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11348/19-5-2012, Αρ. πρωτ. 11350/19-5-2015.

Προς επιπλέον απόδειξη ότι τα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία απαιτούν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες και δεν τάσσονται υπέρ του παράνομου ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αλλά υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ απορρίπτοντας τις παράνομες πρακτικές του ΚΑΡΤΕΛ, σας παραθέτουμε λίστα με τα Δημόσια Νοσοκομεία που προσφάτως έχει συνάψει συμβάσεις η εταιρεία μας, και είμαστε στη διάθεσή σας, μόλις μας ζητηθεί, να σας προσκομίσουμε και τα πρακτικά κατακύρωσης – συμβάσεις, παρόλο που αυτά είναι δημόσια διαθέσιμα από την εφαρμογή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ :

- 1) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- 2) Γ. Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ
- 3) Γ. Νοσοκομείο –Κ.Υ. Κω
- 4) Γ. Νοσοκομείο Φιλιατών
- 5) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
- 6) Γ. Νοσοκομείο Λευκάδας
- 7) Γ. Νοσοκομείο Καλύμνου
- 8) Γ. Νοσοκομείο Λιβαδειάς

- 9) Γ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
- 10) 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
- 11) Γ. Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- 12) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
- 13) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
- 14) Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας
- 15) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κύμης
- 16) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- 17) Γ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου
- 18) Γ. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
- 19) Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας
- 20) Γ. Νοσοκομείο Πύργου
- 21) Γ. Νοσοκομείο Αγρινίου
- 22) Γ. Νοσοκομείο Ρεθύμνου
- 23) Γ. Νοσοκομείο Πρέβεζας

Κατόπιν τούτων, η συμβολή των Δημόσιων Νοσοκομείων και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει να είναι καθοριστική στην αποτροπή εγκαθίδρυσης παράνομων μονοπωλιακών καταστάσεων στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων, με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη του Δημόσιου Συμφέροντος μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται απλοί παρατηρητές και ακόμη περισσότερο συμμετοχοί στο «τεράστιο πάρτυ» των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ .

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των παραπάνω σας παραθέτουμε αυτούσιες τις παρατηρήσεις τις εταιρείας μας , από τη συμμετοχή της σε 2 πρόσφατες Δημόσιες Διαβουλεύσεις Τεχνικών προδιαγραφών .

1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

(αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ : 3211/20-8-2015)

«Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015

- ΠΡΟΣ:
- 4^η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 - Διοικητή
 - Γραφείο Προμηθειών / Κα Βακαλίδου
 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 - Αναπλ. Διοικητή Νοσοκομείου / Κο Νικόλαο Φαρμάκη
 - Γραφείο Προμηθειών / Κα Αφροδίτη Μιχαηλίδου
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Πρόεδρον / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
Κο Λέανδρο Ρακιντζή
 - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 - Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα.
 - Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης: Αγίας Σοφίας 46,
54622 Θεσσαλονίκη / Υπόψη Κού Σαβαΐδη Γεωργίου
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την
εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την πρώτη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμου ακριβείας» (cpn 5042100-2) – Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών Ε. Για τη συντήρηση Εννέα (9) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.050 € με ΦΠΑ,

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει

να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απόλυση ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγω αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

«E) Για τη συντήρηση Εννέα (9) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.050 € με ΦΠΑ.»

1.Όρος « Να κατατεθεί βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα.

Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τουτό, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρητρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλλει πράγματι την παράνομη και ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω όρος περί προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχε, με αυτή τη μορφή, σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ειδικότερα, στην τελευταία διακήρυξη με αριθμ. 94/2014 αναγραφόταν ότι:

«Να καταθέσει βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας»
δινόταν έτσι η δυνατότητα στην εταιρεία μας να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και να εγκριθεί η τεχνική μας προσφορά από την επιτροπή του διαγωνισμού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, παρόλη την έλλειψη πιστοποιητικών εκπαίδευσης για τα μηχανήματα AK-200 ULTRA, αφού καταθέσαμε πιστοποιητικά εκπαίδευσης παρόμοιων μηχανημάτων του ίδιου οίκου κατασκευής (AK-200S), πετυχαίνοντας έτσι το νοσοκομείο για πρώτη φορά ανάπτυξη ανταγωνισμού και συμμετοχή μεγαλύτερη του ενός συντηρητή, πέραν αυτή του επί πολλών ετών μονοπωλιακού και κεκαλυμμένου απευθείας αναδόχου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με

τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία μας παρά την έλλειψη των πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή οίκο, δραστηριοποιείται επιτυχώς στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα από το 1976, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών αλλά και πολύ πιο οικονομικότερων για το συμφέρον των νοσοκομείων και για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ εν γένει, Τιμών . Οράτε Σχετ. 2 Σύμβαση υπ' αριθμ. 8992/23-04-15, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (20 μηχανήματα τύπου AK-200S και 9 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 158 € το μηχάνημα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ

Ομοίως οράτε Σχετ. 3 Σύμβαση υπ' αριθμ. πρωτ. 8748, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ, Κόμης με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (5 μηχανήματα τύπου AK-200S και 2 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 169,98 € το μηχάνημα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Ομοίως οράτε Σχετ. 4 Σύμβαση υπ' αριθμ. 1/1-8/2014, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (10 μηχανήματα τύπου AK-200S και 1 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 172 € το μηχανήματα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήματα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – **ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ**.

Επίσης οράτε Σχετ. 5 Σύμβαση υπ' αριθμ. 9075, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (7 μηχανήματα τύπου AK-200S και 4 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τελική τιμή των 160,00 € το μηχανήματα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήματα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – **ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ**.

Στην τελευταία διακήρυξη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με αριθμ. 94/2014, στον εν λόγω όρο υπήρχε η φράση : ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης του ενός συντηρητή συμμετοχής και της πραγματικής ανάπτυξης ανταγωνισμού. Στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και από τον συγκεκριμένο όρο αφαιρέθηκε αυτή η φράση. Ευλόγως, κάθε νοήμων άνθρωπος, θα απορούσε για την σκοπιμότητα της αλλαγής αυτού του όρου :

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει ευρεία συμμετοχή και ανάπτυξη ανταγωνισμού στη συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO ;

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει ποιοτικότερες υπηρεσίες συντήρησης ;

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει οικονομικότερες τιμές και εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ ;

Η μήπως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με πρόσχημα δήθεν την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του συντηρητή, θέλει με πάση θυσία την διατήρηση της

πολύχρονης παράνομης μονοπωλιακής συνεργασίας, με τον περιούσιο συντηρητή , ανεξαρτήτου ποιότητας και κόστους ;

Υπογραμμίζοντας δε ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων , όλων των ετών συνεργασίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με τον επί πολλά χρόνια περιούσιο συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. , πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι , πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθετε ο εν λόγω περιούσιος συντηρητής.

2.Όρος «Να καταθέσει βεβαίωση από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών, που θα φέρουν πιστοποίηση CE, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης»

Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί

και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ. 6), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε

ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαιώσεως που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαφεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όλως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις των Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 7) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 8), του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχετ. 1) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία).

Τα Νοσοκομεία που θέλησαν πραγματικά και όχι προσχηματικά να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής συντηρητών πέτυχαν και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολύ οικονομικότερες τιμές :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Α/Α	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ	158,00 €	29 Μ.Τ.Ν.	20 MTN AK-200S & 9 MTN AK-200 ULTRA S
2.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	172,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S & 1 AK-200 ULTRA S
3.	ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ	165,00 €	2 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S
4.	Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	165,00 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S, 2 MTN AK-200 2 MTN AK-95S
5.	Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170,00 €	11 Μ.Τ.Ν	4 MTN AK-200S, 6 MTN AK-200 & 1 MTN AK-95

6.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ	195,00 €	10 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S
7.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	178,95 €	7 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S
8.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	160,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S & 4 AK-200 ULTRA S
9.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	162,50 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-95, 3 MTN AK-95S & 1 MTN AK-200S
10.	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	189,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	6 MTN AK-200, 2 MTN AK-95 & 1 MTN AK-200S
11.	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	166,67 €	13 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95, 1 MTN AK-200, & 8 MTN AK-200S
12.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	176,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-10, 1 MTN AK- 100, 2 MTN AK-200, 4 MTN AK-200S & 1 MTN AK-200SU
13.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	177,78 €	7 Μ.Τ.Ν.	3 MTN AK-10, 1 MTN AK-95 & 3 MTN AK-200S
14.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	160,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95S

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

[...]

Τέλος, εφόσον η παρούσα διαβούλευση δεν είναι προσχηματική και υπάρχει πραγματική βούληση – πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και της μέγιστης δυνατής ανάπτυξης ανταγωνισμού,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι, για πρώτη φορά:

- το σταμάτημα των ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

[...]»

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ : 3212/20-8-2015)

«Αθήνα, 06 Ιουλίου 2015

- ΠΡΟΣ:**
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ &
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κος Γεώργιος Βλάχος
 - Τμήμα Οικονομικού /
Κα Δέσποινα Λαυρέντζου – Κα Ρ. Φραγκιαδουλάκη
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Προέδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ' αριθμ. 9020/30-6-2015

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ζένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές Ν.Μ. Αγρινίου(των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO) – Ν.Μ. Μεσολογγίου

I. Όρος «Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ευθύνη του κατασκευαστή να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει απαραίτητα ο κατασκευαστής, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί

(μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντιανταγωνιστικό μποϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι «Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 1).

Ακολούθως, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο service στα Νοσοκομεία ως συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

- α. Να είναι ηλεκτρονικοί.
- β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

2. Όρος (Ετήσιας συντήρησης των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO της Ν.Μ. Αγρινίου(σελίδα 25) – τεχνικές προδιαγραφές Ν.Μ. Μεσολογγίου (α/α:12 σελίδα 28)) «Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος».

2.1 Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό

αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι εννοούν και υποθάλπουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούσαν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ.2), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαίωσης που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

2.2 Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τουτό, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον

κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλπει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπευθυμίζουμε στο Νοσοκομείο ότι οι ως άνω όροι περί πιστοποιητικού συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο για την προμήθεια ανταλλακτικών, καθώς και περί προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχαν σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών των νοσοκομείων σας. Ειδικότερα, στην πρόσκληση με αριθμ. Πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 3) της Ν.Μ. Μεσολογγίου αναγραφόταν ότι:

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη μονάδα τεχνητού νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς.

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Όμοιους όρους είχε και η προγενέστερη πρόσκληση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου με αρ. πρωτ. 11898/17-11-2014. (Σχετ. 4).

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές στη Ν.Μ. Μεσολογγίου

3. Όρος : «Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού».

Ο εν λόγω όρος στο βαθμό που απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς προϋποθέτει συμβατική σχέση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρείας και του αναδόχου συντηρητή, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο νόμιμο στόχο, ήτοι για την πιστοποίηση της πραγματικής δυνατότητας του αναδόχου συντηρητή για συντήρηση και επισκευή των σχετικών ιατρικών μηχανημάτων. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει

εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους. Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 5) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας

Μεσολογίου, αρ.πρωτ. 11898/17-11-2014 (Σχετ. 3) και αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 4) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Θεωρούμε ότι ουδέν έχει να προσφέρει ο εν λόγω όρος, καθώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις καλύπτονται πλήρως από τους έτερους όρους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να προσκομίζεται:

«Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ. /1348/2004 σχετικά με την ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

«Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη Διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ εξοπλισμού».

«Να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις καλής συνεργασίας και εκτέλεσης των συμβάσεων συντήρησης με αντίστοιχα ιδρύματα».

Συνεπώς προτείνουμε την πλήρη απόλεια του εν λόγω όρου από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαψεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όλως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις δύο Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 6) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 7), καθώς και του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχετ. 5), όπως και τις δύο τελευταίες διακηρύξεις της Ν.Μ. Μεσολογγίου 2860 (Σχετ. 3) και 11898 (Σχετ. 4) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία). Σας επισυνάπτουμε το πρακτικό του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 8) όπου έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Ομοίως τους καρπούς της ανάπτυξη του ανταγωνισμού έδρασε το Νοσοκομείο σας σε όλες τις προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες κερδίζοντας οικονομικότερες αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες, οράτε ενδεικτικά το διαγωνισμό του Νοσοκομείου Αγρινίου με την υπ' αριθμό 17200/31-10-2014 & ΑΔΑ 756Π46904Μ-ΨΒ6 ανάρτηση του Νοσοκομείου σας, για την Τρίμηνη Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης Gambro για το χρονικό διάστημα τριών μηνών, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας υποβάλλοντας την προσφορά της, καθώς και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ. Η προσφορά της εταιρείας μας (ΣΕΡ.ΚΟ) ανερχόταν στα 2.898,00 € χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ανερχόταν στο ποσό των 3.699,00 € χωρίς ΦΠΑ δηλαδή διαφορά – όφελος για το Νοσοκομείο από την ανάπτυξη ανταγωνισμού: 801,00 € για τους τρεις μήνες και 3204,00 € αναγόμενο σε ετήσια βάση.

Και αντίστοιχα το διαγωνισμό της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11898/17-11-2014 και ΑΔΑ: ΨΨΑΑ46907Π-ΥΕΔ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, για την επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού για το χρονικό διάστημα δύο μηνών, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας υποβάλλοντας την προσφορά της, καθώς και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ. Η προσφορά της εταιρείας μας (ΣΕΡ.ΚΟ) ανερχόταν στα 1.638,00 € χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ανερχόταν στο ποσό των 2.160,00 € χωρίς ΦΠΑ δηλαδή διαφορά – όφελος για το Νοσοκομείο από την ανάπτυξη ανταγωνισμού: 522,00 € για τους δύο μήνες και 3.132,00 € αναγόμενο σε ετήσια βάση.

Το Νοσοκομείο σας γνωρίζει άριστα τις πολύ ποιοτικές και οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες που προσφέρει όλα τα χρόνια η εταιρεία μας ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ από την πολυετή συνεργασία του μαζί μας από το 1986 μέχρι και σήμερα .

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

[...]»

Επειδή η εταιρεία μας, όπως έχει διαπιστώσει και υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βιώνει τις σκληρές πρακτικές ενός αδίστακτου καρτέλ που επιδιώκει τη μονοπώληση των δημόσιων διαγωνισμών επί μεγίστη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Επειδή οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες των υπό ανάθεση συμβάσεων και πρέπει να δρουν υπέρ του ανταγωνισμού, έτσι ώστε

να απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες με περισσότερο από 30% χαμηλότερες τιμές.

Επειδή οι δημόσιες συμβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί απαγορεύεται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία να αποτελούν απευθείας ανάθεση, αλλά αντιθέτως πρέπει να σέβονται κατά τις διεξαγόμενες διαδικασίες τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Επειδή τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι τσιφλίκι κανενός, δεν πρέπει να πετούν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού προκειμένου να υποστηρίξουν το ΚΑΡΤΕΛ της Medical, της Τεχνοϊατρική και της Gambro.

Επειδή η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας τελεί σε πλήρη γνώση της δράσης του ΚΑΡΤΕΛ της Medical, της Τεχνοϊατρική και της Gambro με πλήθος εγγράφων που σας έχει κοινοποιήσει η εταιρεία μας :

Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2012, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015,

Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015,
Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015,
Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015.

Επειδή η παρούσα υποβολή των Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται από την εταιρεία μας ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή, cd, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, όπως ορίζει η ανακοίνωσή σας, έγγραφο με αρ. πρωτ. 2889/24-07-2015.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και Παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι :

- το σταμάτημα των ασύμφωνων μονοπωλιακών συνεργασιών των Δημόσιων Νοσοκομείων .
- την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro .
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τους προϋπολογισμούς των Δημόσιων Νοσοκομείων – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Επισυναπτόμενα Σχετικά:

- 1) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 5402/23-06-2015 του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου– Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
- 2) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2014 του Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «TZANEIO»
- 3) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2137/2015 του Γ.Ν. Ρεθύμνου
- 4) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 2860/20-03-2015

- 5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 11898/17-11-2014
- 6) Σύμβαση 4567/2003 Υπουργείου Ανάπτυξης – Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ
- 7) Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου
- 8) Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για συντηρήσεις ιατρικών μηχανημάτων με αποσπασματική μετάφραση
- 9) Ψηφιακός Δίσκος (cd) με όλα τα δεδομένα του παρόντος



Μπάλτσας Ιωάννης

Για τη ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ

ΣΕΡ.ΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ.: 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ



Στεριώτης Κων/νος

Διαχειριστές

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015

- ΠΡΟΣ :**
- **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κο ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟ
 - Τμήμα Προμηθειών
 - 1^η ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Διοικητή / Κοσ Άγγελος Παπαδόπουλος
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 ΥΠΟΨΗ: Προέδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
 Κο Λεάνδρο Ρακιντζή
 - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας
- Θέμα : Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για το αντικείμενο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού Εξοπλισμού (Συντήρηση Μηχανημάτων T. N. (50421000-2)), Συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού του οίκου GAMBRO»**

Κύριοι,

Κατόπιν του εγγράφου του νοσοκομείου σας αρ. πρωτ. 19763/28-09-2015 και σε εφαρμογή της 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο) απόφασης της Επιτροπής

Προμηθειών Υγείας υπ' αριθμ. πρωτ. 2889/24-07-2015 της σχετικής ανακοίνωσης, σας υποβάλουμε τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που δραστηριοποιείται και προσφέρει η εταιρεία μας για 30 και πλέον χρόνια στα Δημόσια Νοσοκομεία στην Ελλάδα, ήτοι ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO.

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO.

1) Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου.

2) Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο .

3) Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα υπό ανάθεση μηχανήματα (συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων) ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε όμοιους τύπους μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου GAMBRO.

4) Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά τρίμηνο). Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασιών ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

5) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν., μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίησή της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

6) Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων, αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το νοσοκομείο.

7) Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

8) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.

9) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

10) Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά κάθε μηχανήματος τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

11) Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου .

12) Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO του Νοσοκομείου.

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχανήμα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχανήμα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως .

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, εν μέρει, περιλαμβάνονται σε πρόσφατη διακήρυξη με αριθμ. 5402/23-06-2015 (Σχετ. 1) του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», ο οποίος διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, οι προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής συντάχθηκαν από το νοσοκομείο, μέσω δημόσιας διαβούλευσης που διενέργησε και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το πρακτικό υπ' αριθμ. 64/14-05-2015.

Επίσης παρόμοιες προδιαγραφές περιλαμβάνονται και στις διακηρύξεις του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 2) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 3), όπως και στις δύο τελευταίες διακηρύξεις της Ν.Μ. Μεσολογγίου 2860 (Σχετ. 4) και 8834 (Σχετ. 5) στις οποίες δεν υφίστανται αδικαιολόγητα εμπόδια ανάπτυξης και λειτουργίας του ανταγωνισμού.

B. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο) και πιο συγκεκριμένα στο στοιχείο (δ) της παραγράφου 1 αναφέρεται:

«(δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.»

Ενώ λοιπόν βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και όχι ο περιορισμός του ...μέσω τεχνικών προδιαγραφών ... που ευνοούν ένα συγκεκριμένο προμηθευτή με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων και οικονομικότερων τιμών καθώς και ποιοτικότερων υπηρεσιών, παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποια Δημόσια Νοσοκομεία να θέτουν ακριβώς προδιαγραφές τέτοιες οι οποίες φωτογραφίζουν απόλυτα ένα συγκεκριμένο προμηθευτή, κατακρεουργώντας κάθε έννοια ανταγωνισμού και οδηγώντας τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς επί της ουσίας σε κεκαλυμμένες απ' ευθείας αναθέσεις ανεξαρτήτου ποιότητας και προσφερόμενης τιμής, ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Για τα φαινόμενα αυτά η εταιρεία μας έχει καταθέσει στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας πλήθος εγγράφων που τα καταγγέλλει.

2. Φωτογραφικές προδιαγραφές και όροι που πρέπει να αποφευχθούν.

2.1. Όρος «Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει **απαρέγκλιτα** ο κατασκευαστής, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί

(μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντι ανταγωνιστικό μοϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι «Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 6).

Ακολούθως, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο *service* στα Νοσοκομεία ως συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

2.2. Όρος «Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος».

2.2.1 Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και ευνοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός ευνοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην

ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι ευνοούν και υποθάλπουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ. 7), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαίωσης που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

2.2.2 Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από τα Νοσοκομεία απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του

υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και **σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.**

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση **υποθάλλει** πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη

επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

2.3. Όρος : *«Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού».*

Ο εν λόγω όρος στο βαθμό που απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς προϋποθέτει συμβατική σχέση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρίας και του αναδόχου συντηρητή, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο νόμιμο στόχο, ήτοι για την πιστοποίηση της πραγματικής δυνατότητας του αναδόχου συντηρητή για συντήρηση και επισκευή των σχετικών ιατρικών μηχανημάτων. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρίας με την κατασκευάστρια εταιρία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες

ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους. Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από δημόσια νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας , έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 4) και αρ.πρωτ. 8834/21-9-2015 (Σχετ. 5) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Υπογραμμίζουμε δε, ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων, όλων των ετών, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, που αφορούν την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro, πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι, πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθεταν οι σημερινοί περιούσιοι συντηρητές, που αντιπροσωπεύουν το εν λόγω ΚΑΡΤΕΛ. Τέτοιοι όροι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, και ξεκάθαρα τέθηκαν από κάποια νοσοκομεία με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΚΑΡΤΕΛ.

Γ. Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού από το 1976. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία μας ήταν το μοναδικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών της Gambro στην Ελλάδα, καθώς και ο αποκλειστικός διανομέας ανταλλακτικών. Ουδέποτε όμως χρησιμοποιήσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε την ιδιότητα μας αυτή για να μονοπωλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αθέμιτα την Ελληνική Αγορά των επισκευών και συντηρήσεων των Μ.Τ.Ν. του οίκου Gambro. Αντιθέτως δίναμε απλόχερα σε όποιον μας ζητούσε τόσο τα ανταλλακτικά όσο και την τεχνολογία της Gambro, ως αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη εταιρεία που ήμασταν,

χωρίς να δημιουργούμε το παραμικρό εμπόδιο εισόδου και παραμονής σε κανέναν στην εν λόγω αγορά.

Η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (MEDICAL) έχει αποδυθεί σε απόλυτη σύμπνοια και συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο Gambro Lundia AB (GAMBRO) επί τετραετία και πλέον, σε ανηλεή εμπορικό πόλεμο κατά της εταιρείας μας με αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές, προκειμένου να πετύχει την μονοπώληση της ελληνικής αγοράς παροχής υπηρεσιών service στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του ως άνω κατασκευαστικού οίκου, επί ζημιά του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Επί των ως άνω παράνομων πρακτικών και επιδιώξεων των δύο εταιριών έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011, η GAMBRO παράνομα και αντισυμβατικά έπαψε να μας τροφοδοτεί με ανταλλακτικά και μας παρέπεμψε στη Medical, τον νέο διανομέα της ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά. Πλην, όμως αργότερα και η Medical διέκοψε την τροφοδοσία της ΣΕΡΚΟ, την οποία όπως μας δήλωσε (προσχηματικά όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων) θα διατηρούσε μόνο για τις εκκρεμείς συμβάσεις μας. Εν συνεχεία, στις 16 Φεβρουαρίου του 2012 η GAMBRO, σε πλήρη σύμπλευση με τη MEDICAL κλιμακώνοντας τις αντιανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές τους, αιφνιδίως διέκοψε στη ΣΕΡΚΟ την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματά της προκειμένου να δυναμιτίσει την παροχή υπηρεσιών από μέρος μας.

Η εταιρεία μας προσέφυγε αμέσως στη Δικαιοσύνη, η οποία δια της υπ' αριθμ. 5667/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απεφάνθη μεταξύ άλλων κατά το διατακτικό της:

- *ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ* ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.
- *ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ* τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα

εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Η εταιρεία μας είναι από τις λίγες εξαιρέσεις στην ελληνική αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων που προσπαθεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάποια νοσοκομεία ενώ βλέπουν ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων δεν αναπτύσσεται καθόλου ανταγωνισμός και λειτουργεί το απόλυτο μονοπώλιο προσπαθούν, αντί να συνδράμουν στην ανάπτυξη ανταγωνισμού και στο άνοιγμα της αγοράς και σε μικρές εταιρείες όπως η εταιρεία μας, να προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες υπέρ της στεγανοποίησης της αγοράς, βοηθώντας και συμμετέχοντας στις εναρμονισμένες παράνομες αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές των πολυεθνικών κατασκευαστών και των βραχιόνων τους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε Διαγωνισμό Δημόσιου Νοσοκομείου για την συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στον οποίο δεν συμμετείχαμε, λόγω του παράνομου μοιχοτάζ προμήθειας ανταλλακτικών, που προαναφέραμε, και έχουμε ήδη δικαιωθεί, η διαφορά - ζημιά - για το Δημόσιο συμφέρον φθάνει τις 13.500 €, παραπάνω κόστος από τη μονοπωλιακή σύμβαση που υπέγραψε με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Σε όλο τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό

προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή inhouse). (βλ. αντίστοιχες εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) (**Σχετ. 8**).

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε. και της Gambro, θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπαναρία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε κοινοποιήσει και είναι εν γνώση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, καθώς και μέσω των καταγγελιών μας και Αγωγών είναι εν γνώση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Οράτε ενδεικτικά:

Στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ.

2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3225/21-8-2015, Αρ. πρωτ. 3296/31-8-2015.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας: Αρ. πρωτ. 2210/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2211/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2335/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 2336/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 321/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 406/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 621/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 622/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 1009/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1010/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1011/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1207/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1208/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1209/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2259/1-9-2015.

Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Αρ. πρωτ. 2280/22-5-2014, Αρ. πρωτ. 2344/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2345/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2427/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2624/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 2793/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 2887/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 2888/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3222/30-7-2014, Αρ. πρωτ. 3255/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 3588/4-9-2014, Αρ. πρωτ. 3938/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 3993/26-9-2014, Αρ. πρωτ. 4086/2-10-2014, Αρ. πρωτ. 4170/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4169/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4218/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 4247/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 4666/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 5401/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5402/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5403/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5404/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5405/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5406/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 658/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 659/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 842/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 1140/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1142/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1963/5-5-2015,

Αρ. πρωτ. 1964/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1965/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1966/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1967/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 2213/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2214/19-5-2012 Αρ. πρωτ. 2215/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3742/1-9-2015.

Στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης: Αρ. πρωτ. 23836/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 25335/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 26642/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 26643/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 27771/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 27772/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 3387/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 4175/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 5611/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 5613/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 9919/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9920/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9922/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9923/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9924/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 11347/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11348/19-5-2012, Αρ. πρωτ. 11350/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 19222/1-9-2015

Προς επιπλέον απόδειξη ότι τα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία απαιτούν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες και δεν τάσσονται υπέρ του παράνομου ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αλλά υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ απορρίπτοντας τις παράνομες πρακτικές του ΚΑΡΤΕΛ, σας παραθέτουμε λίστα με τα Δημόσια Νοσοκομεία που προσφάτως έχει συνάψει συμβάσεις η εταιρεία μας, και είμαστε στη διάθεσή σας, μόλις μας ζητηθεί, να σας προσκομίσουμε και τα πρακτικά κατακύρωσης – συμβάσεις, παρόλο που αυτά είναι δημόσια διαθέσιμα από την εφαρμογή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ :

- 1) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- 2) Γ. Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ
- 3) Γ. Νοσοκομείο –Κ.Υ. Κω
- 4) Γ. Νοσοκομείο Φιλιατών
- 5) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
- 6) Γ. Νοσοκομείο Λευκάδας
- 7) Γ. Νοσοκομείο Καλύμνου
- 8) Γ. Νοσοκομείο Λιβαδειάς
- 9) Γ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
- 10) 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
- 11) Γ. Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- 12) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
- 13) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
- 14) Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας

- 15) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κύμης
- 16) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- 17) Γ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου
- 18) Γ. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
- 19) Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας
- 20) Γ. Νοσοκομείο Πύργου
- 21) Γ. Νοσοκομείο Αγρινίου
- 22) Γ. Νοσοκομείο Ρεθύμνου
- 23) Γ. Νοσοκομείο Πρέβεζας

Κατόπιν τούτων, η συμβολή των Δημόσιων Νοσοκομείων και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει να είναι καθοριστική στην αποτροπή εγκαθίδρυσης παράνομων μονοπωλιακών καταστάσεων στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων, με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη του Δημόσιου Συμφέροντος μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται απλοί παρατηρητές και ακόμη περισσότερο συμμετέχοι στο «τεράστιο πάρτυ» των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ .

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των παραπάνω σας παραθέτουμε αυτούσιες τις παρατηρήσεις τις εταιρείας μας, από τη συμμετοχή της σε 2 πρόσφατες Δημόσιες Διαβουλεύσεις Τεχνικών προδιαγραφών.

1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

(αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ : 3211/20-8-2015)

«Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015

- ΠΡΟΣ:
- 4^η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 - Διοικητή
 - Γραφείο Προμηθειών / Κα Βακαλίδου
 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
 - Αναπλ. Διοικητή Νοσοκομείου / Κο Νικόλαο Φαρμάκη
 - Γραφείο Προμηθειών / Κα Αφροδίτη Μιχαηλίδου
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Προέδρον / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /
Κο Λέανδρο Ρακιντζή
 - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 - Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
 - Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης: Αγίας Σοφίας 46,
54622 Θεσσαλονίκη / Υπόψη Κού Σαβαΐδη Γεωργίου
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την
εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την πρώτη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού ακριβείας» (συν 5042100-2) – Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών Ε. Για τη συντήρηση Εννέα (9) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.050 € με ΦΠΑ,

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει

να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

«E) Για τη συντήρηση Εννέα (9) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.050 € με ΦΠΑ.»

1.Όρος « Να κατατεθεί βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα.

Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλπει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω όρος περί προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχε, με αυτή τη μορφή, σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ειδικότερα, στην τελευταία διακήρυξη με αριθμ. 94/2014 αναγραφόταν ότι:

«Να καταθέσει βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας»
δινόταν έτσι η δυνατότητα στην εταιρεία μας να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και να εγκριθεί η τεχνική μας προσφορά από την επιτροπή του διαγωνισμού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, παρόλη την έλλειψη πιστοποιητικών εκπαίδευσης για τα μηχανήματα AK-200 ULTRA, αφού καταθέσαμε πιστοποιητικά εκπαίδευσης παρόμοιων μηχανημάτων του ίδιου οίκου κατασκευής (AK-200S), πετυχαίνοντας έτσι το νοσοκομείο για πρώτη φορά ανάπτυξη ανταγωνισμού και συμμετοχή μεγαλύτερη του ενός συντηρητή, πέραν αυτή του επί πολλών ετών μονοπωλιακού και κεκαλυμμένου απευθείας αναδόχου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με

τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας , έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.»

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία μας παρά την έλλειψη των πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή οίκο, δραστηριοποιείται επιτυχώς στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα από το 1976, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών αλλά και πολύ πιο οικονομικότερων για το συμφέρον των νοσοκομείων και για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ εν γένει, Τιμών . Οράτε Σχετ. 2 Σύμβαση υπ' αριθμ. 8992/23-04-15, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (20 μηχανήματα τύπου AK-200S και 9 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 158 € το μηχανήμα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήμα το μήνα που πλήρωνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ

Ομοίως οράτε Σχετ. 3 Σύμβαση υπ' αριθμ. πρωτ. 8748, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ, Κόμης με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (5 μηχανήματα τύπου AK-200S και 2 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 169,98 € το μηχανήμα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήμα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Ομοίως οράτε Σχετ. 4 Σύμβαση υπ' αριθμ. 1/1-8/2014, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιππών με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (10 μηχανήματα τύπου AK-200S και 1 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τιμή των 172 € το μηχανήματα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήματα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Επίσης οράτε Σχετ. 5 Σύμβαση υπ' αριθμ. 9075, που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (7 μηχανήματα τύπου AK-200S και 4 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στην τελική τιμή των 160,00 € το μηχανήματα το μήνα και όχι στην τιμή των 230 € το μηχανήματα το μήνα που πληρώνει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Στην τελευταία διακήρυξη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με αριθμ. 94/2014, στον εν λόγω όρο υπήρχε η φράση : ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης του ενός συντηρητή συμμετοχής και της πραγματικής ανάπτυξης ανταγωνισμού . Στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και από τον συγκεκριμένο όρο αφαιρέθηκε αυτή η φράση . Ευλόγως , κάθε νοήμων άνθρωπος , θα απορούσε για την σκοπιμότητα της αλλαγής αυτού του όρου :

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει ευρεία συμμετοχή και ανάπτυξη ανταγωνισμού στη συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO ;

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει ποιοτικότερες υπηρεσίες συντήρησης ;

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλει οικονομικότερες τιμές και εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ ;

Η μήπως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο , με πρόσχημα δήθεν την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας του συντηρητή , θέλει με πάση θυσία την διατήρηση της

πολύχρονης παράνομης μονοπωλιακής συνεργασίας, με τον περιούσιο συντηρητή , ανεξαρτήτου ποιότητας και κόστους ;

Υπογραμμίζοντας δε ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων , όλων των ετών συνεργασίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με τον επί πολλά χρόνια περιούσιο συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. , πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι , πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθετε ο εν λόγω περιούσιος συντηρητής.

2.Όρος «Να καταθέσει βεβαίωση από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών, που θα φέρουν πιστοποίηση CE, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης»

Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και εννοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός εννοεί

και υποθάλπει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι εννοούν και υποθάλπουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ. 6), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε

ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσκορδύει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαίωσης που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαμεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όλως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις των Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχ. 7) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχ. 8), του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχ. 1) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία).

Τα Νοσοκομεία που θέλησαν πραγματικά και όχι προσχηματικά να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής συντηρητών πέτυχαν και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολύ οικονομικότερες τιμές :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ	158,00 €	29 Μ.Τ.Ν.	20 MTN AK-200S & 9 MTN AK-200 ULTRA S
2.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	172,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S & 1 AK-200 ULTRA S
3.	ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ	165,00 €	2 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S
4.	Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	165,00 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S, 2 MTN AK-200 2 MTN AK-95S
5.	Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-200S, 6 MTN AK-200 & 1 MTN AK-95

6.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ	195,00 €	10 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S
7.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	178,95 €	7 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S
8.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	160,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S & 4 AK-200 ULTRA S
9.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	162,50 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-95, 3 MTN AK-95S & 1 MTN AK-200S
10.	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	189,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	6 MTN AK-200, 2 MTN AK-95 & 1 MTN AK-200S
11.	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	166,67 €	13 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95, 1 MTN AK-200, & 8 MTN AK-200S
12.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	176,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-10, 1 MTN AK- 100, 2 MTN AK-200, 4 MTN AK-200S & 1 MTN AK-200SU
13.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – Κ.Υ. ΔΗΜΝΟΥ	177,78 €	7 Μ.Τ.Ν.	3 MTN AK-10, 1 MTN AK-95 & 3 MTN AK-200S
14.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	160,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95S

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

[...]

Τέλος, εφόσον η παρούσα διαβούλευση δεν είναι προσχηματική και υπάρχει πραγματική βούληση – πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και της μέγιστης δυνατής ανάπτυξης ανταγωνισμού,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι, για πρώτη φορά:

- το σταμάτημα των ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

[...] »

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ : 3212/20-8-2015)

«Αθήνα, 06 Ιουλίου 2015

- ΠΡΟΣ:**
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ &
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κος Γεώργιος Βλάχος
 - Τμήμα Οικονομικού /
Κα Δέσποινα Λαυρέντζου – Κα Ρ. Φραγκιαδουλάκη
 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: Πρόεδρον / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
 - Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ' αριθμ. 9020/30-6-2015

Α. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές Ν.Μ. Αγγινίου(των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO) – Ν.Μ. Μεσολογγίου

1. Όρος «Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία».

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για το κάθε Νοσοκομείο. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η **ευθύνη του κατασκευαστή** να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. Τούτο, δε, οφείλει να πράττει **απαρέγκλιτα ο κατασκευαστής**, προκειμένου να διατίθεται νομίμως το ιατροτεχνολογικό του προϊόν (μηχάνημα) εντός της ΕΕ. Γι' αυτό ακριβώς σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, μετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται ή διακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE, δεικνύοντας τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη τη σήμανση CE και, συνεπώς, την εξασφάλιση ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτό ισχύει επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σήμανση CE προορίζεται για την εθνική εποπτεία της αγοράς και των αρχών επιβολής του νόμου, ως ένδειξη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση λοιπόν η υποχρέωση αυτή του κατασκευαστή μηχανημάτων απέναντι στον χρήστη, να φροντίζει για την αναβάθμιση των μηχανημάτων και να παρέχει προς τούτο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί

(μέσω της τυχόν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του συγκεκριμένου όρου) σε δυνατότητα του κατασκευαστή να δίδει ή όχι τις αναγκαίες πληροφορίες.

Αλλά ούτε και θα μπορούσε ο προαναφερόμενος όρος να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί με τρόπο που θα υπέθαλπε και θα νομιμοποιούσε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζει έναντι της εταιρείας μας ο οίκος Gambro, ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2012 μας έχει στερήσει παράνομα και καταχρηστικά την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες. Σημειωτέον ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές γι' αυτό στην Ελληνική Δικαιοσύνη και καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όπως δικαιωθήκαμε για το παράνομο αθέμιτο και αντι ανταγωνιστικό μοϊκοτάζ στην προμήθεια ανταλλακτικών, που μας επέβαλαν για δύο και πλέον χρόνια, είμαστε βέβαιοι ότι έτσι θα δικαιωθούμε και για το θέμα της τεχνολογίας.

Πλέον τούτων, τονίζουμε με έμφαση ότι υπάρχουν Δημόσια Νοσοκομεία με οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, που αναλαμβάνουν από μόνα τους τις συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων τους και για τα οποία δεν προέκυψε ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την οποιαδήποτε αναβάθμιση, ακριβώς επειδή είναι υποχρέωση του κατασκευαστή να τις παρέχει χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, στη σύμβαση προμήθειας με αριθμό 4567/2003 του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια 121 Μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro τύπου AK-95S ΚΑΙ AK-200S, σε 24 δημόσια νοσοκομεία, από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αναφέρεται στη σελίδα 10 όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικών ότι «Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των τεχνικών των Νοσ/μείων για τα οποία προορίζονται τα μηχ/τα, στην έδρα της Εταιρείας (Αθήνα) ή στην έδρα της GAMBRO στη Lund Σουηδίας (μόνον για Αγγλομαθείς) και με πλήρη εκπαίδευση για το 100% των βλαβών, όπως αναφέρεται στην τεχνική στήριξη και με δικά μας έξοδα» (Σχετ. 1).

Ακολούθως, στη σελίδα 26 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ως επιλογή τεχνικής στήριξης για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και αυτόνομο service στα Νοσοκομεία ως συμφέρουσα λύση και εκπαίδευση των τεχνικών με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι ηλεκτρονικοί.

β. Να έχουν ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.

γ. Να αναλάβουν την υποχρέωση να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις των και τις πληροφορίες μας εκτός Νοσοκομείου και για δύο χρόνια μετά την διακοπή της συνεργασίας των με το Νοσοκομείο.

2. Όρος (Ετήσιας συντήρησης των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO της N.M. Αγγινίου(σελίδα 25) – τεχνικές προδιαγραφές N.M. Μεσολογγίου (α/α:12 σελίδα 28)) «Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία των μηχανημάτων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους στα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας ή εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος».

2.1 Ο όρος αυτός κατά το σκέλος του που απαιτεί συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία για την προμήθεια ανταλλακτικών και την ύπαρξη σχετικού πιστοποιητικού συνεργασίας, υποθάλλει και εννοεί επίσης την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, ανάγοντας τον κατασκευαστή καθώς και τον αντιπρόσωπό του σε μοναδική πηγή προμήθειας ανταλλακτικών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού που ο κατασκευαστής παράγει με αποτέλεσμα την στεγανοποίηση της σχετικής αγοράς κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθΣΛΕΕ. Συνιστά, δε, και ποσοτικό περιορισμό στις εισαγωγές, άλλως μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό, καθώς αποκλείει την εισαγωγή γνήσιων ανταλλακτικών από άλλη χώρα πλην της χώρας όπου εδρεύει ο κατασκευαστής ή αυτός από την χώρα που αυτός θα επιλέξει, κατά παράβαση του άρθρου 34 της ΣυνθΣΛΕΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω όρος υποχρεώνει, εμμέσως πλην σαφώς, τον υποψήφιο συντηρητή να προμηθεύεται ανταλλακτικά από συγκεκριμένη πηγή προμήθειας, ήτοι αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από την επιχείρηση που ο ίδιος ο κατασκευαστής θα υποδείξει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών από ανεξάρτητους μεταπωλητές και η δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του συντηρητή για την πλέον συμφέρουσα πηγή προμήθειας ανταλλακτικών. Συνεπώς ο όρος αυτός εννοεί και υποθάλλει περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και παρεμποδίζει την δυνατότητα του παράλληλου εμπορίου, καθώς επιτρέπει στον κατασκευαστή που κατέχει δεσπόζουσα θέση, μονομερώς αλλά και σε συνεργασία με τον αποκλειστικό

αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, να ελέγχει την συγκεκριμένη αγορά και να παρεμποδίζει την είσοδο και παραμονή στην εν λόγω αγορά σε τρίτες επιχειρήσεις, που είναι μεν πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, όπως και η εταιρεία μας, αλλά επιθυμούν να διατηρούν το δικαίωμα επιλογής της πλέον συμφέρουσας πηγής προμήθειας ανταλλακτικών και όχι αναγκαστικά αυτής που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Τέτοιοι όροι εννοούν και υποθάλλουν αντι-ανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές αντίστοιχες με αυτές που αντιμετώπισε η εταιρεία μας επί τριετία από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro και την αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα Medical Products, οι οποίοι αρνούνταν να μας χορηγήσουν τις απαιτούμενες από τις διακηρύξεις βεβαιώσεις περί απρόσκοπτης παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από τους εν λόγω διαγωνισμούς. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι πρακτικές αυτές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αντι-ανταγωνιστικές και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απόσπασμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή (Σχετ.2), που μεταξύ άλλων:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπράξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Επιπλέον ο όρος αυτός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο επιδιωκόμενος σκοπός γενικού συμφέροντος (ήτοι αυτός της απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου) θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά με λιγότερο περιοριστικούς όρους και χωρίς να περιορίζεται δυσανάλογα η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων συντηρητών. Πρέπει να δίνεται η εναλλακτική δυνατότητα και ευελιξία στον υποψήφιο συντηρητή να αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του νοσοκομείου με ανταλλακτικά, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον προμηθευτή που ο ίδιος θα έχει επιλέξει, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης (μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης) ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών.

Συνεπώς για τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος. Θα μπορούσε, δε, να διατυπωθεί διαφορετικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικής πηγής προμήθειας ανταλλακτικών ή η δυνατότητα απόδειξης απρόσκοπτης προμήθειας ανταλλακτικών με άλλα μέσα, όπως μεταξύ άλλων εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του να προμηθεύουν ακώλυτα τις επιχειρήσεις με ανταλλακτικά και οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές από την Διοίκηση (υπερτερούν, μάλιστα, σε δεσμευτικότητα και εγκυρότητα από το χαρτί μιας απλής βεβαίωσης που δύναται να το φέρει όποιος διαθέτει συμβατικό δεσμό με τον κατασκευαστικό οίκο...).

2.2 *Η καταρχήν εύλογη απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης από καταρτισμένους τεχνικούς προσδιορίζεται εν συνεχεία από το Νοσοκομείο απολύτως περιοριστικά, με την υπόδειξη προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τούτο, όμως, προϋποθέτει συμβατική σχέση του υποψήφιου συντηρητή με τον*

κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος δίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά αποκλειστικά σε μέλη του δικτύου του, πριμοδοτώντας κατ' αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Νοσοκομείο τον συντηρητή της αρεσκείας του και αποκλείοντας έτσι μη μέλη του δικτύου με εξίσου ή και πληρέστερη (όπως εν προκειμένω) τεχνική επάρκεια.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση εταιρείας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή εγγράφων αποκλειστικά από κατασκευαστικούς οίκους.

Κατά συνέπεια, οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλλει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας και στους τεχνικούς μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζουμε στο Νοσοκομείο ότι οι ως άνω όροι περί πιστοποιητικού συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο για την προμήθεια ανταλλακτικών, καθώς και περί προσκόμισης πιστοποιητικών εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο δεν υπήρχαν σε παλαιότερες προκηρύξεις διαγωνισμών των νοσοκομείων σας. Ειδικότερα, στην πρόσκληση με αριθμ. Πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 3) της Ν.Μ. Μεσολογγίου αναγραφόταν ότι:

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη μονάδα τεχνητού νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς.

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Όμοιους όρους είχε και η προγενέστερη πρόσκληση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου με αρ. πρωτ. 11898/17-11-2014. (Σχετ. 4).

Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές στη Ν.Μ. Μεσολογγίου

3. Όρος : «Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των μηχανημάτων ή να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού».

Ο εν λόγω όρος στο βαθμό που απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο περιορίζει τον ανταγωνισμό, καθώς προϋποθέτει συμβατική σχέση μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρίας και του αναδόχου συντηρητή, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο νόμιμο στόχο, ήτοι για την πιστοποίηση της πραγματικής δυνατότητας του αναδόχου συντηρητή για συντήρηση και επισκευή των σχετικών ιατρικών μηχανημάτων. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρίας με την κατασκευάστρια εταιρία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει

εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους. Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από άλλα νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 5) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα ΑΚ 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης ΑΚ 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας

Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 11898/17-11-2014 (Σχετ. 3) και αρ.πρωτ. 2860/20-3-2015 (Σχετ. 4) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε ο ως άνω όρος των τεχνικών προδιαγραφών να διαμορφωθεί ανάλογα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον εκάστοτε ανάδοχο συντηρητή να αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια μέσω σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να μην εξαρτάται η απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον κατασκευαστή.

Θεωρούμε ότι ουδέν έχει να προσφέρει ο εν λόγω όρος, καθώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις καλύπτονται πλήρως από τους έτερους όρους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να προσκομίζεται:

«Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ. /1348/2004 σχετικά με την ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

«Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη Διακίνηση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ εξοπλισμού».

«Να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις καλής συνεργασίας και εκτέλεσης των συμβάσεων συντήρησης με αντίστοιχα ιδρύματα».

Συνεπώς προτείνουμε την πλήρη απόλεια του εν λόγω όρου από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Γ. Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι οι όροι που τίθενται στο κείμενο της διαβουλεύσεως διαψεύδουν την υποτιθέμενη πρόθεση για επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών και καταλήγει σε κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση με το πρόσχημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Προς επιπλέον επίρρωση όλων των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε όλως ενδεικτικώς τις διακηρύξεις δύο Δημόσιων Νοσοκομείων, του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» (Σχετ. 6) και του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 7), καθώς και του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Σχετ. 5), όπως και τις δύο τελευταίες διακηρύξεις της Ν.Μ. Μεσολογγίου 2860 (Σχετ. 3) και 11898 (Σχετ. 4) στις οποίες δεν υφίστανται τα αδικαιολόγητα εμπόδια που το Νοσοκομείο σας ορθώνει στον ανταγωνισμό.

Τα προς χάριν παραδείγματος προαναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία, όχι μόνο διαμόρφωσαν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς (μέσω δημόσιας διαβούλευσης) με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και ήδη δρέπουν τους καρπούς των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών τους (συμμετείχαν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι και κατακροτώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με τη χαμηλότερη προσφορά, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με εξοικονόμηση δαπανών για τα Νοσοκομεία). Σας επισυνάπτουμε το πρακτικό του Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Σχετ. 8) όπου έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Ομοίως τους καρπούς της ανάπτυξης του ανταγωνισμού έδρεψε το Νοσοκομείο σας σε όλες τις προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες κερδίζοντας οικονομικότερες αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες, οράτε ενδεικτικά το διαγωνισμό του Νοσοκομείου

Αγρινίου με την υπ' αριθμό 17200/31-10-2014 & ΑΔΑ 756Π46904Μ-ΨΒ6 ανάρτηση του Νοσοκομείου σας, για την Τρίμηνη Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης Gambro για το χρονικό διάστημα τριών μηνών, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας υποβάλλοντας την προσφορά της, καθώς και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ. Η προσφορά της εταιρείας μας (ΣΕΡ.ΚΟ) ανερχόταν στα 2.898,00 € χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ανερχόταν στο ποσό των 3.699,00 € χωρίς ΦΠΑ δηλαδή διαφορά – όφελος για το Νοσοκομείο από την ανάπτυξη ανταγωνισμού: 801,00 € για τους τρεις μήνες και 3204,00 € αναγόμενο σε ετήσια βάση .

Και αντίστοιχα το διαγωνισμό της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11898/17-11-2014 και ΑΔΑ: ΨΨΑΑ46907Π-ΥΕΔ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, για την επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού για το χρονικό διάστημα δύο μηνών, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας υποβάλλοντας την προσφορά της, καθώς και η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ. Η προσφορά της εταιρείας μας (ΣΕΡ.ΚΟ) ανερχόταν στα 1.638,00 € χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ ανερχόταν στο ποσό των 2.160,00 € χωρίς ΦΠΑ δηλαδή διαφορά – όφελος για το Νοσοκομείο από την ανάπτυξη ανταγωνισμού: 522,00 € για τους δύο μήνες και 3.132,00 € αναγόμενο σε ετήσια βάση.

Το Νοσοκομείο σας γνωρίζει άριστα τις πολύ ποιοτικές και οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες που προσφέρει όλα τα χρόνια η εταιρεία μας ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ από την πολυετή συνεργασία του μαζί μας από το 1986 μέχρι και σήμερα .

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

[...]»

Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (ΘΕΜΑ 1^ο) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

Ε1. ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ

Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε κάποιος καλόπιστα να δεχθεί ότι η παραπάνω απόφαση (65/17-07-2015/21-07-2015 θέμα 1^ο) στοχεύει στο να σταματήσουν οι τεχνικές προδιαγραφές να αποτελούν «εμπορεύσιμο προϊόν» από τους αρμόδιους των νοσοκομείων, δηλαδή να πάψουν οι τεχνικές προδιαγραφές να είναι «προϊόν συναλλαγής» μεταξύ των αρμοδίων των Νοσοκομείων και των περιούσιων συντηρητών – προμηθευτών.

Με μια δεύτερη ματιά όμως, διαψεύδεται αμέσως η υποτιθέμενη ως άνω πρόθεση της ΕΠΥ, από τη στιγμή που οι αρμόδιοι των Νοσοκομείων συνεχίζουν να έχουν όλη την ευχέρεια να δέχονται όποιες τεχνικές προδιαγραφές (από αυτές που καταθέτουν οι προμηθευτές με βάση την απόφαση της ΕΠΥ) αυτοί θέλουν. Έτσι αποτέλεσμα της απόφασης της ΕΠΥ είναι να καταλήγει να αποτελεί απλώς την αποενοχοποίηση και κοινώς το «συχωροχάρτι» των αρμοδίων εκείνων των Νοσοκομείων που πιθανόν εμπορεύονταν και πιθανόν θα συνεχίσουν να εμπορεύονται τις τεχνικές προδιαγραφές. Διότι τώρα θα υπάρχει άλλοθι.

«ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ»

Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν τέθηκαν από κανέναν αρμόδιο του Νοσοκομείου (έναντι πιθανής αμοιβής από κάποιους περιούσιους συντηρητές) αλλά τέθηκαν από τους ίδιους τους περιούσιους συντηρητές – προμηθευτές βάσει της απόφασης της ΕΠΥ. Και επειδή όμως παραμένει στην ευχέρεια των αρμοδίων, θα δέχονται μόνο τις προδιαγραφές των περιούσιων συντηρητών – προμηθευτών και κανενός άλλου τυχάρπαστου τίμιου και ρομαντικού συντηρητή – προμηθευτή ο οποίος δρα και προσπαθεί να επιβιώσει νόμιμα πέρα και μακριά από τις παράνομες μεν αλλά προσοδοφόρες δε πρακτικές των ΚΑΡΤΕΛ και των ΑΠΙΣΤΩΝ αρμοδίων υπαλλήλων των Νοσοκομείων.

Ε.2 Το Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

2.1 Το Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. με την Διακήρυξη 05/2012 και αριθμ. πρωτ. 589/9-3-2012 προκήρυξε τον τελευταίο διαγωνισμό για τη συντήρηση των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro.

Οι προδιαγραφές στη διακήρυξη αυτή είχαν ως εξής:

«Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘ

- 1. Η συντήρηση αφορά τα (5) μηχανήματα CAMBRO AK 90-S και τα (3) μηχανήματα CAMBRO AK 10 και AK 200 του τεχνητού νεφρού και της ΜΕΘ*
- 2. Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί (4) συντηρήσεις ετησίως (μία ανά τρίμηνο) με ανάλογες και διαφορετικές ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων, αν αυτό απαιτείται.*
- 3. Ο συντηρητής υποχρεούται να καλύπτει πλήρως έκτακτες βλάβες στα μηχανήματα τεχνητού Νεφρού και ΜΕΘ, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών, μετά*

από τηλεφωνική κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θα κρατείται δε από την Μονάδα τεχνητού νεφρού εφεδρικό νεφρολογικό μηχάνημα και σε ποσοστά που ορίζει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για να αντιμετωπίζεται βλάβη διάρκειας είτε εντός του Νοσοκομείου είτε στο εργαστήριο του συντηρητή .

4. Η αξία των ανταλλακτικών που θα αντικαθίστανται κατά την διάρκεια των επισκευών ή συντηρήσεων θα βαρύνουν τον συντηρητή.

5. Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προκύπτουν, από αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή τρίτους , από χρήση ακατάλληλων υλικών αποστείρωσης, καθαρισμό απασβέστωσης ή ελλιπή χρήση απασβέστωσης ή καθαρισμού πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου, από κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου, από κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περ/δων του Νοσοκομείου ή της Δ.Ε.Η., από εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους, από ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός, θύελλες, πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά) και από κτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους. (Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται μετά από αναφορά του συντηρητή και επιβεβαίωση από την Βιοϊατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου) .

6. Ο συντηρητής επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποκαταστήσει κάποια βλάβη επί τόπου στο Νοσοκομείο και χρειαστεί να μεταφέρει το προς επισκευή μηχάνημα στην εταιρεία του και κατόπιν πίσω στο Νοσοκομείο.

7. Η τιμή θα δοθεί ως μηνιαία δαπάνη ανά μηχάνημα. (Σημειώνεται ότι εάν κάποιο από τα μηχανήματα τεθεί εκτός οριστικής λειτουργίας, θα σταματάει αυτόματα η συντήρηση και η αντίστοιχη χρέωση αμοιβής). Τα ανταλλακτικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν θα συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω δαπάνη» (σελ. 41 – 42 Διακήρυξης).

Η εταιρεία μας δεν συμμετείχε σ' αυτόν τον διαγωνισμό λόγω του παράνομου μποϊκοτάζ ανταλλακτικών που βιώναμε τότε. Καθώς η δικαίωση μας από την Ελληνική Δικαιοσύνη ήρθε πολύ αργότερα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5667/2013.

Έτσι το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, πέτυχε την παράνομη μονοπώληση της συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο σας και σύναψε

τη σύμβαση με αριθμ. 05/2012 και αρ. πρωτ. 31471/12-4-2013 με συνολική ετήσια τιμή 15.480,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για 6 μηχανήματα Gambro. Δηλαδή τιμή 215,00€ ανά μηχανήμα ανά μήνα.

Η σύμβαση αυτή μέσω παρατάσεων είναι ενεργή μέχρι σήμερα, στις ίδιες ακριβώς τιμές (215,00 € το μηχανήμα το μήνα).

Όταν η ανάπτυξη του ανταγωνισμού από την συμμετοχή της εταιρείας μας στους διαγωνισμούς της συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro έχει φέρει τεράστια οφέλη στα νοσοκομεία της χώρας τα οποία καρπώνονται πολύ χαμηλότερες τιμές.

Ενδεικτικά σας κοινοποιούμε συμβάσεις συντήρησης που έχει συνάψει πρόσφατα η εταιρεία μας με Δημόσια Νοσοκομεία Αθηνών, τα οποία ακολούθησαν τη Νόμιμη οδό ανάπτυξης ανταγωνισμού μακριά από την υποστήριξη του εν λόγω ΚΑΡΤΕΛ κερδίζοντας τόσο ποιοτικότερες, όσο και οικονομικότερες τιμές:

1. Ετήσια σύμβαση της 15/4/2015 με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με μέση τιμή 176,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (**Σχετ. 10**).
2. Ετήσια σύμβαση της 09/04/2015 με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με μέση τιμή 162,50 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (**Σχετ. 11**).
3. Ετήσια σύμβαση της 29/12/2014 με το ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με τιμή 165,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (**Σχετ. 12**).
4. Ετήσια σύμβαση της 27/02/2015 με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ, ΑΦΟΡΑ Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ με τιμή 168,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (**Σχετ. 13**).
5. Ετήσια σύμβαση της 30/01/2015 με το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ με μέση τιμή 166,67 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι

215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας(Σχετ. 14).

6. Τρίμηνη σύμβαση της 02/10/2015 με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ με μέση τιμή 158,98 € ανά μηχανήμα ανά μήνα και όχι 215,00 € ανά μηχανήμα ανά μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο σας (Σχετ. 15).

2.2 Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού του 2012, διακήρυξη 05/2012, όπως τις αναφέραμε και ανωτέρω, ήταν απόλυτα αποδεκτές από το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, διότι μέσω του παράνομου μπουκοτάζ ανταλλακτικών που είχαν επιβάλει στην εταιρεία μας είχαν εξασφαλισμένη την παράνομη μονοπωλιακή τους δράση.

Μετά όμως την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5667/2013 αναπροσαρμόζουν τις παράνομες πρακτικές τους και προσπαθούν να επιβάλουν στα νοσοκομεία όρους που θα τους εξασφαλίσουν την συνέχιση της παράνομης μονοπωλιακής τους δράσης.

Τελευταία μάλιστα φθάνουν στο σημείο να απαιτούν παράνομα από τα νοσοκομεία να μην κάνουν καν Διαγωνισμούς και να χαρίζουν τις συντηρήσεις στο ΚΑΡΤΕΛ τους με απευθείας αναθέσεις ανεξαρτήτως τιμής και ποιότητας των υπηρεσιών τους(!!!).

3. Μικρές αλήθειες μεγάλα συμπεράσματα:

Προς αντίκρουση κάθε δύσπιστου αρμόδιου παραθέτουμε και τα ακόλουθα σχετικά με την «εξουσιοδότηση» και γενικότερα τις βεβαιώσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία:

3.1 Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 η κατασκευάστρια εταιρεία Gambro Lundia AB στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπου η εταιρεία μας κατέφυγε για τη δικαίωση της:

Στις 13/2/2012 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«25.3 Ο μάρτυς της αιτούσας κατέθεσε ότι και μετά την καταγγελία της σύμβασης υπερβολαβίας της με την 2^η καθ' ης, η αιτούσα εξακολούθησε να μετέχει σε διαγωνισμούς Νοσοκομείων για τη συντήρηση και συνήψε πράγματι, όπως λέει, νέες τέτοιες συμβάσεις, που σημαίνει ότι και ανταλλακτικά έχει και βεβαιώσεις από εμάς δεν χρειάζεται αφού την επάρκειά της την γνωρίζουν ήδη τα Νοσοκομεία.»

Στις 19/8/2011 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών :

«Με αυτό το δεδομένο, η αιτούσα είχε (και έχει) απόλυτη ελευθερία να συντηρεί εκτός από τα προϊόντα της GAMBRO και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ακόμα και ανταγωνιστικά».

Ιδού τι αναφέρουν τα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια χρήσης της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρείας Gambro Lundia AB:

«Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός είναι ένας τεχνικός που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96 από τη Gambro και διαθέτει πιστοποίηση από τη Gambro ή έχει αποκτήσει ισάξια εμπειρία με παρόμοιο τρόπο.

(ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96, Σχετ. 16).

Για τον εκπαιδευόμενο τεχνικό διατίθεται το Εγχειρίδιο Σέρβις AK 200. Το Εγχειρίδιο Σέρβις παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος.

Οι προληπτικές επιθεωρήσεις, συντήρηση και βαθμονόμηση του AK 200 θα γίνονται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Σέρβις του AK 200, το Εγχειρίδιο Συντήρησης HCEN9164 τα οποία μπορούν να παραγγελθούν από τον αντιπρόσωπό σας της Gambro. Η περιοδική συντήρηση πρέπει να γίνεται μετά από 2500 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον ανά έτος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200 ορ.man. HCEL9761.Rev.12.1999 program verison 4.xx σελ. 1:3 και 1:4, Σχετ. 17).

Για τον έμπειρο τεχνικό, υπάρχει διαθέσιμο το Εγχειρίδιο Επισκευής του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S. Το Εγχειρίδιο Επισκευής παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8, Σχετ. 18).

Επάρκεια Μηχανικών Service

Υπάρχει ένα ορισμένο ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για τους Μηχανικούς service που συντηρούν και επισκευάζουν προϊόντα Gambro, και συνοψίζεται ως εξής.

Ένας μηχανικός συντήρησης θεωρείται κατάλληλα ειδικευμένος, αν αυτός / αυτή έχει:

1. Παρακολουθήσει τεχνικό σεμινάριο για AK 200 S / AK 200 ULTRA S και του έχει δοθεί ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο τεχνικός έχει περάσει το μάθημα.
2. Πρόσβαση στο συνιστώμενο εξοπλισμό δοκιμών και τα ειδικά εργαλεία που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο service.
3. Πρόσβαση στα συνιστώμενα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στο AK 200S / AK 200 ULTRA S – Spare Parts List, HCEN 9288.
4. Πρόσβαση και κατανόηση στο εγχειρίδιο Χρήσης AK 200 S / AK 200 ULTRA S- (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο συντήρησης HCEN12395 Revision 02.2010 program version 10.xx σελ. 1:5, νομίμως μεταφρασμένη (Σχετ. 19).

Η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία έχοντας πλήρη επίγνωση των θεμάτων, δεν παίρνει κανένα ρίσκο και προσέχει πολύ σχετικά με τα ποινικώς κολάσιμα αδικήματα, αφού ούτως ή άλλως, υπάρχουν υποψήφιοι «αρμόδιοι» των Νοσοκομείων που μπορούν να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά», θέτοντας παράνομους όρους στους διαγωνισμούς κι έτσι δεν χρειάζεται να παρανομήσει η ίδια.

4. Κατακλείδα

Ενώ τα Νοσοκομεία που θέλησαν πραγματικά και όχι προσχηματικά να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής συντηρητών, διαμορφώνοντας διαφανείς και χωρίς διακρίσεις, τεχνικές προδιαγραφές με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον, πέτυχαν και απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολύ οικονομικότερες τιμές :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ	158,00 €	29 Μ.Τ.Ν.	20 MTN AK-200S & 9 MTN AK-200 ULTRA S
2.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	172,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S & 1 AK-200 ULTRA S
3.	ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ	165,00 €	2 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S

4.	Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	165,00 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-200S, 2 MTN AK-200 2 MTN AK-95S
5.	Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	170,00 €	11 Μ.Τ.Ν	4 MTN AK-200S, 6 MTN AK-200 & 1 MTN AK-95
6.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ	195,00 €	10 Μ.Τ.Ν.	10 MTN AK-200S
7.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	178,95 €	7 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S
8.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	160,00 €	11 Μ.Τ.Ν.	7 MTN AK-200S & 4 AK-200 ULTRA S
9.	Γ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	162,50 €	6 Μ.Τ.Ν.	2 MTN AK-95, 3 MTN AK-95S & 1 MTN AK-200S
10.	Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ	189,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	6 MTN AK-200, 2 MTN AK-95 & 1 MTN AK-200S
11.	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	166,67 €	13 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95, 1 MTN AK-200, & 8 MTN AK-200S
12.	Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ	176,00 €	9 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-10, 1 MTN AK- 100, 2 MTN AK-200, 4 MTN AK-200S & 1 MTN AK-200SU
13.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ	177,78 €	7 Μ.Τ.Ν.	3 MTN AK-10, 1 MTN AK-95 & 3 MTN AK-200S
14.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	160,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-95S
15.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ	168,00 €	4 Μ.Τ.Ν.	4 MTN AK-200S-
16.	Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ	158,98 €	11 Μ.Τ.Ν.	1 MTN AK-200 ULTRA, 6 MTN AK-200, 3 MTN AK-200S & 1 MTN AK-95
17.	251 Γ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	166,67 €	6 Μ.Τ.Ν.	5 MTN AK-200 & 1 MTN AK-90S

«ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ» του Νοσοκομείου Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.:

- Θα προτιμήσουν να συντηρεί τα μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού Gambro μόνο ο περιούσιος συντηρητής σε τιμή 215,00 € το μηχάνημα το μήνα και όχι με 165,00 € περίπου το μηχάνημα το μήνα που προσφέρει η ΣΕΡ.ΚΟ;
- Θα προτιμήσουν να πετούν πολλές χιλιάδες ευρώ, τα χρήματα του ελληνικού λαού, ωσάν το Νοσοκομείο Κοργιαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.: να είναι τσιφλίκι τους, προκειμένου να συνεχίσει να κερδοσκοπεί παράνομα το ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ;

Επειδή η εταιρεία μας, όπως έχει διαπιστώσει και υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βιώνει τις σκληρές πρακτικές ενός αδίστακτου καρτέλ που επιδιώκει τη μονοπώληση των δημόσιων διαγωνισμών επί μεγίστη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Επειδή οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες των υπό ανάθεση συμβάσεων και πρέπει να δρουν υπέρ του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες με περισσότερο από 30% χαμηλότερες τιμές.

Επειδή οι δημόσιες συμβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί απαγορεύεται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία να αποτελούν απευθείας ανάθεση, αλλά αντιθέτως πρέπει να σέβονται κατά τις διεξαγόμενες διαδικασίες τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Επειδή τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι τσιφλίκι κανενός, δεν πρέπει να πετούν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού προκειμένου να υποστηρίξουν το ΚΑΡΤΕΛ της Medical, της Τεχνοϊατρική και της Gambro.

Επειδή, για να γίνει περισσότερο αντιληπτό, το μέγεθος του πλιάτσικου από το συγκεκριμένο ΚΑΡΤΕΛ, σας γνωστοποιούμε ενδεικτικά πόσο πωλούνται αντίστοιχα, σε άλλες χώρες, τα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO:

K40280001 AC/DC UNIT AK200S:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 350,00€ ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 2.069,65 €.

K11845A Level Transducer:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 36,00 € ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 246,72 €.

K40228003 Pressure transducer kit compl.:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 112,00 € ενώ η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ το πουλάει 715,48 €.

Ανταλλακτικό που άλλες χώρες το αγοράζουν 112 € στην Ελλάδα πουλιέται από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ 715,48 €. Το ίδιο πράττει η Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και με τις τιμές των αναλωσίμων τεχνητού νεφρού,

Έτσι το Φίλτρο Τεχνητού Νεφρού που το κόστος του δεν υπερβαίνει το 1 € και άλλες χώρες το αγοράζουν 6 - 8 € στην Ελλάδα σήμερα πουλιέται 28 € και παλιότερα 50 €.

Με βάση δημοσιεύματα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο της περιόδου Ιουλίου 2014 σχετικά με έρευνα του εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Κου Δημόπουλου :

«Σύμφωνα με την καταγγελία, τα φίλτρα αιμοκάθαρσης στα ελληνικά νοσοκομεία πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονται από 23 έως 30 ευρώ, όταν την περίοδο αυτή στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπερβαίνουν τα 15 ευρώ. Παλιότερα δε, οι τιμές τους είχαν εκτοξευτεί στα 50 ευρώ το ένα, παρότι το κόστος παρασκευής των υλικών αυτών υπολογίζεται ότι μετά βίας να ξεπερνούσε το 1 ευρώ!!

Ο κ. Εισαγγελέας, ζητά να εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου από την πλευρά των ιδρυμάτων, αλλά και τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και το ενδεχόμενο να έχει τελεστεί το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Δεν αποκλείεται παράλληλα να γίνουν έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων, καθώς οι καταγγέλλουσες πηγές ανέφεραν ότι υποστηρίζουν πως από τις συγκεκριμένες προμήθειες μέλη νοσοκομείων “εισπράττουν ποσοστά”», αναφέρεται σε σχετικό επίσημο ερώτημα αρ. πρωτ. 1200/17-7-2014 των βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη προς τον υπουργό υγείας.

Για το καρτέλ στο χώρο του Τεχνητού Νεφρού, έχει μιλήσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας Κος Α. Σαμαράς από το βήμα της Βουλής στις 12/11/2012: *«Τα Ελληνικά νοσοκομεία αγόραζαν ως πρόσφατα τα φίλτρα για τις μονάδες τεχνητού νεφρού προς 35 ευρώ το ένα. Την ίδια στιγμή στην Κύπρο και σε άλλες χώρες τα ίδια φίλτρα έκαναν προς 8 ευρώ το ένα! ... Αυτό πια κόβεται με το μαχαίρι...».*

"Σύμφωνα με την καταγγελία, όλες οι προμηθεύτριες εταιρίες συμφώνησαν να διαθέτουν τα υλικά, στην ίδια υψηλή τιμή και συνέστησαν offshore εταιρία, με τη συμμετοχή γιατρών από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και την Αθήνα."

Πηγή: <http://www.onmed.gr/yeia-politiki/item/316153-sta-xeria-tou-eisaggelea-i-yprothesi-gia-to-kartel-tou-texnitoy-nefroy#ixzz3Fgiycufs>

Επειδή η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας τελεί σε πλήρη γνώση της δράσης του ΚΑΡΤΕΛ της Medical, της Τεχνοϊατρική και της Gambro με πλήθος εγγράφων που έχει κοινοποιήσει η εταιρεία μας :

Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ. 1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014,

Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3225/21-8-2015, Αρ. πρωτ. 3296/31-8-2015.

Επειδή τις εν λόγω Τεχνικές Προδιαγραφές που προτείνουμε, τις έχουμε καταθέσει και απ' ευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3225/21-8-2015 έγγραφο μας, το οποίο και επισυνάπτουμε (**Σχετ. 20**).

Επειδή, προς επιπλέον επίρρωση όλων των παραπάνω, σας επισυνάπτουμε (**Σχετ. 21**) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που καταθέσαμε προσφάτως στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας, Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 04/9696/20-10-15 έγγραφο μας.

Επειδή η παρούσα υποβολή των Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται από την εταιρεία μας ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή, cd, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, όπως ορίζει η ανακοίνωσή σας, έγγραφο με αρ. πρωτ. 19763/28-9-2015.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και Παρατηρήσεις μας και να διαμορφώσετε ανάλογα τους αντίστοιχους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, πετυχαίνοντας έτσι :

- το σταμάτημα των ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών των Δημόσιων Νοσοκομείων.
- την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro.
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τους προϋπολογισμούς των Δημόσιων Νοσοκομείων – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Επισυναπτόμενα Σχετικά:

- 1) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 5402/23-06-2015 του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου- Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ»
- 2) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2014 του Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- 3) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2137/2015 του Γ.Ν. Ρεθύμνου
- 4) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 2860/20-03-2015
- 5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 8834/21-9-2015
- 6) Σύμβαση 4567/2003 Υπουργείου Ανάπτυξης – Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ
- 7) Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου
- 8) Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για συντηρήσεις ιατρικών μηχανημάτων με αποσπασματική μετάφραση
- 9) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 05/2012 του Γ.Ν. Κοργαλένιο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
- 10) Σύμβαση της εταιρείας με το Γ.Ν. Αθηνών Παν. & Αγλ. Κυριακού
- 11) Σύμβαση της εταιρείας με το Γ.Ν. Αθηνών Αλεξάνδρα
- 12) Σύμβαση της εταιρείας με το Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών
- 13) Σύμβαση της εταιρείας με το Γ.Ν. Αττικής Σισμανογλειο-Αμ. Φλεμινγκ, αφορά Γ.Νοσ/μειο Σισμανογλειο
- 14) Σύμβαση της εταιρείας μας με το 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
- 15) Σύμβαση της εταιρείας μας το Γ.Ν. Αττικής Σισμανογλειο-Αμ. Φλεμινγκ, υποκατάστημα Αμ. Φλέμινγκ
- 16) Εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96
- 17) Εγχειρίδιο λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200 op.man. HCEL9761.Rev.12.1999 program verison 4.xx σελ. 1:3 και 1:4
- 18) Εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8
- 19) Εγχειρίδιο συντήρησης HCEN12395 Revision 02.2010 program version 10.xx σελ. 1:5
- 20) Έγγραφο της εταιρείας μας υπ' αριθμ. 3225/21-8-2015 προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
- 21) Έγγραφο μας υπ' αριθμ. πρωτ. 04/9696/20-10-15προς το Γ.Ν. Έδεσσας
- 22) Ψηφιακός Δίσκος (cd) με όλα τα δεδομένα του παρόντος


Μπάλτσας Ιωάννης

Για τη ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ
ΣΕΡ.ΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ.: 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ


Στεριώτης Κων/νος

Διαχειριστές

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Α' Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ.**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ τηλ:
2132068933**

Θέμα

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τ. Ν. (50421000 - 2)**

Αριθμ. πρωτ.

22260

Ημ. καταχώρησης

27/10/2015

Ενέργεια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρεθύμνο, 31.03.2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 2137 / 2015

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4281/14 (Α'160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο 201 του ιδίου Νόμου.
2. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Δικαίου» Κ.Π.Δ.
3. Το Π.Δ. 60/16-3-2007 Π.Δ. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005
4. Του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήμερα μετά το Π.Δ. 60/2007.
5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν. 3329 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α' «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α'
7. Τον Ν. 3329 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
8. την με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β') περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83, παρ. 1
9. το Ν. 3867/3.08.2010 άρθρο 27, παρ. 11(ΦΕΚ 128/3-8-2010 τ. Α')
10. η με αρ. 261/19/30.06.2014 απόφαση - έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
11. την με αρ. 86/6/19.03.2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
12. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 213/30.03.2015 με ΑΔΑ ΩΒ6Θ46907Λ-ΙΕΥ
13. CPV 504221000-2 – Υπηρεσίες συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
14. ΚΑΕ 0887

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ξ Ε Ι

1. **Πρόχειρο Διαγωνισμό** με κατάθεση γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «**Συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης (με ανταλλακτικά)**» (CPV 50421000-2 – Υπηρεσίες συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Ρεθύμνης, με κριτήριο αξιολόγησης **την χαμηλότερη τιμή**, στο σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:** 36.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ
3. **ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΑ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου	16.04.2015 ΩΡΑ: 11:00	Πέμπτη	ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

4. Οι προσφορές εφόσον αποστέλλονται, θα μπορούν να περιέρχονται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
5. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο **Τμήμα Προμηθειών, του Γ. Ν. Ρεθύμνου** όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 2831087201.
6. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.rethymnohospital.gr. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ' επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει (νοείται, εφόσον επιθυμεί ο ίδιος), μέσω αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, επιστολής, e-mail, κ.τ.λ., με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email).κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.
7. Τυχόν διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής. Υποχρέωση κάθε ενδιαφερόμενου είναι η τακτική ενημέρωση του της ιστοσελίδας μας για την εξέλιξη του διαγωνισμού και διευκρινήσεων αυτού.
8. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
9. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Γεν. Νοσοκομείου Ρεθύμνης.
10. Κάθε άλλη επεξήγηση κ.λ.π. που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118 / 07).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΠΟΛΥΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****ΑΡΘΡΟ 1^ο**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάθεση «Συντήρηση και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης (με ανταλλακτικά)» (CPV 504221000-2 – Υπηρεσίες συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) για τις ανάγκες του Γ. Ν Ρεθύμνου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ως άνω ανάθεση ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο**ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

Οι προσφορές δύναται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στο: Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης,

Τμήμα Γραμματείας (Γενικό Πρωτόκολλο)

Τρανταλλίδου 15-17

74100 Ρέθυμνο

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία**».

Προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997.

ΑΡΘΡΟ 4^ο**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν, με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω, μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απορρίψεως, τα εξής δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον **Αύξοντα Αριθμό** που αναφέρεται στο παρόν άρθρο :

4.1 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ' του Π.Δ.118/2007.

4.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,

4.3 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.

4.4 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση :

4.4.1 για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/+ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25. 6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27. 11.1995, σελ. 48).
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α'305).

4.4.2 για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας

4.4.3 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

4.5 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

4.6 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:

4.6.1 Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

4.7 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:

4.7.1 ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού.

4.7.2 φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

4.8 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα τους.

4.9 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

4.10 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.

4.11 Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ. Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

4.12 Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς.

4.13 Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκομείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

4.14 Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

4.15 Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.

4.16 Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δημοπρατούμενης Υπηρεσίας.

4.17 Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

4.18 Να δηλώνεται ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

Η προσφορά (τεχνική – οικονομική) υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε δύο αντίγραφα, ξεχωριστά συραμμένα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

➤ **Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις:**

Την λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**, τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό με:

α) τον αριθμό της διακήρυξης,

β) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και

γ) τα στοιχεία του αποστολέα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

«Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβειστο Γ. Ν. Ρεθύμνου»

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :

Στοιχεία αποστολέα :

➤ **Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:**

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε αντιτύπου προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία σε τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους **επί ποινή απόρριψης** της προσφοράς, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη **ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ** και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

■ Στο φάκελο με την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** τοποθετούνται τα δικαιολογητικά, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται.

■ Στο φάκελο με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Όταν από την διακήρυξη απαιτούνται και δείγματα τότε μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα τοποθετείται και η απόδειξη αποστολής αυτών.

■ Επίσης στο φάκελο με την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**, τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα της παρούσας. Στον ίδιο φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται η *cd/dvd με την οικονομική προσφορά κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της.

■ Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»** και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική, όσο και την οικονομική προσφορά.

➤ Οι προσφορές θα συνοδεύονται επίσης από σήμανση **CE Mark & ISO**.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΤΙΜΗ:

1. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας, Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

2. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

5. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται

- σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
6. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
7. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που πιθανόν υπόκειται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ' αυτά.
8. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα οποία ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο είδος προμήθειας.
9. **Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.**
10. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσμα.
11. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
12. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
13. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως **απαράδεκτη**.
14. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
15. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
16. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
17. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης.
18. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
19. Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στον Αναθέτοντα κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.
20. Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος της σύμβασης. Στην συνέχεια (επόμενα έτη σύμβασης και πιθανής παράτασης) δεν θα αναπροσαρμόζεται.
21. Οι προσφερόμενες τιμές να μην υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ., όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό (όπου υπάρχουν αντίστοιχες). Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, **απορρίπτονται.** (Ν. 3918/2.04.2011)
22. **Να κατατεθούν και οι αντίστοιχες καταστάσεις / τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών όπου υπάρχουν.**

ΑΡΘΡΟ 7^ο**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ**

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Γρ. Προμηθειών ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου

Αποσφράγιση προσφορών

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών δημόσια την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

➤ **Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

➤ Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή.

➤ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

➤ Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

➤ Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

➤ Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

➤ Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης.

➤ Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

➤ Προσφορά, η οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) και με την παρακάτω διαδικασία:

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Διαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών υπο-φακέλων (Δικαιολογητικών, Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) οι οποίοι και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος των τεχνικών προσφορών, οι οποίοι μονογράφονται στο σύνολό τους (τα πρωτότυπα στοιχεία) ανά φύλλο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). Σε περίπτωση συρραφής υπογράφεται η πρώτη και η τελευταία σελίδα.

• Ο φάκελος των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζεται στην συνέχεια και μόνο εφόσον ο ανάδοχος έχει πλήρη τα δικαιολογητικά και είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών και μονογράφεται.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού

Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ' αναλογία.

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

3. Dumping-Εξαγωγικές Επιδοτήσεις.

A. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

B. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)

ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με τη ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδεκτής πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή DUMPING) ή αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης.

Γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προσφερόμενης δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη- μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του ΠΟΕ ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης .

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους **εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.**

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :

1. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
3. Προσφορά που είναι αδύνατη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαραίτους όρους της Διακήρυξης
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας (άρθρο 52 του Π.Δ.60/2007). Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
8. Όταν αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
9. Όταν αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας
10. Όταν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας
11. Όταν διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης.
12. Όταν οι προσφορές δεν συνοδεύονται από σήμανση CE Σήμανση & ISO.

13. Όταν οι προσφορές δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

14. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη, τις τεχνικές προδιαγραφές ή δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον ανάδοχο με την **χαμηλότερη τιμή**, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Κατόπιν τούτου θα αποσταλεί προς τις εταιρείες έγγραφο διαπραγμάτευσης διότι σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 118/07 άρθρο 21, παρ. β, αν η κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας υλικού δεν είναι διαιρετή τότε ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης και θα συνεδριάσει ξανά μετά την παραλαβή των νέων προσφορών.

Το αρμόδιο όργανο, δηλ. το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει :

α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής: α) Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και β) το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον ανάδοχο.

β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή.

δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας

η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μια μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μια μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνεται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευσης της τιμής.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το σχέδιο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

- A. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- B. Τα συμβαλλόμενα μέρη

- Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
- Δ. Την τιμή
- Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής
- ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Νοσοκομείου και Ανάδοχου, θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, εκτός αν υπάρξει εντολή ακύρωσης των συμβάσεων από προϊσταμένη αρχή (7^η ΥΠΕ, Ε.Π.Υ., Υπουργείο Υγείας) πριν από τη λήξη τους οπότε θα πάψουν να ισχύουν.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης του χρόνου (μονομερώς εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής) με τους ίδιους όρους, εννεάμηνη παράταση εφόσον κριθεί απαραίτητο ισχύος της σύμβασης με τους ίδιους όρους. Παράταση πλέον των τριών μηνών αυτών προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Μετά την ανάθεση των ειδών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά ισχύος της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως εξής:

- Σύμβαση,
- Απόφαση κατακύρωσης
- Διακήρυξη
- Προσφορά αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 14^ο**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:**

1. Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή προς τον ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση των αναδόχων θα γίνεται κατά μέγιστο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
2. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Ανάδοχο θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
3. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
4. **Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι:**
 - 4.1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε ποσοστό 1.5% επί του καθαρού ποσού
 - 4.2. Υπέρ χαρτοσήμου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ.
 - 4.3. Φορολογία εισοδήματος 8% και τιμολόγιο πώλησης 4%. (Ν. 2198/94) και όπως σχετικά τροποποιείται.

4.4. Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07 άρθρο 3) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-09

4.5.Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1%

Και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση απαιτείται.

5. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
6. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
7. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
8. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου ("project leader"). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.
9. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» συμπεριλαμβανομένου του Ν 4152/2013, καθίσταται υπερέμηρη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον **τέσσερις (4) προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις** σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικαθίστανται τα ο-ring καθώς και τα φίλτρα αέρα και φίλτρα πιπετών, να ελέγχονται όλες οι σωληνώσεις, οι βαλβίδες, οι αντλίες και οι πλακέτες, αντικαθιστώντας αν κάτι από αυτά δεν λειτουργεί αξιόπιστα. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, πιέσεων και καλής λειτουργίας των παραμέτρων και των ορίων τους και να γίνεται καθαρισμός των μηχανημάτων εσωτερικά και εξωτερικά. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι' αυτές τις συντηρήσεις, θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (DOWN-TIME)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις **δέκα (10) ημέρες**. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος, από την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

β) κατά των πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε αναδόχου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής αναδόχου σ' αυτόν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μέσα στην επόμενη ημέρα στις δύο άλλες περιπτώσεις γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι έως την επιστροφή της ή τουλάχιστον 13 μηνών.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 20°**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 23°**ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:**

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου.

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου.

Πλημμύρα.

Σεισμός.

Πόλεμος.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την Αναθέτουσα Αρχή και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Φορέα, της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση της υπηρεσίας, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιαδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανώτερα αρχή ή την Ε.Π.Υ. ή την αρμόδια Υ.Π.Ε η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.
5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής

- διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
- α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
 - β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
 - γ) Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας της προμήθειας για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα του άρθρου 24 της παρούσης διακήρυξης.
 - δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
6. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

ΑΡΘΡΟ 26^ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ:

1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, εφαρμοστέο δε δικαίωμα είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

01. Προληπτική Συντήρηση

Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον **τέσσερις (4) προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις** σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικαθίστανται τα o-ring καθώς και τα φίλτρα αέρα και φίλτρα πιπετών, να ελέγχονται όλες οι σωληνώσεις, οι βαλβίδες, οι αντλίες και οι πλακέτες, αντικαθιστώντας αν κάτι από αυτά δεν λειτουργεί αξιόπιστα. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, πέσεων και καλής λειτουργίας των παραμέτρων και των ορίων τους και να γίνεται καθαρισμός των μηχανημάτων εσωτερικά και εξωτερικά. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι' αυτές τις συντηρήσεις, θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

02. Αποκατάσταση Βλάβης

Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για **αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης** που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

03. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις **δέκα (10) ημέρες**. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

04. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

- 05. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου**
 Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.
- 06. Ανταλλακτικά**
 Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς καμία επιβάρυνση από το Νοσοκομείο. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για τη συνήθη χρήση του μηχανήματος. Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.
 Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.
 Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.
- 07. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)**
 Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.
- 08. Τηλεφωνική Υποστήριξη**
 Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.
- 09. Απόσυρση Μηχανήματος**
 Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι' αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή

ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης.

10. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης *ISO 9001* και *ISO 13485* για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. Φύλλο Συμμόρφωσης

Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο απαιτήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ



ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« _____ »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	ΑΔΑ

Στο Ρέθυμνο σήμερα στις _____ ημέρα _____ στα γραφεία της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

01. _____, ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου (Τρανταλλίδου 17, 74100 Ρέθυμνο, ΑΦΜ: 999272718 – ΔΟΥ: Ρεθύμνου) αποκαλούμενος στο εξής χάριν συντομίας **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

02. _____ ως εκπρόσωπος της εταιρείας _____ (_____, _____, ΑΦΜ: _____ – ΔΟΥ: _____) αποκαλούμενος στο εξής χάριν συντομίας **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπ' όψη του :

01. CPV 504221000-2 – Υπηρεσίες συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

02. ΚΑΕ 0887

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την ανάθεση έργου για τη **Συντήρηση και Επισκευής Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης (με ανταλλακτικά)** αποκαλούμενο στο εξής χάριν συντομίας **ΕΡΓΟ**, όπως περιγράφεται στην προσφορά που κατέθεσε στον προαναφερόμενο διαγωνισμό και συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** αναθέτει και ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του **ΕΡΓΟΥ**, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

Το **ΕΡΓΟ** θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**, σε συνδυασμό με τους όρους της διακήρυξης και τη σχετική απόφαση κατακύρωσης του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**. Το ανωτέρω στο εξής θα καλείται **ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με την προσφορά του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** όπου αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου **ΕΡΓΟΥ** και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Συγκεκριμένα το **ΕΡΓΟ** περιλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή των κάτωθι **Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης** που είναι του Σουηδικού κατασκευαστικού οίκου **GAMBRO** και είναι εγκατεστημένα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου :

01. **AK-95** με S/N : 5346 (έτος εγκατάστασης:1999)
02. **AK-95** με S/N : 5348 (έτος εγκατάστασης:1999)
03. **AK-95** με S/N : 5351 (έτος εγκατάστασης:1999)
04. **AK-95** με S/N : 9525 (έτος εγκατάστασης:2002)
05. **AK-200** με BM : 3432 και FM : 2727 (έτος εγκατάστασης:1999)
06. **AK-200S** με BM : 16093 και FM : 13038 (έτος εγκατάστασης:2003)
07. **AK-200S** με BM : 16094 και FM : 13039 (έτος εγκατάστασης:2003)
08. **AK-200S** με BM : 16095 και FM : 13040 (έτος εγκατάστασης:2003)
09. **AK-200S** με BM : 16096 και FM : 13041 (έτος εγκατάστασης:2003)
10. **AK-200S** με BM : 16097 και FM : 13042 (έτος εγκατάστασης:2003)
11. **AK-200S** με BM : 16098 και FM : 13043 (έτος εγκατάστασης:2003)

12. **AK-200S** με ΒΜ : 16104 και FM : 13049 (έτος εγκατάστασης:2003)
 13. **AK-200S** με ΒΜ : 16105 και FM : 13050 (έτος εγκατάστασης:2003)

ΑΡΘΡΟ 2^ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του **ΕΡΓΟΥ** ορίζεται σε ένα τρίμηνο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα :

από _____ έως _____

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.Π.Υ. ή την αρμόδια Υ.Π.Ε η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης.

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μέρος ή το σύνολο του υπό συντήρηση εξοπλισμού τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** γι' αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η οικονομική προσφορά του Ανάδοχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ _____ €/μηχάνημα.

Τιμή συντήρησης για έναν (1) μήνα _____ € χωρίς ΦΠΑ

Τιμή συντήρησης για δώδεκα (12) μήνες _____ € χωρίς ΦΠΑ

Τιμή συντήρησης για δώδεκα (12) μήνες _____ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Α/Α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ)	ΦΠΑ 23%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (για 12 μήνες)
I.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αιμοκάθαρσης (με ανταλλακτικά) (Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού CPV 50421000-2)	Μηχάνημα ανά μήνα						

	(AK-95, AK-200 & AK-200S)							
	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ						

1. **Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€)**, αφού προηγουμένως ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν 2469/97 συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ /Α/107/9.05.2013) και όπως αναλυτικά διευκρινίζεται παρακάτω.
2. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** για την εκτέλεση του **ΕΡΓΟΥ**, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**. Το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** ή τρίτων.
3. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
4. **Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι:**
 - 2.2. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε ποσοστό 1,5% επί του καθαρού ποσού
 - 2.3. Υπέρ χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ.
 - 2.4. Φορολογία εισοδήματος 4% (Ν. 2198/94)
 - 2.5. Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07 άρθρο 3) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-09
 - 2.6. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%

Και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση απαιτείται.
3. **Τρόπος Πληρωμής:**
 1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.)
 2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο.
 3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.)
 5. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής, οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
 6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35

παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

7. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

9. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

10. **Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.**

11. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

12. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» συμπεριλαμβανομένου του Ν 4152/2013, καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του **ΕΡΓΟΥ**, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και με τους όρους της Τεχνικής Προσφοράς του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παραλαβή του **ΕΡΓΟΥ** θα γίνεται από τριμελή επιτροπή (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών), που θα εκδίδει σχετικό πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του **ΕΡΓΟΥ**, ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του **ΕΡΓΟΥ**.

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το **ΕΡΓΟ** (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το **ΕΡΓΟ**, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**.

Απαγορεύεται στον **ΑΝΑΔΟΧΟ** να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ. ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της παρούσης σύμβασης.

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Προληπτική Συντήρηση

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον **μία (1) προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση ανά τρίμηνο** σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Θα οριστεί μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**.

Κατά την προληπτική συντήρηση θα πρέπει να διενεργούνται οπωσδήποτε τα κάτωθι :

- Να αντικαθίστανται τα o-ring καθώς και τα φίλτρα αέρα και φίλτρα πιπετών.
- Να ελέγχονται όλες οι σωληνώσεις, οι βαλβίδες, οι αντλίες και οι πλακέτες, αντικαθιστώντας αν κάτι από αυτά δεν λειτουργεί αξιόπιστα.
- Να γίνεται έλεγχος αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, πέσεων και καλής λειτουργίας των παραμέτρων και των ορίων τους.
- Να γίνεται καθαρισμός των μηχανημάτων εσωτερικά και εξωτερικά.

Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου.

Αποκατάσταση Βλάβης

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης του μηχανήματος που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση των πιθανών βλαβών εντός **48 ωρών** από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** στο χώρο του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**.

Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)

Από τη στιγμή που το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** ενημερώσει τον **ΑΝΑΔΟΧΟ** για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις **1,2 ημέρες ανά μήνα ή 3,6 ημέρες ανά τρίμηνο** για κάθε ένα από τα μηχανήματα. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**.

Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Ανταλλακτικά

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το **ΑΝΑΔΟΧΟ** χωρίς καμία επιβάρυνση από το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για τη συνήθη χρήση του μηχανήματος. Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτά και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν των ίδιων των μηχανημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** και μετά από

ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με τα αντίστοιχα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα έντυπα Δελτία Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρουν το καθένα την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** ή τους ίδιους τους χειριστές, ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δεν συμμορφώνεται με τις ως άνω υποχρεώσεις του, το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) με δικά του έξοδα, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό συντήρηση εξοπλισμού:

01. Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του εξοπλισμού και το χειρισμό του από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
02. Να προφυλάσσει τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκομείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κλπ).
03. Να γνωστοποιεί στον **ΑΝΑΔΟΧΟ** οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς να προβαίνει μονομερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη – παρέμβαση ή τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λπ., παρά μόνον έπειτα από προηγούμενη σχετική συνεννόηση με τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**.
04. Να διευκολύνει την είσοδο των τεχνικών του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** για την παροχή υπηρεσιών στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός, να παρέχει επαρκή χώρο για κάθε απαραίτητη εργασία αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή:

01. Η ζημία ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμό, θύελλες, πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά). Από χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** ή τρίτους.
02. Η αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το προσωπικό του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** ή τρίτους.
03. Η κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V / 50Hz περιόδων του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** ή της ΔΕΗ.
04. Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

Εάν το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** ζητήσει αποκατάσταση των βλαβών και εφόσον είναι δυνατόν, λόγω των παραπάνω περιπτώσεων, η νέα δαπάνη θα συμπεριλαμβάνει τα εργατικά και τα ανταλλακτικά και θα χρεώνεται χωριστά, με βάση τις τότε ισχύουσες τιμές του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**.

ΑΡΘΡΟ 10^ο **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στην Ε.Π.Υ. την υπ' αριθ., η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 με χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση παράτασης σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει μαζί με την αποδοχή της παράτασης να παρατείνει αντίστοιχα και την Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης για το ανάλογο διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 11^ο **ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του **ΕΡΓΟΥ**, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12^ο **ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον **ΑΝΑΔΟΧΟ** αν συντρέχουν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

01. Αν ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
02. Αν ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δεν συμμορφώνεται προς τις συμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**.
03. Αν ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** εκχωρεί τη σύμβαση.
04. Αν ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
05. Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Σε περίπτωση κήρυξης του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στο **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**.

ΑΡΘΡΟ 13^ο **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

01. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου.
02. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου.
03. Πλημμύρα.
04. Σεισμός.
05. Πόλεμος.
06. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
07. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** της ανώτερης βίας που επικαλείται ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης του **ΕΡΓΟΥ**.

ΑΡΘΡΟ 14^ο **ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του **ΕΡΓΟΥ** που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**.

Ειδικότερα:

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπάλληλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος **ΕΡΓΟΥ** και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος **ΕΡΓΟΥ**.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του

παρόντος **ΕΡΓΟΥ**, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του **ΕΡΓΟΥ** αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το **ΕΡΓΟ**, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** υποχρεούται να ενημερώνει το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον **ΑΝΑΔΟΧΟ** κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στο **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**.

ΑΡΘΡΟ 15^ο **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 16^ο **ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ**

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**.

ΑΡΘΡΟ 17^ο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΔΙΕΠΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΑΡΘΡΟ 18^ο **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

01. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δηλώνει ανεπιφύλακτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
02. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριόριστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του **ΕΡΓΟΥ**, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

03. Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η κατατεθείσα προσφορά του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
- α) Η παρούσα σύμβαση
 - β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
 - γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
 - δ) Η προσφορά του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**
04. Τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
05. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** του **ΕΡΓΟΥ** και το **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

Από τα ως άνω τρία (3) πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα του **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**, το δε ένα έλαβε ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Σ Ε Ρ Κ Ο Ε Π ΕΕπιστημονικά - Ηλεκτρονικά
Μηχανήματα

(Εισαγωγές - Εμπορία - Service)

EN ISO 13485 : 2003

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2008

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο :

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ <<ΕΥΑΣ ΓΕΝΙΣΜΟΣ>>

Σε προσοχή : Δ/ντή Μονάδος Τεχνητού Νεφρού.

*** ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Χ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (TD-09)	1 ΚΑΚΗ	2 ΜΕΤΡΙΑ	3 ΚΑΛΗ	4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
1. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας, με την εταιρεία μας ;				✓
2. Ποια είναι η γνώμη σας, για τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα σας, από την εταιρεία μας ;				✓
3. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας ;				✓
4. Σε τι βαθμό είσαστε ικανοποιημένοι από το προσωπικό της εταιρείας μας ;				✓

5. Έχετε κάποιο παράπονο που θέλετε να γράψετε ;

OXI

ΝΑΙ

(QM-08)

Εάν υπήρχαν γραπτά παράπονα σας το 2008, ο χειρισμός τους ήταν αποτελεσματικός ;

ΝΑΙ

OXI

(QM-17)

Δεν υπάρχει

Για την Μονάδα Τ.Ν

Δ. ΧΑΤΖΗΚΙΩΝ ΔΙΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΜ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Δ/ΤΗΣ ΝΕΦ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΝ. Ο. ΣΥΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο

12/1/09

*** Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε

Η επιστροφή του ανωτέρω ερωτηματολογίου εις εμάς είναι δυνατόν να γίνει με FAX στο 210 7519343, ή ταχυδρομικώς στην ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ Αγησάνδρου 3, Αγ. Αρτέμιος ΤΚ 11632 ΑΘΗΝΑ.



Αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη από την GAMBRO,
για συντήρηση & επισκευές μηχανημάτων
τεχν. νεφρού στην Ελλάδα



EN ISO 9001:2000

Αθήνα 20 Μαρτίου 2007

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο :

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Σε προσοχή : Δ/ντή Μονάδος Τεχνητού Νεφρού.

*** ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Χ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (TD-09)	1 ΚΑΚΗ	2 ΜΕΤΡΙΑ	3 ΚΑΛΗ	4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
1. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας, με την εταιρεία μας ;				X
2. Ποια είναι η γνώμη σας, για το χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα σας, από την εταιρεία μας ;				X
3. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας ;				X
4. Σε τι βαθμό είσαστε ικανοποιημένοι από το προσωπικό της εταιρείας μας ;				X

5. Έχετε κάποιο παράπονο που θέλετε να γράψετε ;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

(QM-06)

Εάν υπήρχαν γραπτά παράπονα σας το 2006, ο χειρισμός τους ήταν αποτελεσματικός ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(QM-17)

Για την Μονάδα Τ.Ν

Δ/ΝΣΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΜ. ΕΠΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝ
ΔΙ/ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Υπογραφή Ονόματι

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε

Η επιστροφή του ανωτέρω ερωτηματολογίου σε εμάς είναι δυνατόν να γίνει με FAX: στο 210 7519343, ή ταχυδρομικώς στη ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ Χερσίφρονος 2 Αγ. Αρτέμιος ΤΚ 11636 ΑΘΗΝΑ.

Σ Ε Ρ Κ Ο ΕΠΕ

**Επιστημονικά - Ηλεκτρονικά
Μηχανήματα**
(Εισαγωγές - Εμπορία - Service)



EN ISO 9001:2000

Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2005

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο :

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Γ. Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός»

Σε προσοχή : Διευθυντή Μονάδος Τεχνητού Νεφρού.

*** ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Χ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (TD-09)	1 ΚΑΚΗ	2 ΜΕΤΡΙΑ	3 ΚΑΛΗ	4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
1. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας, με την εταιρεία μας ;				✓
2. Ποια είναι η γνώμη σας, για τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματά σας, από την εταιρεία μας ;				✓
3. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας ;				✓
4. Σε τι βαθμό είσαστε ικανοποιημένοι από το προσωπικό της εταιρείας μας ;				✓

5. Έχετε κάποιο παράπονο που θέλετε να μας γράψετε ;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

(QM-06)

Εάν υπήρχαν γραπτά παράπονα σας το 2005, ο χειρισμός τους ήταν αποτελεσματικός ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(QM-17)

Για τη Μονάδα Τ.Ν.

Β. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΜ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Δ/ΤΗΣ ΝΕΦ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο

*** Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε

Η επιστροφή του ανωτέρω ερωτηματολογίου εις εμάς είναι δυνατόν να γίνει με FAX : στο 210 7519343, η ταχυδρομικώς στην ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ Χερσίφρονος 2 Αγ. Αρτέμιος ΤΚ 11636 ΑΘΗΝΑ.

Σ Ε Ρ . Κ Ο Ε Π Ε
 Επιστημονικά - Ηλεκτρονικά
 Μηχανήματα
 (Εισαγωγές - Εμπορία - Service)



Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2004

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο :

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Γενικό Γ. Νοσοκομείο Αθηνών "Ευαγγελισμός"

Σε προσοχή : Δ/ντή Μονάδος Τεχνητού Νεφρού.

*** ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Χ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (TD-09)	1 ΚΑΚΗ	2 ΜΕΤΡΙΑ	3 ΚΑΛΗ	4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
1. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας, με την εταιρεία μας ;				X
2. Ποια είναι η γνώμη σας, για τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα σας, από την εταιρεία μας ;				X
3. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας ;				X
4. Σε τι βαθμό είσαστε ικανοποιημένοι από το προσωπικό της εταιρείας μας ;				X

5. Έχετε κάποιο παράπονο που θέλετε να μας γράψετε ;

ΟΧΙ ΝΑΙ (QM-06)

Εάν υπήρχαν γραπτά παράπονα σας το 2004, ο χειρισμός τους ήταν αποτελεσματικός :

ΝΑΙ ΟΧΙ (QM-17)

*** Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε.

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 Δ/ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΤΜΗΜΑΤΩΝ
 Γ.Ν. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Η επιστροφή του ανωτέρω ερωτηματολογίου εις εμάς είναι δυνατόν να γίνει με FAX : 210 7519343, ή ταχυδρομικώς στην ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ Χερσίφρονος 2 Αγ. Αρετίους ΤΚ 11636 ΑΘΗΝΑ.

Σ Ε Ρ Κ Ο ΕΠΕ**Επιστημονικά - Ηλεκτρονικά****Μηχανήματα**

(Εισαγωγές - Εμπορία - Service)



EN ISO 9001:2000

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2003

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Γ. Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Σε προσοχή : Δ/ντή Μονάδος Τεχνητού Νεφρού.

***** ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Χ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ**

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (TD-09)	1 ΚΑΚΗ	2 ΜΕΤΡΙΑ	3 ΚΑΛΗ	4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
1. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας, με την εταιρεία μας ;				X
2. Ποια είναι η γνώμη σας, για το χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα σας, από την εταιρεία μας ;				X
3. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας ;				X
4. Σε τι βαθμό είσαστε ικανοποιημένοι από το προσωπικό της εταιρείας μας ;				X

5. Έχετε κάποιο παράπονο που θέλετε να μας γράψετε ;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

(QM-06)

Εάν υπήρχαν γραπτά παράπονα σας το 2003, ο χειρισμός τους ήταν αποτελεσματικός ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(QM-17)

*** Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε

Η επιστροφή του ανωτέρω ερωτηματολογίου εις εμάς είναι δυνατόν να γίνει με FAX: στο 210 7519343, η ταχυδρομικώς στη ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ Χερσίφρονος 2 Αγ. Αρτέμιος ΤΚ 11636 ΑΘΗΝΑ.

Σ Ε Ρ Κ Ο Ε Π Ε

Επιστημονικά - Ηλεκτρονικά

Μηχανήματα

(Εισαγωγές - Εμπορία - Service)



EN ISO 9002

Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2002

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στην προσπάθεια μας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο :

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : *ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ*

Σε προσοχή : Δ/ντή Μονάδος Τεχνητού Νεφρού.

Ημερομηνία : *4/11/2002*

*** ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Χ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (TD-09)	1 ΚΑΚΗ	2 ΜΕΤΡΙΑ	3 ΚΑΛΗ	4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
1. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας, με την εταιρεία μας ;				X
2. Ποια είναι η γνώμη σας, για τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα σας, απο την εταιρεία μας ;				X
3. Ποια είναι η γνώμη σας, για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας ;				X
4. Σε τι βαθμό είσαστε ικανοποιημένοι από το προσωπικό της εταιρείας μας ;				X

5. Υπήρχαν γραπτά παράπονα σας το τελευταίο έτος προς την εταιρεία μας ;

OXI

NAI

(QM-06)

*** Εάν υπήρχαν γραπτά παράπονα ανωτέρω ο χειρισμός τους ήταν αποτελεσματικός ;

NAI

OXI

(QM-17)

*** Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε

Η επιστροφή του εις εμάς είναι δυνατόν να γίνει με FAX : στο 010 7519343, η ταχυδρομικώς στην ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ Χερσίφρονος 2 Αγ. Αρτέμιος ΤΚ 11636 ΑΘΗΝΑ μέχρι τις 11-11-2002.

Άλλες λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Χρήστης

Ο χρήστης στο παρόν εγχειρίδιο είναι το άτομο που έχει την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96. Ο χρήστης αποφασίζει ποιες ρουτίνες της κλινικής ισχύουν για το μηχάνημα αιμοκάθαρσης AK 96.

Χειριστής

Ο χειριστής στον παρόν εγχειρίδιο είναι το άτομο που έχει γνώσεις και κατάρτιση σχετικά με την αιμοκάθαρση και είναι ο υπεύθυνος ελέγχου του μηχανήματος, δηλαδή ορίζει τις ρυθμίσεις του μηχανήματος πριν από, στη διάρκεια και μετά τη θεραπεία αιμοκάθαρσης. Ο χειριστής αναφέρεται μερικές φορές ως "Εσείς".

Εξουσιοδοτημένος τεχνικός

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός είναι ένας τεχνικός που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96 από τη Gambro και διαθέτει πιστοποίηση από τη Gambro ή έχει αποκτήσει ισάξια εμπειρία με παρόμοιο τρόπο.

Μηχάνημα

Όποτε η λέξη Μηχάνημα χρησιμοποιείται στο παρόν εγχειρίδιο, αναφέρεται πάντα στο μηχάνημα αιμοκάθαρσης AK 96, εφόσον δεν αναφέρεται άλλο μηχάνημα.

Εγχειρίδιο

Όποτε η λέξη Εγχειρίδιο χρησιμοποιείται στο παρόν εγχειρίδιο, αναφέρεται πάντα στο Εγχειρίδιο χειριστή για το μηχάνημα αιμοκάθαρσης AK 96, εφόσον δεν αναφέρεται άλλο μηχάνημα.

Προαιρετικά

Μερικές φορές οι λειτουργίες και τα εξαρτήματα του μηχανήματος επισημαίνονται ως "**Προαιρετικά**", που σημαίνει ότι το μηχάνημα μπορεί να μη διαθέτει τη λειτουργία/το εξάρτημα που περιγράφεται. Μερικές φορές προαιρετική είναι μια λειτουργία ή ένα εξάρτημα το οποίο περιλαμβάνεται στο μηχάνημα και μπορεί να ενσωματωθεί, στη συνέχεια, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό κατόπιν αιτήσεως.


Εικόνες

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους εικόνων. Ο ένας τύπος εικόνων είναι οι οθόνες και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών. Αυτές οι εικόνες είναι απευθείας στιγμιότυπο από την οθόνη πληροφοριών του μηχανήματος και δεν έχουν αναθεωρηθεί στη συνέχεια ώστε ο χειριστής να αναγνωρίζει τις τρέχουσες προβολές του μηχανήματος για την υπό εξέλιξη διαδικασία. Μερικές εικόνες απεικονίζουν το χειρισμό ή επισημαίνουν τα εξαρτήματα του μηχανήματος. Σε αυτές τις εικόνες έχουν προστεθεί βέλη που επισημαίνουν συγκεκριμένα στοιχεία ή απεικονίζουν κινήσεις.



Όταν αυτό το "ευθύγραμμο βέλος" εμφανίζεται σε εικόνες, επισημαίνει λεπτομέρειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο κείμενο. Το βέλος μπορεί, επίσης, να δείχνει μια κατεύθυνση, δηλαδή εάν κάτι πρόκειται να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

AK 96® Μηχάνημα αιμοκάθαρσης

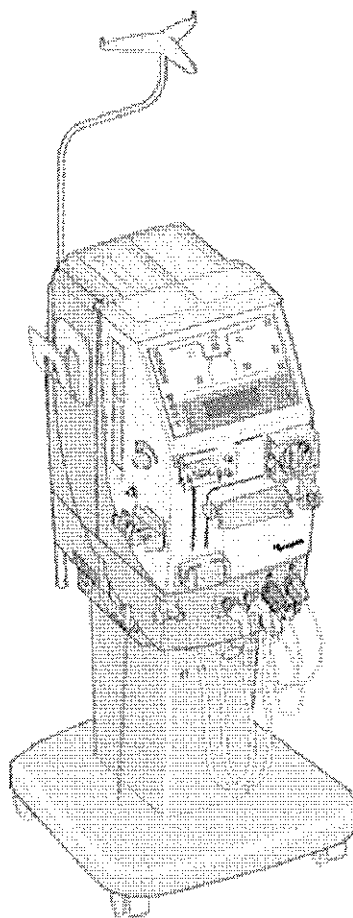

Εγχειρίδιο χειριστή

Για χρήση με την έκδοση προγράμματος 4.xx

Αριθμός παραγγελίας:
MHCEL12246-12/12

Πνευματικά δικαιώματα:

© 2007, 2008-2012 Gambro Lundia AB. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα:

Τα **Gambro**, **AK 96**, **BiCart**, **CleanCart**, **Diascan**, **SoftPac** και **U 9000** είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στον Όμιλο Gambro.

Το **Dialox** είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr.

Κατασκευαστής:

Gambro Lundia AB

Box 10101

Magistratsvägen 16

SE-220 10 LUND

Σουηδία

Τηλέφωνο +46 46 169000

www.gambro.com

Στοιχεία επικοινωνίας αντιπροσώπου πωλήσεων, (εάν εφαρμόζεται):

Για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την έκδοση, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στον κατασκευαστή.

Εγγραφή σε τοπικούς ρυθμιστικούς κανόνες (εάν εφαρμόζεται):

한국 시장에 관련된 정보

수입품목허가번호

수입업자

수허 09-204 호

한국갬브로(주), 서울시

강남구 삼성동

145-9 대한해운빌딩 4층

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, αλλαγές ή επισκευές και έλλειψη συντήρησης ή βαθμονόμηση του ΑΚ 200 μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα τη λανθασμένη λειτουργία ή άλλες σοβαρές συνέπειες στην ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Το ΑΚ 200 μπορεί μόνο να λειτουργήσει από άτομα που είναι εκπαιδευμένα στην αιμοδιάλυση και τα οποία έχουν μελετήσει τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι το πρώτο ψηφίο της έκδοσης του προγράμματος του μηχανήματος και του εγχειριδίου είναι τα ίδια. Εάν το ΑΚ 200 δεν αποδίδει όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να επανορθωθεί η κατάσταση.
2. Όταν αποσυσκευάζετε, ελέγξτε τον εξοπλισμό για ενδείξεις βλαβών. Εάν ο εξοπλισμός έχει υποστεί βλάβες κατά οποιονδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
3. Ασθενείς με μηχανήμα υποστήριξης ζωής, όπως για παράδειγμα με το ΑΚ 200 πρέπει να παρακολουθούνται από ικανό ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευμένους ενδιάμεσους ή παρόμοιο προσωπικό, καθώς μερικές φορές συμβαίνουν καταστάσεις που απειλούν τη ζωή οι οποίες μπορεί να μην ενεργοποιήσουν συναγερμούς. Ο χειριστής πρέπει να προσέχει όλους τους κατάλληλους συναγερμούς και να ακολουθεί τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις, τα σημεία προσοχής και τις σημειώσεις που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Είναι επιτακτικό να ελέγχεται το μηχανήμα υποστήριξης ζωής για σωστή λειτουργία πριν από τη χρήση.
4. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι βαθμονόμησης πριν χρησιμοποιηθεί το μηχανήμα για την αιμοδιάλυση ενός ασθενούς.
5. Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή εξοπλισμού επικοινωνίας στην περιοχή λειτουργίας του ΑΚ 200 μπορεί να επιδράσει δυσμενώς στην απόδοση του μηχανήματος.
6. Το ΑΚ 200 θα αποδώσει όπως είναι σχεδιασμένο μόνο εάν χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Gambro. Οποιοσδήποτε εγγυήσεις από την Gambro σχετικά με το ΑΚ 200 είναι άκυρες εάν ο εξοπλισμός δε χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Η Gambro δεν θα αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τραυματισμό που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης λειτουργίας ή συντήρησης ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής.
7. Οι προληπτικές επιθεωρήσεις, συντήρηση και βαθμονόμηση του ΑΚ 200 θα γίνονται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Σέρβις του ΑΚ 200, το Εγχειρίδιο Συντήρησης HCEN9164 τα οποία μπορούν να παραγγελθούν από τον αντιπρόσωπό σας της Gambro. Η περιοδική συντήρηση πρέπει να γίνεται μετά από κάθε 2500 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον ανά έτος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το εγχειρίδιο του χειριστή παρέχει οδηγίες απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του ΑΚ 200. Δεν είναι οδηγός για την παροχή αιμοδιάλυσης.
2. Τα μηχανήματα δεν αποστειρώνονται πριν από την παράδοση. Να εκτελείται πάντα χημική αποστείρωση πριν από την εγκατάσταση, πριν από την αρχική χρήση.
3. Όταν οι διακυμάνσεις ακρίβειας είναι γραμμένες όπως για παράδειγμα " ± 1 ml/min ή $\pm 1\%$ ", η μεγαλύτερη διακύμανση είναι η έγκυρη.
4. Κατά τη μεταφορά και τη φύλαξη ο εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία. Εάν η μεταφορά ή η αποθήκευση διαρκούν περισσότερο από 15 εβδομάδες πρέπει να ακολουθηθούν τα περιβαλλοντικά δεδομένα που σχετίζονται με τη λειτουργία.
5. Για τον εκπαιδευμένο τεχνικό διατίθεται το Εγχειρίδιο Σέρβις ΑΚ 200. Το Εγχειρίδιο Σέρβις παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος.
6. Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει την ποιότητα της προστατευτικής γείωσης στην εγκατάσταση.

 **GAMBRO**. Renal Products

Gambro Lundia AB
Box 10101
SE-220 10 Lund
Sweden

Phone: +46 46 16 90 00
Fax: +46 46 16 96 96
www.gambro.com

© Gambro Lundia AB, 1996

→ → → ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις που αφορούν τη διαρροή ρεύματος προς τον ασθενή από το υγρό της αιμοδιάλυσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς. Όταν χρησιμοποιείται κεντρικός φλεβικός καθετήρας τοποθετημένος στον κόλπο, είναι ωστόσο απαραίτητο να λαμβάνετε επιπλέον προφυλάξεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αρρυθμιών λόγω διαρροής ρεύματος. Για αυτές τις θεραπείες είναι απαραίτητη η σύνδεση αγωγού εξίσωσης δυναμικού ανάμεσα στο μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S και τη ράβδο διαύλου εξίσωσης δυναμικού στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Για να ελαχιστοποιήσετε τα διαφυγόντα ρεύματα από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, συστήνουμε την τοποθέτηση τέτοιου εξοπλισμού εκτός της περιοχής των ασθενών. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός στην περιοχή του ασθενούς πρέπει να πληροί τα πρότυπα IEC 60601-1 και IEC 60601-1-1 (για συμμόρφωση με τη 2η έκδοση του προτύπου IEC 60601-1) και να αποτελεί μέρος της εξίσωσης δυναμικού. Ένας τρόπος για να ελαχιστοποιήσετε τη διαρροή ρεύματος από τον εξοπλισμό στην περιοχή του ασθενούς είναι η ηλεκτρική μόνωση του εξοπλισμού. Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές διαρροής του ρεύματος βρίσκονται κάτω από το αντίστοιχο όριο που απαιτείται από τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά τύπου CF. Ο έλεγχος να γίνει μαζί με έναν τεχνικό συντήρησης. Αν η κλινική/το νοσοκομείο σας χρησιμοποιεί κεντρικό φλεβικό καθετήρα για τις θεραπείες, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας είναι εξοπλισμένο με σύνδεση εξίσωσης δυναμικού. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με τον Τεχνικό Σέρβις της Gambro για περαιτέρω βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- | Η λειτουργία του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S επιτρέπεται μόνο σε άτομα εκπαιδευμένα στην αιμοδιάλυση, τα οποία έχουν μελετήσει τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο χρήστης/χειριστής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο κείμενο που αναφέρεται στη φιλοσοφία της ασφάλειας του μηχανήματος. Δείτε την ενότητα "Φιλοσοφία ασφάλειας", στη σελίδα 1:13, στο μέρος 1. Βεβαιωθείτε ότι το πρώτο ψηφίο της έκδοσης του προγράμματος τόσο του μηχανήματος όσο και του εγχειριδίου είναι τα ίδια. Αν το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως ότου η κατάσταση επανορθωθεί.
- | Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, εξετάστε αν υπάρχουν ενδείξεις ζημιών στον εξοπλισμό. Αν ο εξοπλισμός έχει κάποια ένδειξη ζημιάς, δεν εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του.

ΠΡΟΣΟΧΗ → → →

→ → → ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ασθενείς που είναι συνδεδεμένοι με το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S πρέπει να παρακολουθούνται από έμπειρο ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευμένο βοηθητικό προσωπικό ή άλλο αντίστοιχο προσωπικό, επειδή ενδέχεται μερικές φορές να δημιουργηθούν καταστάσεις που απειλούν τη ζωή και οι οποίες μπορεί να μην ενεργοποιήσουν τους συναγερμούς. Ο χειριστής πρέπει να προσέχει όλα τα ενδεδειγμένα μηνύματα και τους συναγερμούς και να ακολουθεί τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις, τις επισημάνσεις προσοχής και τις σημειώσεις που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Είναι επιβεβλημένο το μηχάνημα να έχει περάσει τον έλεγχο λειτουργίας (FCH) προτού συνδεθεί σε αυτό ασθενής.

Κατά την εγκατάσταση όλοι οι έλεγχοι βαθμονόμησης πρέπει να ολοκληρώνονται πριν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί για την αιμοδιάλυση ασθενούς.

Το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S χρήζει ειδικών προφυλάξεων σε ότι αφορά την EMC και πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες EMC που υπάρχουν στο κεφάλαιο 9, "Τεχνικά δεδομένα και προδιαγραφές", στο μέρος 1.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κοντά στο μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του μηχανήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε το κεφάλαιο 9, "Τεχνικά δεδομένα και προδιαγραφές", στο μέρος 1.

Το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S θα λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί, μόνο αν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Gambro. Οποιοσδήποτε εγγυήσεις εκ μέρους της Gambro που αφορούν το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S παύουν να ισχύουν αν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Η Gambro δεν αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που προέκυψε από ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση ή από μη εξουσιοδοτημένη επιδιόρθωση.


Η προληπτική επιθεώρηση, συντήρηση και βαθμονόμηση του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S πρέπει να διενεργείται από πλήρως καταρτισμένο τεχνικό επισκευής, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συντήρησης του Εγχειριδίου Επισκευής για το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S, το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Gambro. Είναι υποχρεωτικό η προληπτική συντήρηση να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε δεύτερο χρόνο. Συνιστάται ετήσια συντήρηση. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαδικασίες προληπτικής συντήρησης ενδέχεται να ποικίλλει λόγω διαφορών στο περιβάλλον λειτουργίας.

Το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρο όπου υπάρχει εύφλεκτο αναισθητικό αναμιγμένο με αέρα ή με οξυγόνο ή με υπεροξείδιο του αζώτου.

Αν κάποιος συναγερμός, ο οποίος προκαλεί παράκαμψη του φίλτρου αιμοδιάλυσης για την επίτευξη ασφαλούς κατάστασης ασθενούς, εκκαθαριστεί επανειλημμένα χωρίς να επιλυθεί το υποκείμενο πρόβλημα, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η ανεπαρκής αιμοδιάλυση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200™ S

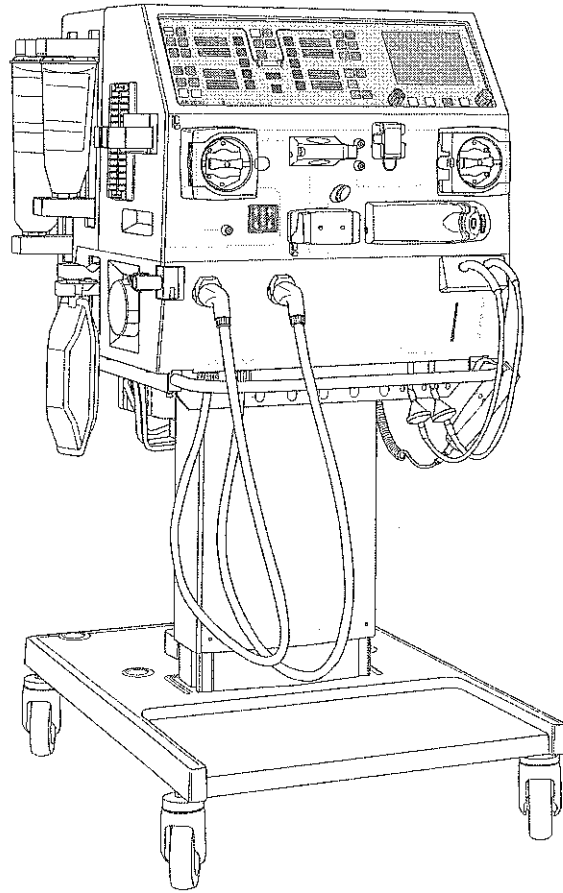

Εγχειρίδιο χειριστή

Για χρήση με την έκδοση προγράμματος 11.xx

Αριθμός παραγγελίας:
MHCEL9882-P11XX

Πνευματικά δικαιώματα:

Copyright © 2001-2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012 Gambro Lundia AB.

Εμπορικά σήματα:

Οι ονομασίες Gambro, AK 200 S, AK 200 ULTRA S, BiCart, BiCart Select, CleanCart, Diascan, Exalis, SelectBag και SelectCart αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στον Όμιλο Gambro.

Η ονομασία PEEK αποτελεί εμπορικό σήμα της Victrex plc.

Η ονομασία Dialox αποτελεί εμπορικό σήμα της L'Air Liquide.

Κατασκευαστής:

Gambro Lundia AB

Box 10101

Magistratsvägen 16

SE-220 10 LUND

Sweden

Τηλέφωνο +46 46 169000

www.gambro.com

Στοιχεία επικοινωνίας αντιπροσώπου πωλήσεων, (εάν εφαρμόζεται):

Για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την έκδοση, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στον κατασκευαστή.

Επάρκεια Μηχανικών Service

Υπάρχει ένα ορισμένο ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που απαιτείται για τους Μηχανικούς service που συντηρούν και επισκευάζουν προϊόντα Gambro, και συνοψίζεται ως εξής.

Ένας μηχανικός συντήρησης θεωρείται κατάλληλα ειδικευμένος, αν αυτός / αυτή έχει:

1. Παρακολουθήσει τεχνικό σεμινάριο για AK 200 S / AK 200 ULTRA S και του έχει δοθεί ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο τεχνικός έχει περάσει το μάθημα.
2. Πρόσβαση στο συνιστώμενο εξοπλισμό δοκιμών και τα ειδικά εργαλεία που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο service.
3. Πρόσβαση στα συνιστώμενα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στο AK 200S / AK 200 ULTRA S – Spare Parts List, HCEN 9288.
4. Πρόσβαση και κατανόηση στο εγχειρίδιο Χρήσης AK 200 S / AK 200 ULTRA S-

Maintenance

To ensure proper operation of the AK 200 S / AK 200 ULTRA S dialysis machine, a qualified service technician must perform a complete series of maintenance procedures at regular intervals.

The maintenance and calibration information that you need to use is provided in this Service Manual, refer to chapters Maintenance Manual and Calibrations

It is mandatory to perform at least a preventive maintenance every second year. A yearly maintenance is recommended. The rate of preventive maintenance might be different due to variations of the operating environment.

Competence of Service Engineers

There is a certain minimum level of competence required for Service Engineers who are to maintain and repair Gambro products, summarized as follows.

A Service Engineer is considered suitable qualified if he/she has:

1. Attended AK 200 S / AK 200 ULTRA S technical service course and has been given a certificate stating that the technician has passed the course.
2. Access to the recommended test equipment and special tools detailed in this Service Manual.
3. Access to the recommended spare parts, refer to AK 200 S / AK 200 ULTRA S - Spare parts List, HCEN9288.
4. Access to and understanding of the AK 200 S / AK 200 ULTRA S - Operator's Manual.

In general, this policy implies that training will be carried out by Gambro Lundia AB, while local markets are responsible for their own service organization.

Repair

Parts which are sent for repair shall be sent to the following address:

Gambro Lundia AB
Repair Shop
Magistratsvägen 16
SE-226 34 Lund
Sweden



ΕΘΝΟΣ.gr

Σάββατο, 11/10/2014

ΝΕΑ ΣΕ 10" ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΟΣΠΟΡ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝΘΕΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΙΡΩΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΟΣ On Line
01:04 12/11/2012

Α+ Α- Μέγεθος γραμμάτων

 Email Εκτύπωση
Μου αρέσει Tweet

ΤΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΤΩΡΑ



ΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΤΙΤΡΟΦΗ ΙΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΚΛΟΓΗ
πιχερίωση '180' με φετηρία τους 155 11/10

ΛΙΤΙΚΗ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

πιχερίωση '180' με φετηρία τους 155 11/10
ήφος εμπιστοσύνης με 55 «ναι» 11/10

αμαράς: Η Ελλάδα πορεί να βγει από το νημόνιο 1,5 χρόνο ωρίτερα 11/10

σίπρας: Εκλογές τώρα - ΣΥΡΙΖΑ δεν δεσμεύεται πδ συμφωνίες της βέρνησης 11/10

«μητέρα των μοχών» η Βουλή 10/10

ήφος εμπιστοσύνης: γκραυση Βενιζελου-σίπρα 10/10

ιζέλας: Σχέδιο εξόδου τδ την κρίση πριν την λογή Προέδρου 10/10

στ για τους εξάρτητους εν όψει της ιεδρικής εκλογής 10/10
μμένος: Εκλογές και τδ κυβέρνηση εθνικής 5ητας 10/10

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Σαμαράς: Είστε τα υπολείμματα της οπισθοδρόμησης και των συντεχνιών που καταρρέουν


Η ομιλία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, στην Κοινοβουλευτική συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2013



Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον αγαπητό μου κ. Τσίπρα. Δεν είστε το αύριο, κ. Τσίπρα. Δεν είστε ούτε το σήμερα ούτε το χθες. Είστε τα υπολείμματα της οπισθοδρόμησης και των συντεχνιών που καταρρέουν, κ. Τσίπρα. Και η Ελληνική κοινωνία δεν σας γεννάει, δικαιολογημένα την τρομάζετε και σας αποβάλλει η Ελληνική κοινωνία, κ. Τσίπρα. Κι όποιος δεν συμφωνεί μαζί σας δεν είναι ούτε καλός ούτε κακός κατ' ανάγκη μαθητής. Απλά υπεύθυνος πολιτικός είναι.

Και λυπάμαι για τον τρόπο με τον οποίο σήμερα αξιοποιήσατε αυτόν τον χρόνο εδώ στη Βουλή σε τέτοια κρίσιμη στιγμή. Δεν φέρατε άνεμο αλλαγής. Παλαιοκομματισμό φέρατε, από ένα κόμμα ασύντακτο, γεμάτο διαιρέσεις, χωρίς κανένα πρόγραμμα, καμιά απολύτως λύση. Αλλαγή και μπουλουίκ ασκέρ δεν πάνε μαζί.

Και μας ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας απόψε τη μεγάλη λύση. Όλοι περιμέναμε κάτι το νέο, ανέμενα ότι θα έδινε τη μεγάλη οικονομική λύση για το πρόβλημα της χώρας. Και τις μας ανακοίνωσε; Ότι απλά βρήκε τη λύση. Θα καταργήσει ότι έχει ψηφίσει αυτή η Βουλή. Είναι πραγματικά κάτι το καταπληκτικό.

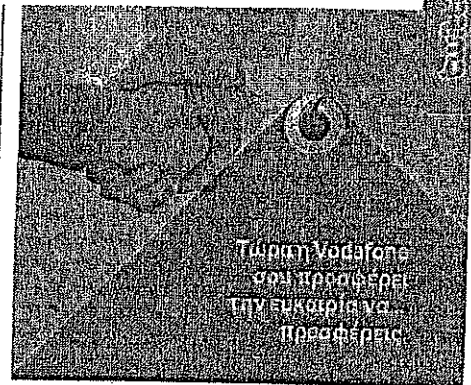

Τώρα η Νουάβλα σε σφι προσφέρει την ευκαιρία να προσφέρετε

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μαλλί με Μαλλί [«Ε» 10/10]

Εφάπαξ εξπρές για 50.000 συνταξιούχους [«Ε» 10/10]

Θρίλερ και σενάρια για τον Κιμ Πονγκ Ουν [10:05 10/10]

Πώς μεταδίδεται ο ιός Εμπολα [15:02 10/10]

«Η μικροκάμερα στο κράνος του Σουμάχερ ευθύνεται για την εγκεφαλική βλάβη» [16:14 10/10]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΕΘΝΟΣΠΟΡ

imerisia.gr | ΕΠΙΛΟΓΗ

Εξαγγελίες: Ρύθμιση χρεών έως 100 δόσεις - Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ, άμεση εκταμίευση 4 δις. από το ΕΣΠΑ -

Μηταράκης: Παντελής άγνωστοι του κ. Καμμένου για τον αναπτυξιακό νόμο 10/10


Κουβέλης: Ανάγκη εθνικής συνεννόησης για το χρέος 10/10

Γαπαρήγια: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν την άχνη του κουραμπιέ 10/10

Δένδιας: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται λεφτά που δεν υπάρχουν για να γίνουν όλοι πλουσιότεροι 11/10

Πυλιάνος του ΣΥΡΙΖΑ το κράτος δικαίου 10/10

Δύο ξένοι στην ίδια κυβέρνηση 10/10



Deal my Day

Σουβλάκια από το Δεκαοκτώ από το Grill House Δεκαοκτώ.

Αγόρασέ το 5€

Θα πρέπει, κ. Τσίπρα, πραγματικά να βγει από το κουτάκι με τα στερεότυπα και τις ιδεοληψίες σας.

Ευτυχώς που ο κόσμος σας άκουσε. Ευτυχώς που κατάλαβε ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Θα το πω με δυο λόγια για όποιους με ακούνε. Όποιος περνάει το κατώφλι του γραφείου σας είναι «ναι σε όλα» κι όταν έρχεστε εδώ πέρα είναι «όχι σε όλα». Το πιο εύκολο πρόγραμμα που υπάρχει, κ. Τσίπρα, έχετε διαλέξει.

Γι' αυτό και θα σας μείνουν πολλές οι συνιστώσες. Αλλά θα σας μείνει κι ο καημός, συνιστάμενη δεν θα αποκτήσετε ποτέ.

Αλλά για να μιλήσουμε με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι στιγμές, εγώ θα πω ξεκάθαρα ότι όλες αυτές οι πτέρυγες της Βουλής έχουν διαπράξει στο παρελθόν σφάλματα. Και πρέπει ο καθένας μας να το δεχθεί. Ακόμη και η δική σας η παρατάξη. Διέλυσε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, υπονόμησε την ίδια την ασφάλεια των πολιτών. Και στην ομιλία σας δεν είπατε ούτε για τους πολίτες αλλά ούτε για την οικονομική τους ανάκαμψη, μισή κουβέντα, μισή πρόταση, μισή λύση.

Η μεγάλη μας διαφορά λοιπόν είναι ότι εμείς δεχόμαστε ότι έχουμε γίνει σφάλματα κι ότι έχουμε κάνει κι εμείς σφάλματα. Αλλά εμείς έχουμε διδαχθεί από αυτά τα σφάλματα και τα διορθώνουμε ενώ εσείς παραμένετε, υπερασπίζεστε αυτά τα σφάλματα και μένετε αδιόρθωτος μέχρι τέλους. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ουσιαστική η διαφορά.

Πριν τέσσερις μόλις μέρες ψηφίσαμε την πιο σαρωτική μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα!

Κι εγώ θα ήθελα σήμερα να επισημάνω κυρίως τρία πράγματα σήμερα:

Πρώτον: Οι θυσίες που περιέχονται στο Πολυνομοσχέδιο που ψηφίσαμε και στον Προϋπολογισμό που πρόκειται να ψηφίζουμε, είναι και οι τελευταίες! Εφ' όσον βέβαια, εφαρμόσουμε όλα όσα νομοθετήσαμε. Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας που υπογράφουμε. Για πρώτη φορά...

Δεύτερον: Οι αδικίες, που πρώτος εγώ δέχθηκα ότι έχουν γίνει, θα αρχίσουν να επανορθώνονται μόλις βγούμε από τα ελλείμματα. Κι αυτό είναι μέρος της συμφωνίας που υπογράφουμε. Επίσης για πρώτη φορά...

Τρίτον: Τα χρήματα της δόσης των 31 δισεκατομμυρίων θα έλθουν έγκαιρα.

Θα έρθουν, κ. Τσίπρα, στο ακέραιο και με το παραπάνω. Και για αυτό το «παραπάνω» παλεύω συνεχώς.

Κάποιοι εδώ μέσα αμφισβητούν το ΑΝ θα έρθουν. Εγώ παλεύω για το «παραπάνω»!

Μπορεί το «λόμπυ της δραχμής» που βλέπει να χάνει το στοίχημα, να δίνει τις τελευταίες μάχες οπισθοφυλακών...

Αλλά η Ελλάδα έκανε αυτά που της ζητήθηκαν κι αυτό ομολογείται απ' όλους.

Τώρα ήλθε η ώρα των δανειστών να κάνουν κι εκείνοι αυτά που δεσμεύτηκαν.

Και θα το κάνουν...

Μπορεί κάποιοι εκτός Ελλάδας να δυσφορούν.

Μπορεί κάποιοι εντός Ελλάδας, σαν κι εσάς, να εύχονται «να μη πάrouμε τα λεφτά».

«Κούρεμα» στο αρχικό κεφάλαιο των δανείων "H" Online 11/10 09:21

A. Σαμαράς: Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση 1,8 χρόνο νωρίτερα - Εκλογές το 2016 "H" Online 11/10 00:55

A. Τσίπρας: Δεν βάζουμε την υπογραφή μας σε καμιά συμφωνία "H" Online 10/10 22:42

elle.gr | ΕΠΙΛΟΓΗ

Η μόδα τα βλέπει όλα παστέλ elle.gr

Το μπλε μαγιόκις απογειώνει το στιλ elle.gr

8 τσάντες σε funky αποχρώσεις που θα λατρεύετε elle.gr

Μοντέρνα ρούχα & αξεσουάρ με απίκαρισμένες λεπτομέρειες elle.gr

Ποντάρτε στους πιο αισθησιακούς τόνους του μοβ για

caranddriver.gr | ΕΠΙΛΟΓΗ

Ferrari F80America: Σε δέκα αντίστοιχα C&D 10/10

Όλα τα νέα μοντέλα του Παρισού (VIDEOS) C&D 1/10

Γράφημα με τις πωλήσεις ΙΧ στην Ελλάδα το 2014 C&D 10/10

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: «Ο,π γίνεται στο Παρίσι, μένει στο Παρίσι» (VIDEOS) C&D 4/10

Αγαπάτε το ΕΘΝΟΣ
Με 40% έκπτωση!
 Μπείτε στο www.ethnos.gr και αποκτήστε την ΠΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΕΘΝΟΣ. Αλλάξτε!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΘΝΟΣ ΓΝΩΜΗ
 Το κλειδί των εξελίξεων | «Ε» 10/10 | ...»

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 Η Βούληση του νομοθέτη | «Ε» 10/10 | ...»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
 Ευρώπη χωρίς σαφή κατεύθυνση... | «Ε» 10/10 | ...»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ
 «Μπάχαλο» το ΠΑΣΟΚ με «συνωμοσίες» και «πέμπτες φύλαγγες»! | «Ε» 10/10 | ...»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 Σκληρό παζάρι | «Ε» 10/10 | ...»

ΕΠΩΝΥΜΟΣ
 Βαθαίνουν οι ανισότητες | «Ε» 10/10 | ...»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

10% ΠΑΚΕΤΟ
 Μπείτε στο www.ethnos.gr

Και πραγματικά πρώτη φορά είδα τέτοιο φανατισμό αρχηγού Ελληνικού κόμματος στο να μην πάρουν τα λεφτά οι Έλληνες, να έχουμε πρόβλημα στην οικονομία. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, πρωτόφαντο.

Βισστήκατε να χαρείτε. Γιατί θα σας πικράνουμε.

Τα λεφτά θα τα πάρουμε! Κι ως προεξοφλείτε κάποιος σήμερα το αντίθετο.

Δεν περιμένω να ζητήσει κανένας συγγνώμη, σε λίγες μέρες, όταν θα τα πάρουμε.

Περιμένω όμως να καταλάβετε ότι το να δηλητηριάζετε τον Ελληνικό λαό συνέχεια, καλλιεργώντας την απελπισία, κερδοσκοπώντας στην απόγνωση ευχόμενοι τα χειρότερα, έχει κι ένα όριο. Και πραγματικά δεν κρύβω την έκπληξή μου, που βλέπω εκείνους που χθες μας έλεγαν να φύγουμε από το δάνειο, να μην το πάρουμε, ότι είναι κακό, να είναι πάλι οι ίδιοι, που ανεβαίνουν σήμερα στα κεραμίδια γιατί δεν ήλθε ακόμα η δόση του δανείου...

Εμείς απαντάμε στην απόγνωση που καλλιεργούν, με την Ελπίδα που δημιουργούμε.

Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα, οι πολίτες, η οικονομία θα ανακουφιστούν όταν έρθει η επόμενη δόση, μόλις δοθεί το μήνυμα διεθνώς ότι η Ελλάδα βρίσκεται ξανά μέσα στους στόχους της κι ότι έχει αποτραπεί οριστικά η επιστροφή στη δραχμή.

Όλοι καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση έχει αρχίσει και βελτιώνεται. Θα ανακεφαλαιώσουν οι τράπεζες, θα επιστρέψουν κι άλλοι οι καταθέσεις, θα αρχίσει να υπάρχει ρευστότητα και ανάσες για την οικονομία.

Βέβαια δεν το καταλαβαίνουν όλοι.

Τις τελευταίες μέρες είδα πολλούς να στενοχωριούνται εδώ πέρα. Μόνο που το «πόλυ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».

Κι άρχισαν εδώ μέσα να ευτελίζουν το Κοινοβούλιο, να το υποβιβάζουν σε Συνέλευση φοιτητών της δεκαετίας του '70. Να απειλούν επενδυτές να μην έλθουν στην Ελλάδα. Να απειλούν βουλευτές με «ειδικά δικαστήρια» και με δολοφονίες και με λιντσάρισμα ακόμα!

Τι ακριβώς προσπαθούν άραγε;

Να μας τρομάξουν;

Τον κόσμο τρομάζουν που καταλαβαίνει με τι επίπεδο αντιπολιτευσης έχει μπλέξει!



Μέχρι τώρα τους ενοχλούσε πολύ που τους λέγαμε, όπως το είπε και η κ. Παπαρήγα, ότι ανήκουν στο «λόμπυ της δραχμής».

Τις τελευταίες μέρες προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κάτι ακόμα χειρότερο: ότι αποτελούν το λόμπυ της παρανομίας. Που ονειρεύεται εμφύλιους σπαραγμούς!

Αυτά δεν μας προκαλούν κανένα φόβο. Μόνο θλίψη μας προκαλούν...

Γιατί θέλουμε όλους τους συναδέλφους ενωμένους στην Αναγέννηση της χώρας.

Κι είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να προχωρήσουμε αφήνοντας πίσω κάποιους που ονειρεύονται να οδηγήσουν την Ελλάδα στον

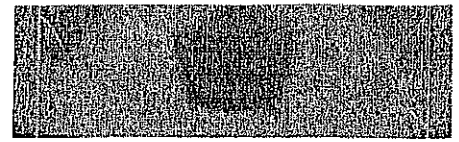

news.e-go.gr
ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Διεθνή ΜΜΕ: Θησαυροί στον «Τιτανικό» του αρχαίου κόσμου...



ΣΙΝΕΜΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Λεά Σεντού είναι το νέα κορίτσι του Τζέιμς Μποντ...



Car and Driver
ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΑΑ
Ferrari F60America: Σί δέκα αντίτυπα...



tech.e-go.gr
INTERNET
Σέξι κορίτσια πλένουν τις ντάλικες στην Κοζάνη (βίντεο)...

facebook

google

twitter

Γνωρίστε το Ισλάμ

© islamhouse.com

τη θρησκεία του μονοθεϊσμού τη θρησκεία όλων των προφητών

Marketing Plan Sample

Dolce Gusto Κάψουλες Καφέ

Χαλιά Υψηλής Ποιότητας

Εισάγετε εδώ το mail σας



Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι κάντε κλικ [εδώ](#)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιαδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια και εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Copyright © 2011 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.

όλεθρο.

Μπορεί να καταδημαγωγείτε τον πόνο του Ελληνικού λαού.

Αλλά δεν θα καταφέρετε ούτε να ανακόψετε τη μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας, ούτε να διχάσετε την κοινωνία.

Κι αυτό, θα το καταλάβετε απόψε και με την εκλογή και με την ψηφοφορία.

Στο Πολυνομοσχέδιο που ψηφίσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιέχονταν περικοπές και μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές.

Οι άδικες περικοπές, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν μισθούς, συντάξεις και ορισμένα κοινωνικά επιδόματα, όπως εξήγησα και προχθές, θα αποκατασταθούν μόλις βγούμε από τα ελλείμματα.

Αλλά οι μεταρρυθμίσεις που περάσαμε είναι μόνιμες. Και θα δώσουν πραγματικά μεταρρυθμιστική δυναμική στην Ελληνική Οικονομία.

Ενώ με τον Προϋπολογισμό του επομένου έτους, του 2013, που ψηφίζουμε απόψε, κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα για να πιάσουμε τους στόχους μας και να αντιστρέψουμε την ελεύθερη πτώση στην οποία έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια, η Ελληνική οικονομία την τελευταία τριετία.

Η μεταρρύθμιση βέβαια πολλούς τους ενοχλεί, γιατί ξέρουν ότι είναι μόνιμη.

Και γι' αυτό έχουν εξαπολύσει ένα όργιο δημαγωγίας.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Τα Ελληνικά νοσοκομεία αγόραζαν ως πρόσφατα τα φίλτρα για τις μονάδες τεχνητού νεφρού προς 35 ευρώ το ένα. Την ίδια στιγμή στην Κύπρο και σε άλλες χώρες τα ίδια φίλτρα έκαναν προς 8 ευρώ το ένα! Κι αυτό είναι μόνο ένα τυπικό παράδειγμα. Από χιλιάδες παρόμοια! Καταλαβαίνετε το τεράστιο πάρτι που γινόταν σε όλα τα υλικά της δημόσιας υγείας. Αυτό πια κόβεται με το μαχαίρι.

Ήδη υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση στις τιμές των φαρμάκων. Πόση εξοικονόμηση; 420 εκατομμύρια για τα δημόσια νοσοκομεία σε ετήσια βάση. 150 εκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία. Και άλλα 150 εκατομμύρια για την ιδιωτική δαπάνη σε φάρμακα.

Άραγε, αυτή η μεταρρύθμιση δεν έπρεπε να γίνει; Δεν πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν; Δεν πρέπει να προχωρήσει σε όλα τα υλικά της δημόσιας υγείας πέρα από τα φάρμακα;

Αυτό ακριβώς κάνουμε! Κι αυτό ακριβώς προσπαθούν να εμποδίσουν κάποιοι...

Να σας πω και κάπ ακόμα: Κι εμείς περάσαμε στη θέση της Αντιπολίτευσης επί δύο χρόνια περίπου. Κι εμείς εκφράσαμε διαφωνίες, κάναμε την κριτική ως προς το θέμα της ύφεσης που λέγατε και δικαιωθήκαμε.

Αλλά προσέξτε: τις διαρθρωτικές αλλαγές, στις οποίες πιστεύουμε, τις ψηφίζαμε τότε όλες! Και τις περικοπές δημόσιας σπατάλης, όχι μόνο τις ψηφίζαμε όταν τις έφερνε η τότε κυβέρνηση, αλλά τις προτείναμε πριν τις φέρει η κυβέρνηση. Και τις αποκρατικοποιήσεις τις προτείναμε και τις ψηφίζαμε. Και την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, το θυμάστε καλά, εμείς τη βάλαμε στη δημόσια συζήτηση...

Τότε τα ψηφίζαμε και τώρα τα υλοποιούμε και τα πάμε πιο πέρα, γιατί όλα αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό. Κι έπρεπε να τα έχουμε κάνει χωρίς να μας τα ζητήσει κανείς. Κι αν είχαν γίνει αυτά στην ώρα τους, δεν θα φτάναμε στο σημείο σήμερα να κόβουμε μισθούς και συντάξεις.

Αποδείξαμε τα προηγούμενα χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αντιπολίτευση δεν σημαίνει «όχι σε όλα».

Και κυρίως, Αντιπολίτευση δεν σημαίνει να υπονομεύουμε με κάθε τρόπο της αξιοπιστία της χώρας.

Από την αρχή επιμέναμε σε τρία πράγματα: να διατηρήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, η μείωση της σπατάλης και οι αποκρατικοποιήσεις που έχει τόσο ανάγκη η Ελλάδα να γίνουν. Και να συμπληρωθούν τα μέτρα λιτότητας με μέτρα, προϋποθέσεις και άμεσες προοπτικές ανάκαμψης: Πρωτογενής τομέας – τουρισμός – πολιτισμός – ορυκτός πλούτος – ενέργεια – καινοτομία – ψηφιακός κόσμος. Γιατί χωρίς ανάκαμψη, δεν μπορεί να δουλέψει κανένα πρόγραμμα.

Κι από την πρώτη στιγμή λέγαμε, ακόμα κι όταν διαφωνούσαμε, ότι θα σεβαστούμε τις υπογραφές, ναι, πράγματι, το είπαμε, που βάζει η χώρα. «Γιατί το κράτος έχει συνέχεια και οι Έλληνες έχουν φιλότιμο».... Και το είχα πει, ναι και ορθώς το είχα πει.

Αυτά υποστηρίζαμε ως Αντιπολίτευση. Αυτά υλοποιούμε ως κυβέρνηση. Και μάλιστα όχι μόνοι μας. Όλοι μαζί.

Γιατί η χώρα ή θα βγει ενωμένη από την κρίση ή δεν θα βγει καθόλου.

Κι εμείς δείχνουμε λοιπόν, ότι μπορούμε να ενώσουμε τη χώρα.

Όταν άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν να τη διχάσουν.

Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Να τη διχάσουν!

Αυτό ξέρουν να κάνουν ίσως: να διχάζουν...

Δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Και το παραδέχονται μόνοι τους.

Δεν έχουν προτάσεις. Κι όταν κάνουν το λάθος να διατυπώσουν κάποια πρόταση, προκαλούν πανικό και συνήθως σπεύδουν να τη μαζέψουν.

Και δεν ξέρουν να επιτυχάνουν συγκλίσεις. Θα μου πείτε, μέσα στο κόμμα τους δεν έχουν ίδια γραμμή. Θα ενώσουν ποτέ και τον κόσμο παράξω;

Ξέρετε, γι' αυτό υπάρχει το Κοινοβούλιο: για να ελέγχεται η εξουσία, αλλά και για να επιτυγχάνονται ευρύτερες συγκλίσεις.

Όχι για να καταγγέλλει και να απειλεί ο ένας τον άλλο, την ώρα που χάνεται η χώρα...

Μιλάνε για «συνέπεια»...

Να τους πω τι θα πει συνέπεια:

Το αρχικό οικονομικό μίγμα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα είχε ορισμένα πράγματα σοβαρά προβλήματα: Μεγάλωνε το χρέος. Επέβαλλε υψηλά επιτόκια. Δεν έδινε έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ούτε έδινε έμφαση στις αποκρατικοποιήσεις και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Το αποτέλεσμα ποιο ήταν το ξέρουμε. Πρακλήθηκε δυσανάλογα μεγάλη ύφεση. Και να βυθίστηκε η χώρα σε ένα φαύλο κύκλο



που αδήγησε σε παράλυση της Οικονομίας.

Εκφράσαμε τη διαφωνία μας γι' αυτό το μείγμα πολιτικής. Εντός κι εκτός Ελλάδας...

Τότε επικρίναμε το σφάλμα.

Τώρα, όμως, διορθώνουμε το σφάλμα! Και μάλιστα όλοι μαζί...

Κι αυτό κάνει τώρα τη μεγάλη διαφορά:

Με τη σύμβαση του περασμένου Μαρτίου, μειώσαμε το συνολικό χρέος με το «κούρεμα», ενώ μειώθηκαν και τα επιτόκια που πληρώνουμε. Σήμερα – επιτέλους – δίνουμε έμφαση στον τομέα που πρέπει, στις διαρθρωτικές αλλαγές, στις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Κι έτσι ανοίγει ο δρόμος για να ξαναγίνει βιώσιμο, που διερωτήθηκε προηγουμένως ο κ. Τσίπρας, το χρέος της Ελλάδας. Ωστε να επανέλθουμε στις αγορές και να απαλλαγούμε από όρους και μνημόνια.

Τώρα, μάλιστα, κάνουμε και το επόμενο βήμα: επισπεύδουμε την Ανάκαμψη της Οικονομίας.

Στον Προϋπολογισμό που καταθέτουμε, η επίσημη πρόβλεψη είναι για ύφεση 4,2% και για μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα. Μικρότερη, βέβαια, από τη φετινή ύφεση, αλλά ύφεση...

Εμείς, όμως, σχεδιάζουμε να ξεπεράσουμε αυτούς τους στόχους.

Πώς θα γίνει αυτό; Απλούστατα, για πρώτη φορά την επόμενη χρονιά, τα λεφτά που θα βγουν από την οικονομία, λόγω της πρόσθετης λιτότητας, δηλαδή τα 9,4 δισεκατομμύρια, θα είναι λιγότερα από εκείνα που θα μπουν στην οικονομία: γύρω στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ! Τα μισά απ' αυτά θα είναι από την επιστροφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες. Τα οποία θα δώσουν μεγάλη ανακούφιση. Κι ένα πρώτο σκέλος αυτής της ανακούφισης πιστεύω ότι θα δοθεί τους επόμενους μήνες...

Έτσι προσπαθούμε η ύφεση να είναι μικρότερη απ' αυτήν που προβλέπει ο Προϋπολογισμός. Και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο. Δηλαδή, όχι μηδενικό, αλλά να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα από το 2013.

Μέχρι πρόσφατα, η οικονομία παρέλυε από την αδυναμία του κράτους να πληρώσει τις οφειλές του και από την αδυναμία των τραπεζών να δώσουν ρευστότητα, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου ανάσες στην οικονομία, καρκινοβατούσαν οι διαρθρωτικές αλλαγές παγαίναμε με αβεβαιότητα στην έξοδο από το ευρώ. Σε αυτό που λέγεται δραχμοφοβία.

Τώρα, με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα φύγει η αβεβαιότητα, θα επιστρέψει ξανά η ρευστότητα και θα ανοίξουν οι κάνουλες του τραπεζικού δανεισμού. Έτσι θα μπορέσει να γίνει και η ρύθμιση των οφειλών για τους δανειολήπτες. Κι αυτό από μόνο του θα είναι μια μεγάλη ανάσα.

Ακόμα θα μπορέσουν να πάρουν κεφάλαιο κίνησης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν χωρίς ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Κι αυτό θα είναι πρόσθετη ανάσα.

Ακόμα, με την επιστροφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, θα σωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα δοθούν πρόσθετες ανάσες στην οικονομία. Και θέλω να είναι ξεκάθαρο, από αύριο μάλιστα, εγώ προσωπικά γυρίζω κεφάλαιο. Δεν θα περιμένω τις επενδύσεις. Θα τις κυνηγήσω τις επενδύσεις και μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Με οργάνωση και κινητοποίηση της οικονομικής διπλωματίας. Δεν χρειάζεται να

ανακαλύψουμε την Αμερική. Αρκεί να δούμε το παράδειγμα της Ιρλανδίας και άλλων χωρών που το έκαναν και πέτυχαν.
Προτεραιότητά μας λοιπόν: Ολοκληρώνοντας τη μάχη για το δάνειο στην Ευρώπη ξεκινάμε τη μάχη για ανάκαμψη και ανάπτυξη μέσα στην Ελλάδα! Και όλα αυτά σημαίνουν συνέπεια:

Αυτά που επισημαίναμε ως προβλήματα, τα λύνουμε τώρα ένα-ένα.

Δεν παίζουμε θέατρο εδώ μέσα, όπως ορισμένοι...

Λύσεις αναζητούσαμε, λύσεις προωθούσαμε και τώρα λύσεις δίνουμε.

Σφάλματα εντοπίζαμε και τώρα σφάλματα διορθώνουμε.

Στήριξη σε ό,τι θετικό προσφέραμε. Και τώρα ό,τι στηρίζαμε το πάμε πολύ πιο πέρα.

Την Ελλάδα μέσα στο ευρώ τη θέλαμε κι αυτό διασφαλίζουμε.

Στην ανάκαμψη δίνουμε την απόλυτη προτεραιότητα και αυτό κάνουμε σήμερα.

Ενότητα υποσχόμασταν και ενότητα υπηρετούμε.

Μεταρρυθμίσεις προωθούσαμε και μεταρρυθμίσεις υλοποιούμε.

Την αξιοπιστία της χώρας μας υπερασπιζόμασταν και την αξιοπιστία της χώρας μας αποκαταστήσαμε.

Τι απ' όλα αυτά κάνει η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση;

Τίποτε απολύτως!

Ποιες προτάσεις-διατύπωσε; Καμία απολύτως!

Στείρα άρνηση! Και βέβαια, ακατάσχετη υποσχαιολογία προς πάσα κατεύθυνση!..

Χαϊδεύετε τα αυτιά ακόμα και προνομιούχων ομάδων.

Εκμεταλλεύεστε τον ανθρώπινο πόνο και απειλείτε ταυτόχρονα τους πάντες...

Δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Άλλωστε, ξέρετε ότι δεν μπορείτε...

Τα συνθήματά σας είναι δύο:

—«Όχι σε όλα!»

—Και ... «γιαία πυρί μειχθήτω»!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όλες αυτές οι δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2013, δεν είναι «ευσεβείς πόθοι». Είναι σχεδιασμένα και καλά προετοιμασμένα βήματα.

Για παράδειγμα, όλοι οι υπολογισμοί που έχουν γίνει για την εκπόνηση αυτού του Προϋπολογισμού στηρίζονται στα πιο συντηρητικά σενάρια. Όχι στα πιο ευνοϊκά.

Δεν λαμβάνουν υπ' όψιν, για παράδειγμα, την επιστροφή των καταθέσεων που θα τροφοδοτήσει πρόσθετες δυνατότητες ρευστότητας στην αγορά. Δεν λαμβάνουν υπ' όψιν ότι η οριστική απομάκρυνση της «δραχμοφοβίας» θα ενθαρρύνει επενδύσεις από το εξωτερικό και την επιστροφή των καταθέσεων από το



εξωτερικό. Κι όλα αυτά, ασφαλώς, θα δώσουν πρόσθετη ώθηση στην αγορά, θα φρενάρουν κι άλλο την ύφεση, θα ανακόψουν την ανεργία, θα προσφέρουν φορολογικά έσοδα στο δημόσιο ταμείο, αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά δεν τα περιλαμβάνουμε επίσημα στον Προϋπολογισμό που κατατίθεται απόψε.

Συνήθως οι προϋπολογισμοί στηρίζονται στα πιο ευνοϊκά σενάρια, και γι' αυτό συνήθως κατά κανόνα διακινδυνεύουν! Η πραγματικότητα εμφανίζεται τελικά χειρότερη απ' ό,τι την προέβλεπαν εκ των προτέρων...

Εμείς, για πρώτη φορά, κάνουμε το αντίθετο: Στηρίζουμε τον Προϋπολογισμό σε πολύ συντηρητικά σενάρια, κι έτσι ξέρουμε ότι η πραγματικότητα θα εμφανίσει καλύτερα αποτελέσματα στο τέλος. Κι έτσι η χώρα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες, όχι μόνο να πιάσει τους στόχους της, αλλά και να τους ξεπεράσει. Και να ενεργοποιήσει έτσι τη «ρήτρα ανακούφισης» κάποιων αδικιών, όπως εξήγησε νωρίτερα στην ομιλία του ο κ. Κουβέλης, ώστε να στηριχθεί ακόμα περισσότερο η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.

Και κάτι τελευταίο εδώ: αυτή η φιλοδοξία να πύμε καλύτερα από τους στόχους είναι κάτι που ήδη άρχισε να γίνεται, τους προηγούμενους μήνες. Βρισκόμαστε ήδη εντός στόχων!

Πιο συγκεκριμένα, το πρωτογενές έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού το 1ο δεκάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 1,2 δισ. ευρώ, έναντι 5,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κι αυτό είναι θεαματική πρόοδος.

Ειδικά για το μήνα Οκτώβριο, εμφανίστηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 900 εκατομμυρίων.

Στο φετινό δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού έπεσε στα 12,3 δισεκατομμύρια, από 21,1 δισεκατομμύρια πέρσι στο αντίστοιχο διάστημα!

Επίσης, στο πρώτο δεκάμηνο τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,4%, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες εμφανίζουν μείωση κατά 8,5%.

Και το μήνα Οκτώβριο οι δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διπλασιάστηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του Οκτωβρίου του 2011. Πράγμα που δείχνει ότι αρχίζουν και ξεμπλοκάρουν παγωμένα κονδύλια για δημόσια έργα.

Κι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο ή μεμονωμένο. Αντίθετα, υπάρχουν πολλαπλές ενδείξεις ότι έχουν αρχίσει να ξεπερνιούνται μακροχρόνια αδιέξοδα της Ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα:

—Η απόδοση των Ελληνικών ομολόγων έχει μειωθεί σημαντικά. Και τα περιβόητα spreads έχουν υποχωρήσει...

—Ενώ, κατά την πρόσφατη έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου το επιτόκιο 4,41%, αποτελεί το χαμηλότερο που πετύχαμε, από τις αρχές του 2010.

Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι κάτι αλλάζει στη χώρα και να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

Και το πιο σημαντικό ίσως:

—Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια βελτίωσης.

Σας ανέφερα προχθές ότι η Ελλάδα ανέβηκε 11 θέσεις από πέρσι στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας.



Στη διεθνή κατάταξη των χωρών, σύμφωνα με το δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο: κατά 22 θέσεις σε σχέση με πέρσι!

Κι αυτά σημαίνουν ότι ανοίγει ο δρόμος για να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και να ανακοπεί η ανεργία.

—Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, επιτυγχάνοντας τον Αύγουστο πλεόνασμα 1,6 δισ. Ευρώ.

Η αντιστροφή της τάσης δεν είναι πλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι που το ευχόμαστε ή το υποθέτουμε. Είναι κάτι που έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει.

Για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα χρειάζεται και κάτι ακόμα. Εμείς εδώ μέσα να μείνουμε στέρεοι, αποφασισμένοι και ενωμένοι...

Πάρτε για παράδειγμα αυτό που έγινε προχθές με τους εργαζόμενους στη Βουλή:

Σας ρωτώ και μου αρέσει η ευθεία γραμμή: είναι λογικό οι υπάλληλοι της Βουλής να παίρνουν εφ' άπαξ... 8 φορές μεγαλύτερο από αυτό των δημοσίων υπαλλήλων;

Γι' αυτό καθιερώθηκε η αυτονομία της Βουλής;

Για να πληρώνει οκταπλάσιο εφ' άπαξ;

Για να θωρακιστεί η Δημοκρατία καθιερώθηκε και σ' αυτό επιμένουμε.

Φυσικά δεν πρόκειται να παραβιαστεί το Σύνταγμα.

Ασφαλέστατα, το Αυτοδιοίκητο της Βουλής είναι απόλυτα σεβαστό.

Το αυτοδιοίκητο της Βουλής, ναι! Και θα παραμείνει.

Για σκεφθείτε: Και η Δικαιοσύνη δεν έχει το αυτοδιοίκητο; Αλλά οι μισθοί και οι συντάξεις των δικαστών καθορίζονται από την κυβέρνηση.

Ασφαλώς οι δικαιολογημένες υπερωρίες των υπαλλήλων της Βουλής είναι απολύτως σεβαστές. Αλλά η Πολιτεία, κυρίες και κύριοι, θα αποφασίζει για τα οικονομικά τους.

Όλοι εκτιμούμε το έργο των υπαλλήλων της Βουλής. Όπως εκτιμούμε και το έργο πολλών άλλων λειτουργών του δημοσίου: των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των δικαστικών, των δασκάλων, των πανεπιστημιακών, των γιατρών. Που όλοι τους υφίστανται περικοπές...

Όταν, λοιπόν, η χώρα είναι βυθισμένη σε ελλείμματα κι όταν γίνονται περικοπές σε όλους, πώς είναι δυνατό κάποιος να εξαιρούνται;

Και κάτι τελευταίο: εδώ εκπροσωπούμε την κοινωνία. Τις ραπές, τα συναισθήματα, τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Άρα, να αναρωτηθούμε: Η κοινωνία τι λέει για όλα αυτά; Τι μας ζητάει;

Να εξαιρέσουμε κάποιους όταν στενάζουν όλοι;

Ή να μοιράσουμε τις θυσίες σε όλους, ώστε να βγούμε από την ανάγκη μια ώρα αρχύτερα; Για να μη παρέσουμε στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε, όπως είπα, τις αδικίες. Και να θεμελιώσουμε πραγματικά δικαιώματα για όλους.



Αλλά δικαιώματα. Όχι σκανδαλώδη προνόμια...

Τώρα βέβαια, κάποιοι μιλούν για «επικήδειους». Και επιχαίρουν...

Αυτό που τελειώνει πολιτικά και δεν καταλαβαίνουν είναι οι ίδιοι και η νοοτροπία τους.

Εμείς στηρίζουμε την αστική, λαϊκή, δημοκρατική Ελλάδα.

Και βρισκόμαστε πράγματι στην αρχή μιας νέας Επανάστασης.

Μόνο που η δική μας πολιτική είναι η ενότητα: Ενώνουμε το λαό.

Σήμερα κυβερνάμε τρία κόμματα με διαφορετικές αφηγήσεις, καταβολές και ιστορία. Δύσκολο, αλλά πετυχημένο εγχείρημα, για το καλό του τόπου και της πατρίδας!

Ενώ εκείνοι, αντιπροσωπεύουν δυνάμεις που δεν μονιάζουν και δεν μπορούν να μονιάσουν. Δεν ελέγχονται καν. Γι' αυτό υπάρχει εδώ μέσα πολλές φορές το γνωστό παραλήρημα.

Και αφού το 'φερε ο λόγος για επαναστάσεις, μεγάλες επαναστάσεις στην Ελλάδα ήταν το μεταρρυθμιστικό εθνικό έργο ενός Χαρίλαου Τρικούπη, ενός Ελευθερίου Βενιζέλου κι ενός Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Δεν είχαν «συνιστώσες» αυτοί, κ. Τσίπρα. Είχαν όραμα.

Δεν χάζιδευαν τα αυτιά του πλήθους. Εξυπηρετούσαν το εθνικό συμφέρον.

Δεν διαφύλατταν προνόμια. Καταργούσαν προνόμια.

Δεν έκλειναν τους δρόμους της πόλης. Άνοιγαν δρόμους για την Ελλάδα.

Και για να έλθουμε στο τώρα, έχουμε την πιο προικισμένη νέα γενιά. Δεν πρόκειται όσο και το θέλατε, να τη χαρίσουμε στην ξενιτιά! Γι' αυτό χρειάζονται όχι κηρύγματα μισαλλοδοξίας και εμπρηστικά συνθήματα, αλλά Ανάπτυξη, Επενδύσεις, θέσεις εργασίας, αποκρατικοποιήσεις.

Σήμερα ως τις 5 το απόγευμα τερμάτιζαν στο Μαραθώνιο της Αθήνας όσοι δεν τα παρατάνε στα δύσκολα. Αυτοί που έχουν δύναμη ψυχής. Αυτοί που πιστεύουν στο όνειρο να κόψουν το νήμα. Έτσι είναι και η Ελλάδα μας σήμερα. Μια μεγάλη δύσκολη προσπάθεια που μας ενώνει. Δεν μας διχάζει, όπως θέλουν μερικοί.

Μιλούν για «εθνική ανεξαρτησία» και «εθνική αξιοπρέπεια». Μπορεί να έχει ανεξαρτησία, κυριαρχία και αξιοπρέπεια μια χώρα όταν χρειάζεται κάθε τόσο δανεικά για να περνάει; Για να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία μας ως χώρα, πρέπει πρώτα να καλύπτουμε τις δαπάνες μας, να βγάλουμε τα περίφημα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αυτό προσπαθούμε. Κι εκείνοι είναι απέναντι.

Επαίτες θέλετε τους Έλληνες μέσα στην Ευρώπη;

Ή μήπως μας θέλετε απομονωμένους, εκτός Ευρώπης; Υπάρχει κάποιος ήρωας να μας σώσει; Κάποιος Τσάβες; Υπάρχει υποψηφιότητα ήρωα να μας σώσει;



Εμείς θέλουμε το λαό μας υπερήφανο και ανταγωνιστικό, μέσα στην Ευρώπη.

Διαμαρτύρονται κάποιοι για κινδυνολογία: ότι εμείς τάχα... «κινδυνολογούμε»...

Εμείς κινδυνολογούμε;

Τα δικά τους λόγια τα ακούν;

Δεν είναι επικίνδυνο να απειλεί κανείς, όσους θέλουν να επενδύσουν στη χώρα;

Δεν είναι επικίνδυνο να απειλεί κανείς τους βουλευτές, εδώ μέσα, με Ειδικά Δικαστήρια, με δολοφονίες και λιντσάρισμα;

Έχετε συναίσθηση αιτών που έχετε πει τον τελευταίο καιρό στη Βουλή των Ελλήνων;

Γιατί αν έχετε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι.

Κι αν δεν έχετε και απλώς παραληρείτε, τότε είστε δύο φορές επικίνδυνοι.

Όλοι συμφωνούμε ότι όποιος επικαλείται ανύπαρκτους κινδύνους, είναι φοβικός ή κινδυνολόγος.

Αλλά ισχύει και το ακριβώς αντίστροφο:

Όποιος αγνοεί υπαρκτούς κινδύνους, είναι αφελής ή επικίνδυνος.

Εδώ μέσα κάποιοι αγνοούν αληθινές απειλές, όχι απλούς κινδύνους. Μιλώ για τη δραχμή.

Σας το είπαν οι Σοσιαλιστές της Ευρώπης.

Σας το είπαν και οι Πράσινοι της Ευρώπης...

Ακόμα και οι φίλοι σας το λένε ξεκάθαρα:

Ότι οδηγείτε την Ελλάδα εκτός ευρώ!

«Κινδυνολογία» είναι κι αυτοί;

Τώρα μας κατηγορούν ότι ήλθε αυτή η κυβέρνηση και μέσα σε λίγες μέρες πάει να αλλάξει τα πάντα. Μα ακριβώς!

Θυμίζω στους ειδικούς ότι ο Λένιν, είχε πει το εξής. Μην το δείχνετε ότι ενοχλείστε, κρατηθείτε...

— «κάποτε περνάνε δεκαετίες χωρίς να γίνεται τίποτε. Και ξαφνικά γίνονται τα πάντα μέσα σε λίγες μέρες».

Τέτοιες μέρες περνάμε κ. Τσίπρα! Σε λίγες μέρες αλλάζουμε όσα δεν άλλαξαν σε δεκαετίες. Κι εσάς σας έχουμε απέναντι...

Γι' αυτό σας είπα: Η Επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα είμαστε εμείς κι είναι αυτό που έχει ήδη αρχίσει!

Εσείς βρείτε το μόνι σας τι είστε:

Επαναστάτες μόνον κατά φαντασία; Επαναστάτες χωρίς αιτία;

Ή μήπως η Επανάσταση ξεκίνησε χωρίς εσάς κι εσείς προσπαθείτε να την εμποδίσετε;



Κυρίες και Κύριοι Συνάδερφοι,

Από τη σημερινή συζήτηση δεν αναδείχθηκαν μόνο οι διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ μας. Αναδείχθηκε και το ποιους εκπροσωπούμε εδώ μέσα:

Ακούστε, τρεις μεγάλες κατηγορίες έμεναν στην Ελλάδα ανεκπροσώπητες επί πολλά χρόνια.

• Πρώτα οι αγέννητοι. Αυτοί στους οποίους ρίχναμε συνέχεια τα βάρη της δικής μας ψεύτικης ευμάρειας. Επί χρόνια η χώρα σκόρπαγε λεφτά που δεν έβγαζε. Δεν τα επένδυε. Τα δανειζόταν και τα καταλάωνε. Και τα φόρτωνε στις επόμενες γενιές. Σε εκείνους που ήταν ακόμη αγέννητοι τότε...

Αλλά οι πριν από 35 χρόνια «αγέννητοι», τώρα είναι παρόντες. Φτάνει λιγότερο απ' όλους. Κι όμως, είναι εκείνοι που σήμερα καλούνται «να πληρώσουν σήμερα το μάρμαρο» ...

• Ύστερα οι άνεργοι. Όλοι έδειχναν να νοιάζονται για τα «συμφέροντα των εργαζομένων». Κι αυτό κατόντησε στερεότυπο. Αλλά κανείς δεν νοιαζόταν για τα συμφέροντα των ανέργων, που όσο πάνε και πληθαίνουν. Που θα βρουν δουλειά; Όλοι αυτοί, αν δεν έλθουν επενδύσεις, αν δεν υπάρξει Ανάπτυξη; Διώχοντας επενδύσεις και διαιωνίζοντας τη δημόσια σταπάλη και το πάρτυ των επιτηδείων;

• Τέλος, τα παιδιά μας. Τι μέλλον έχουν τα παιδιά μιας πατρίδας που μαραζώνει, μιας οικονομίας που χάνει συνεχώς την ανταγωνιστικότητά της;

Εγώ, αυτές τις τρεις κατηγορίες που έμεναν για χρόνια ανεκπροσώπητες, έχω συνεχώς στο μυαλό μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Αλλά ορισμένους, φαίνεται να μην τους απασχολεί καν το θέμα...

— Όμως, όποια κοινωνία δεν σκέπτεται τους αγέννητους, δεν έχει όραμα.

— Όποια κοινωνία δεν σκέπτεται τα παιδιά της, δεν έχει αύριο.

— Κι όποια κοινωνία δεν σκέπτεται τους ανέργους της, δεν έχει καρδιά.

Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν είναι πια ανεκπροσώπητες.

Τους εκπροσωπούμε εμείς, όσοι στηρίζουμε τη σημερινή κυβέρνηση. Όπως εκπροσωπούμε κι όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που θέλουν ένα καλύτερο μέλλον σε μια ανταγωνιστική Ελλάδα, με μια σύγχρονη δημοκρατία, μέσα στην Ευρώπη.

Ας παραμείνουν να εκπροσωπούν κάποιοι άλλοι, τα προνόμια που καταργούνται, τις στρεβλώσεις που εξαλείφονται, τα στερεότυπα και τις ιδεοληψίες που χρεοκόπησαν και το χθες που πεθαίνει.

Ανήκουν στο χθες! Είναι παγιδευμένοι στις εμμονές του χθες και αντιστέκονται σε ό,τι λυτρώνει την Ελλάδα, σε ό,τι απελευθερώνει τις δυνάμεις της...

Μιλούν συνεχώς για τον «εφιάλητη» που ζούμε σήμερα.

Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι μέρος αυτού του εφιάλητη.

Λυπάμαι, λυπάμαι ειλικρινά γ' αυτό...

Αλλά η χώρα θα βγει από τον εφιάλητη.

Και η αποψινή ψηφοφορία αυτό θα δείξει.

Το πιο δύσκολο στοίχημα είναι να ενωθούμε στα δύσκολα.

Επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το λέω:

Απ' αυτή την κρίση ή θα βγούμε ενωμένοι, ή δεν θα βγούμε καθόλου!

Σας καλώ απόψε, να δείξουμε σε όλους, ότι οι Έλληνες θα βγούμε ενωμένοι..

Σας καλώ να στείλουμε το μήνυμα της ενότητας απ' αυτήν εδώ την αίθουσα παντού:

-Μέσα στην Ελλάδα, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος κι έχει ανάγκη να μας ακούσει ενωμένους ο Ελληνικός λαός.

-Κι έξω από την Ελλάδα, για να κλείσουμε τα στόματα κάποιων μια για πάντα.

Ξέρετε, η ενότητα εδώ μέσα δεν είναι μια λέξη μόνο...

Δεν είναι άθροισμα ψήφων.

Είναι φρόνημα λαού.

Είναι δύναμη Αναγέννησης ενός έθνους.

Είναι ώθηση ανόρθωσης μέσα στη χώρα...







και διαπραγματευτική ισχύς προς τα έξω.

Η ενότητα είναι η υπέρτατη αρετή σε ώρες ανάγκης.

Αυτήν την αρετή μας καλεί απόψε ο Ελληνικός λαός να δείξουμε.

Αυτήν του χρωστάμε.

Και αυτήν θα του δώσουμε με την ψήφο μας απόψε...

 Εκτύπωση  Email  Μου αρέσει  3  Tweet  Επικοινωνία

20.000+Ρολόγια 200+Μάρκες

Θέλετε 5.079€ κάθε χρόνο;

Αντίγραψε τους ειδικούς

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πως να μη πέφτει το μαλλί

Πανικός - Αγοραφοβία

Ψάχνεις για Φορητό;

Φθηνό Ξενοδοχείο Αθήνα

 itnavago.gr/ξενοδοχείο-Αθήνα

Ψάχνεις φθηνό ξενοδοχείο? Βρες πάνω από 600.000 ξενοδοχεία.

Χειροποίητα χαλιά online

NEWSROOM

7:56 Επιχείρηση *180* με αφηγήρα τους 156

://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63736043

11/10/2014



- 1:23 Ψήφος εμπιστοσύνης με 155 «ναι»
- 0:59 Τσίπρας: Εκλογές τώρα - Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δεσμεύεται από συμφωνίες της κυβέρνησης
- 0:47 Σαμαράς: Η Ελλάδα μπορεί να βγει από το μνημόνιο 1,6 χρόνο νωρίτερα
- 0:21 Στέπ Ντιπάρμεντ: Φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα στην Ευρώπη
- 0:12 Δένδιας: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται λεφτά που δεν υπάρχουν για να γίνουν όλοι πλουσιότεροι
- 23:30 Μητσοβίτης: Παντελής άγνοια του κ. Καμμένου για τον αναπτυξιακό νόμο
- 23:26 Βενιζέλος: Σχέδιο εξόδου από την κρίση πριν την εκλογή Προέδρου

ΝΕΑ ΣΕ 10" ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΟΣΠΟΡ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝΘΕΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

PEGASUS
NETWORK

ELLE.gr

ΗΜΕΡΗΣΙΑ.gr

SENTRAGOAL
www.sentragoal.gr

e-go.gr

Μόδα, Ομορφιά, Υπέροχο Κορμί.

Κουζίνα, Elle Deco.

Διαγωνισμοί.

Περισσότερα στο www.elle.gr

Ειδησεογραφία: Οικονομία & Αγορές.

Ελληνικές & Ξένες επιχειρήσεις.

Μεταχές, Χρηματοπιστήρια, Απόψεις.

Περισσότερα στο www.imerisia.gr

Ποδόσφαιρο: Ελλάδα & Διεθνή.

Μπάσκετ, Βόλεϊ και άλλα σπορ.

DailyBet & Παρασκηνία.








Περισσότερα στο www.sentragoal.gr

Ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσμο.


Ενημέρωση & Ψυχαγωγία.

Lifestyle, μόδα, ομορφιά, αστρολογία.

Περισσότερα στο www.e-go.gr

ΣΥΝΕΛΜΑ ΙΑΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ SPORTY ASIA CARMENNER womenonly.gr ELLE.gr ΕΘΝΟΣΠΟΡ TV ΚΥΝΗΓΙ Homme.
 COOK BOOK DealmyDay       

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

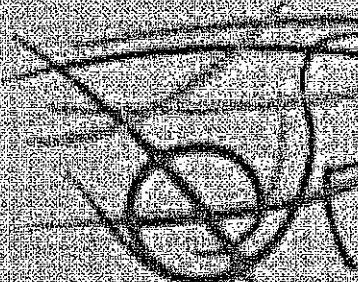

Τελευταία νέα

»» Ερώτηση με Θέμα : «Το Ελληνικό ΥΠΕΞ κλείνει ξαφνικά για τους ερευνητές τους σχετικούς φακέλους για τη Γενοκτονία των Αρμενίων από το Ρώσικο εμπάργκο στα ελληνικά προϊόντα ». »» Θέμα : « Μέτρα κάλυψης αναγκών θέρμανσης σχολικών μαθησίων ». »» Θέμα: Απόδοση ομάδων καταστολής εγκληματικότητας της ΕΛ.ΑΣ. »» "Απόδοση ομάδων καταστολής εγκληματικότητας της ΕΛ.ΑΣ. »» Με «φωτογραφική» διάταξη η συγκυβέρνηση χαρίζει 20 εκ. ευρώ για τις ομάδες καταστολής εγκληματικότητας της ΕΛ.ΑΣ. »» Θέμα : « Οι παραλογισμοί του νέου φορού ΕΝΦΙΑ » »» Θέμα : Οι ελληνικοί S300 «θύματα» των κυρώσεων της Ε.Ε κατά τη τμήμα παραγωγής αρβυλών του 700 ΣΕ». »» « Μεθοδεύεται το κλείσιμο του εργοστασίου 700ΣΕ με αποδόμηση των υπηρεσιών

Αρχική

Επικοινωνία

facebook Γιάννης Δημαράς

facebook Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών

Twitter Γιάννης

You Tube

Ανακοινώσεις

Δελτία τύπου

Φωτογραφίες

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Ερώτηση με Θέμα : « Έρευνα της δικαιοσύνης για τα τεράστια κέρδη των καρτέλ, από υπερτιμολογήσεις αναλώσιμων υλικών τεχνητού νεφρού των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης ».

Ανοιχτό
ος Πολι
ταλλαγ
να 105
Α. 210

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα : « Έρευνα της δικαιοσύνης για τα τεράστια κέρδη των καρτέλ, από υπερτιμολογήσεις αναλώσιμων υλικών τεχνητού νεφρού των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης ».

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ο Εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης παρήγγειλε στην επιχειρησιακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, ελέγχοντας μία προς μία όλες τις προμήθειες φίλτρων αιμοκάθαρσης σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης από το 2005 μέχρι φέτος.

Η έρευνα στρέφεται κυρίως σε εταιρείες που προμηθεύουν τα συγκεκριμένα υλικά, επεκτείνεται σε γιατρούς, αγγίζει όμως τόσο την επιτροπή ανταγωνισμού όσο και το ίδιο το υπουργείο Υγείας, καθώς στην καταγγελία τονίζεται ότι οι συγκεκριμένοι φορείς έχουν ενημερωθεί επανειλημμένως για "εναρμόνιση τιμών" στους διαγωνισμούς που συμμετέχουν και τη δημιουργία καρτέλ στο συγκεκριμένο αντικείμενο προμηθειών, χωρίς να έχουν αντιδράσει. Αναφέρεται δε ότι από καταγγελία που έλαβε ο κ. Εισαγγελέας και η οποία προέρχεται από στελέχη του χώρου της υγείας στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζεται ότι σε όλους τους διαγωνισμούς προμηθειών φίλτρων αιμοκάθαρσης οι τιμές των διαγωνιζομένων εταιρειών είναι οι ίδιες. Επίσης, οι συγκεκριμένες τιμές υπερβαίνουν κατά πολύ τις ευρωπαϊκές, οδηγώντας σε εταιρείες και μεσάζοντες να απομυζούν τεράστια κέρδη από τους προϋπολογισμούς των νοσοκομειακών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα φίλτρα αιμοκάθαρσης στα ελληνικά νοσοκομεία πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονται από 23 έως 30 ευρώ, όταν την περίοδο αυτή στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπερβαίνουν τα 15 ευρώ. Παλιότερα δε, οι τιμές τους είχαν εκτοξευτεί στα 50 ευρώ το ένα, παρότι το κόστος παρασκευής των υλικών αυτών υπολογίζεται ότι μετά βίας να ξεπερνούσε το 1 ευρώ!!

Ο κ.Εισαγγελέας, ζητά να εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου από την πλευρά των ιδρυμάτων, αλλά και τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και το ενδεχόμενο να έχει τελεστεί το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Δεν αποκλείεται παράλληλα να γίνουν έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων, καθώς οι καταγγέλλουσες πηγές ανέφεραν ότι υποστηρίζουν πως από τις συγκεκριμένες προμήθειες μέλη νοσοκομείων "εισπράττουν ποσοστά".

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :

- 1) Έχετε ενημερωθεί από τον προκάτοχό σας υπουργό για την όλη κατάσταση που επικρατεί στον ευαίσθητο χώρο των προμηθειών των συγκεκριμένων υλικών, όχι μόνο στα νοσοκομεία τη συμπρωτεύουσας αλλά και στα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας; Εάν ναι, θα διαταχθεί άμεσα, παράλληλη έρευνα και από το Σ.Ε.Υ.Π, ώστε να ελεγχθεί η παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού, η δημιουργία καρτέλ και η τυχόν εμπλοκή στελεχών της δημόσιας υγείας στις σκανδαλώδεις προμήθειες φίλτρων αιμοκάθαρσης ;
- 2) Έχετε τη πολιτική βούληση να ερευνήσετε με ποια άλλα αναλώσιμα υλικά του τεχνητού νεφρού δραστηριοποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια το « καρτέλ», με τεράστια κέρδη από υπερτιμολογήσεις για δεκαετίες, με την ύποπτη ανοχή εμπλεκόμενων παραγόντων της δημόσιας υγείας ;

Αθήνα 17/7/2014

Αριθ. πρωτ. 1200

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Αναρτήθηκε από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ στις 1:07 μ.μ.

+2 Προτείνεται το στο Google

Kyp/L
Simple τη
5
12
19
26

Αναγνώ

Γίνε
Google

Μέλη



Είστε ή

Αρχειοθ

Σεπτέμβ

Αύγουσ

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάιος (

Απρίλιο

Μάρτιος

Φεβρου

Ιανουάρ

Δεκέμβρ

Νοέμβρ

Οκτώβρ

Σεπτέμβ

Αύγουσ

Ιούλιος

Ιούνιος

Μάιος (

Απρίλιο

Μάρτιος

Φεβρου

Ιανουάρ

Δεκέμβρ

Νοέμβρ

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2014
 Α/Α: 6290

ΠΡΟΣ: • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- ΥΠΟΨΗ :** - Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Κος Δ. Κάλλος
 - Γραφείου Προμηθειών / Κας Δ. Στασινού
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κο ΒΑΒΒΑ ΦΩΤΗ

• **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**
 ΥΠΟΨΗ: Προέδρου Κου Γιάνναρη Χρ.

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:** • Αξιότιμο Υπουργό Υγείας / Κο Μαυρουδή Βορίδη
 • Αξιότιμο Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κο Νίκο Δένδια
 • **ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

- Θέμα:** - Προσφορά Ανταλλακτικών Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro
 - Παρατηρήσεις για τις υπερτιμολογήσεις και τα ΚΑΡΤΕΛ στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων
 - Η διαφορά τιμής 7.855% (ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
 - Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ
 - Ο Πρωθυπουργός Κος Αντώνης Σαμαράς

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO

Κύριοι,
 Κατόπιν του εγγράφου σας, υπ' αριθμ. Τ.Υ: 2096/3-7-2014 το οποίο λάβαμε μέσω fax, σας αποστέλλουμε προσφορά για την τιμή των ανταλλακτικών των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού AK200S του οίκου Gambro, ακριβώς όπως μας ζητήσατε:

➤ **ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:** 1.252,14 €

1. K11503001	AIR FILTER (ORIGINAL)	20 τεμ. X 7,77 = 155,40 €
2. K18891001	AIR FILTER COMPL. (ORIGINAL)	10 τεμ. X 12,94 = 129,40 €
3. K10857001	FILTER (SUCTION)	6 τεμ. X 12,39 = 74,34 €
4. 100319009	O-RING (12.37X2.62)	6 τεμ. X 0,98 = 5,88 €
5. K16538C	Filter AK200 S	30 τεμ. X 11,30 = 339,00 €
6. K14944001	FILTER BCH AK100	12 τεμ. X 9,67 = 116,04 €
7. 100319008	O-RING (9.3X2.4)	24 τεμ. X 0,98 = 23,52 €
8. K16214001	O-RING	5 τεμ. X 4,60 = 23,00 €
9. K07994001	PACKING	10 τεμ. X 0,98 = 9,80 €
10. K08227001	SEALING WASHER	10 τεμ. X 0,98 = 9,80 €
11. 100224006	BATTERY NI-MH 9V,150mAh	4 τεμ. X 46,55 = 186,20 €
12. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	12V-7,2Ah CSBGP 1272	8 τεμ. X 22,47 = 179,76 €

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. (23%).

Παρατηρήσεις επί του αιτήματος σας:

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ**

Τα ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στο αίτημα σας ζητούνται με τέτοιο τρόπο που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ίσως να είναι κατ' επιταγήν του καρτέλ του κατασκευαστή οίκου Gambro Lundia AB και της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Και αυτό γιατί ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποια - λίγα - ανταλλακτικά, τα οποία είναι ακριβώς ιδίων προδιαγραφών με του κατασκευαστή οίκου, στην ελεύθερη αγορά, προτιμάτε ίσως και για πρώτη φορά για το Νοσοκομείο σας, να αιτείστε να αγοράσετε τα πολύ πιο ακριβά υλικά του κατασκευαστή.

Πιο συγκεκριμένα το ανταλλακτικό με α/α: «11. 100224006 BATTERY NI-MH 9V,150mAh» το οποίο είναι μπαταρία συγκεκριμένων προδιαγραφών, την οποία την έχετε αγοράσει στο παρελθόν από την εταιρεία μας αντί 10,25 € και σήμερα θα μπορούσαμε να σας την προσφέρουμε αντί 8,51 €, προτιμάτε να την αγοράσετε με προέλευση από τον κατασκευαστή με κωδικό 100224006 στην τιμή των 46,55€.

Σε αντίθεση με το ανταλλακτικό με α/α: «12. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V-7,2Ah CSBGP 1272» το οποίο είναι και αυτό μπαταρία συγκεκριμένων προδιαγραφών, την οποία την έχετε αγοράσει στο παρελθόν από την εταιρεία μας αντί 22,47 € και σήμερα σας την προσφέρουμε στην ίδια τιμή 22,47 €, αιτείστε να αγοράστε το ανταλλακτικό που σας έχει πουλήσει η εταιρεία μας στο παρελθόν με κωδικό CSBG1272 στην παραπάνω οικονομική τιμή και όχι τα ανταλλακτικά του κατασκευαστή με κωδικό K40151001 «Battery kit (Includes two batteries)» με τιμή 193,97 € τα 2 τεμάχια δηλαδή 96,985 € το τεμάχιο.

Κύριε Κάλλο, αδυνατούμε να εξηγήσουμε τεχνικά τις πρακτικές σας, στις παραπάνω 2 περιπτώσεις: στην μεν 1^η περίπτωση του ανταλλακτικού με α/α 11 θέλετε την πανάκριβη μπαταρία που προέρχεται από τον κατασκευαστικό οίκο υπερτιμολογημένη κατά 447 %, ενώ στην 2^η περίπτωση του ανταλλακτικού με α/α 12 δεν έχετε πρόβλημα και επιλέγετε την μπαταρία που σας είχαμε ξαναπρομηθεύσει προερχόμενη όχι από τον κατασκευαστή οίκο, αλλά από την ελεύθερη αγορά αποφεύγοντας έτσι υπερτιμολόγηση της τάξης των 332 %.

Με βάση όλα τα παραπάνω ζητάμε να μας εξηγήσετε τις πρακτικές σας, ως Προϊστάμενος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και τεχνικά γνώστης, που στοχεύουν. Θέλετε ανταλλακτικά ίδιων τεχνικών προδιαγραφών με αυτές του κατασκευαστή οίκου ή μήπως θέλετε ανταλλακτικά τα οποία, ενώ υπάρχει δυνατότητα προμήθειας τους από την ελεύθερη αγορά να προέρχονται μόνο από τον κατασκευαστή οίκο (Gambro Lundia AB) και το ΚΑΡΤΕΛ αυτού, επιβαρύνοντας το Νοσοκομείο σας και κατ' επέκταση το Δημόσιο Συμφέρον με τις υπερτιμολογήσεις του ΚΑΡΤΕΛ της Gambro Lundia AB και της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, οι οποίες όπως σας αναλύσαμε φθάνουν μέχρι και 447 %.

Δηλαδή τα 11 ανταλλακτικά θέλετε να προέρχονται από τον κατασκευαστή οίκο και μάλιστα σε 2 από αυτά το τονίζεται με τη λέξη ORIGINAL σε παρένθεση, και το 12^ο ανταλλακτικό δε σας πειράζει να είναι από την ελεύθερη αγορά και όχι από τον κατασκευαστή (!) και όχι original (!) δηλαδή ΜΑΪΜΟΥ;;;

Εάν κύριε Κάλλο οι πρακτικές σας αυτές δεν υπηρετούν το ΚΑΡΤΕΛ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO (του κατασκευαστή Gambro Lundia AB και της ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ) τότε τουλάχιστον εξηγήστε μας τεχνικά τι εξυπηρετούν.

Για τις υπερτιμολογήσεις των ανταλλακτικών στην Ελλάδα από τον κατασκευαστή οίκο Gambro Lundia AB, οι οποίες φθάνουν ακόμη και στο 600 % έχουμε καταθέσει καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2011.

Επίσης το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ήδη έχει εκδώσει την υπ' αριθμ. 5667/2013 όπου με το διατακτικό της, μεταξύ άλλων:

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντισταγωνιστική πρακτική.
- ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπτώξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ 7.855% (ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

Προς επίρρωση όλων των παραπάνω σχετικά με το ΚΑΡΤΕΛ της Gambro Lundia AB και της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ με την τεράστια υπερτιμολόγηση και τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, σας αναφέρουμε επίσης:

Η Απόφαση υπ' αριθμ. πρωτ. 16496/23-6-2014 του Νοσοκομείου σας με ΑΔΑ: ΒΧΤΥ46906Η-Ο8Ρ μεταξύ άλλων αναφέρει προμήθεια αναλωσίμων υλικών άκρως απαραίτητων για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού από την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ: 400 τεμάχια Φύσιγγες Απολύμανσης – Αποστείρωσης για μηχανήμα Gambro CLEAN CART-A προς 8,75 € το τεμάχιο

600 τεμάχια Φύσιγγες Απολύμανσης – Αποστείρωσης για μηχανήμα Gambro CLEAN CART-C προς 8,75 € το τεμάχιο

Συνολικού Κόστους: 9.887,50 €

Η χρήση αυτών των δύο αναλώσιμων υλικών έχει να κάνει με την αποστείρωση για οργανικά κατάλοιπα το ένα υλικό και την αποστείρωση και απασβέστωση κτηρικού οξέως το άλλο υλικό. Χρησιμοποιούνται δε συνήθως από ένα τεμάχιο από το υλικό clean cart C για κάθε μηχανήμα ανά ημέρα, και 1 με 2 τεμάχια από το υλικό clean cart A για κάθε μηχανήμα ανά εβδομάδα, από την αναλογία της συγκεκριμένης προμήθειας θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων καταναλώνει πολύ περισσότερα από 2 τεμάχια την εβδομάδα ανά μηχανήμα clean cart A.

Έτσι μια μονάδα τεχνητού νεφρού σαν αυτή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων η οποία διαθέτει περί τα 12 μηχανήματα τεχνητού νεφρού θα μπορούσε να καταναλώνει στις 300 ημέρες λειτουργίας της περίπου το χρόνο από 3600 τεμάχια από το υλικό clean cart C και περίπου 1240 τεμάχια από το υλικό clean cart A.

Δηλαδή το ετήσιο κόστος για μια τόσο μικρή μονάδα για αυτά τα δύο υλικά μπορεί να φτάνει : CLEAN CART C: 3600 τεμ. X 8,75€ = 31.500,00€

CLEAN CART A: 1240 τεμ. X 8,75€ = 10.850,00€

ΣΥΝΟΛΟ

42.350,00€

Σκεφτείτε όμως ότι υπάρχουν μονάδες τεχνητού νεφρού σε Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν πολύ περισσότερα μηχανήματα. Για παράδειγμα μια μεγάλη μονάδα τεχνητού νεφρού σε Δημόσιο Νοσοκομείο διαθέτει 44 μηχανήματα.

Έτσι το αντίστοιχο κόστος αυτών των 2 υλικών για μια μονάδα 44 μηχανημάτων, σύμφωνα με τον παραπάνω συλλογισμό, σε ετήσια βάση μπορεί να φτάσει τις 155.540,00€.

Υπάρχουν μονάδες τεχνητού νεφρού που δεν χρησιμοποιούν καθόλου αυτά τα 2 "άκρως απαραίτητα" (!) αναλώσιμα υλικά, προτιμώντας να κάνουν χρήση αντί αυτών κιτρικού οξέως σε σκόνη αγοράζοντας το προς 3-3,5€ το κιλό. Έτσι αγοράζοντας μία συσκευασία 20 κιλών πληρώνουν 60-70€.

Ποια η διαφορά; Στην περίπτωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αγοράζεται το υλικό clean cart C το οποίο περιέχει 32gr κιτρικού συσκευασμένο σε ειδική φύσιγγα με τιμή 8,75€ τα 32gr και στην περίπτωση των άλλων νοσοκομείων αγοράζουν ποσότητα κιτρικού προς 3-3,5€ το κιλό χωρίς βέβαια την ειδική συσκευασία της φύσιγγας, έχοντας όμως την δυνατότητα το μηχανήμα να κάνει την διαδικασία της αποστείρωσης και απασβέστωσης και χωρίς φύσιγγα.

Πιο απλά τα 32gr κιτρικού σε φύσιγγα κοστίζουν 8,75€ έναντι των 32gr κιτρικού (χύμα) που κοστίζουν 0,11€.

Αυτή η διαφορά καθαρά οικονομικά είναι της τάξης των 7.855% .

Η φύσιγγα όμως προσφέρει κάποια ευκολία χρήσης στους χειριστές των μηχανημάτων, ευκολία όμως που κοστίζει 7.855% παραπάνω στο Ελληνικό Δημόσιο και το Δημόσιο συμφέρον.

Το δε άλλο υλικό φύσιγγα clean cart A τα άλλα νοσοκομεία το υποκαθιστούν με απλή χλωρίνη του εμπορίου η τιμή της οποίας είναι περίπου στο 1€ το λίτρο.

Με ένα λίτρο χλωρίνης το μηχανήμα μπορεί να αποστειρωθεί 5 φορές, υποκαθιστά δηλαδή 5 φύσιγγες clean cart A.

Έτσι μία αποστείρωση με clean cart A κοστίζει 8,75€ έναντι μιας αποστείρωσης με χλωρίνη που κοστίζει 0,20€, άρα η διαφορά είναι της τάξης των 4.275%.

Τόσο το χύμα κιτρικό όσο και η απλή χλωρίνη, επιτρέπονται και προβλέπονται από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού.

Το αποτέλεσμα μη χρήσης αυτών των "άκρως απαραίτητων" (!) αναλωσίμων υλικών αλλά της χρήσης χύμα κιτρικού και απλής χλωρίνης για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων θα ήταν εξοικονόμηση ποσού 41.706€ το χρόνο ενώ στην περίπτωση της μεγάλης μονάδας των 44 μηχανημάτων η εξοικονόμηση θα έφτανε στα 153.172,80€ το χρόνο.

Με την απλή σκέψη του μέσου νοήμονος ανθρώπου τα παραπάνω θα φάνταζαν σκανδαλώδη και ειδικότερα στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα που καθημερινά η κοινωνία της ματώνει.

Έναν ειδικό όμως, όπως για παράδειγμα ο κος Κάλλος, ο οποίος είναι γνώστης ως προϊστάμενος του τμήματος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ φαντάζουν φυσιολογικά. Θα μπορούσε επίσης να αντιτάξει και την πτώση των τιμών, διότι αυτά τα υλικά προ κρίσης ίσως να πουλιόνταν και πάνω από 15€ το τεμάχιο αντί 8,75€ που πουλιούνται σήμερα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει συσταθεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, η οποία μάλιστα έχει στην ευθύνη της την τήρηση παρατηρητηρίου τιμών. Υποτίθεται ότι για κάθε υλικό που πουλιέται στα Δημόσια Νοσοκομεία μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, η τιμή κατακύρωσης της προμήθειας του υλικού αναρτάται στο παρατηρητήριο, και με βάσει σειράς αποφάσεων – κανονισμών όλες οι επόμενες προμήθειες αυτών των υλικών πρέπει να είναι κάτω από αυτή την τιμή.

Για τα δύο προαναφερόμενα "άκρως- απαραίτητα" (!) υλικά, ενώ έχουν διεξαχθεί πολλοί διαγωνισμοί προμήθειας τους από τα Δημόσια Νοσοκομεία, κατά ένα περιεργό τρόπο λείπουν από το παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ.

Φυσικά δεν είναι τα μόνα υλικά που λείπουν από το παρατηρητήριο τιμών ένα "αόρατο χέρι" φροντίζει να προστατεύει αρκετά από τα αναλώσιμα υλικά των νοσοκομείων, έτσι ώστε οι σκανδαλώδεις τιμές τους να μην εκτίθονται σε κοινή θέα, και έτσι να μην διακινδυνεύσουν τα υπερκέρδη κάποιων εταιρειών που όπως αναλύσαμε παραπάνω φθάνουν ακόμα και 7.855% (ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)

Τίως είναι το ίδιο "αόρατο χέρι" το οποίο φροντίζει να θάβει βαθιά στα συρτάρια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας το τεράστιο πλήθος των εγγράφων της εταιρείας μας (περί των 70 πρωτοκολλημένων εγγράφων), με τα οποία καταγγέλλουμε και κοινοποιούμε από το 2012 μέχρι και σήμερα όλες τις παράνομες αθέμιτες και αντί ανταγωνιστικές πρακτικές του ΚΑΡΤΕΛ της Gambro Lundia AB και της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ κατά της εταιρείας μας αλλά και κατά των Δημόσιων Νοσοκομείων και του δημοσίου συμφέροντος και αιτούμαστε την επέμβαση της για να σταματήσει επιτέλους το πλιάτσικο.

Τα ΚΑΡΤΕΛ στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων είναι πολύ δυνατά. Τα συμφέροντα τεράστια και δυστυχώς δρουν ανεξέλεγκτα. Δυστυχώς άνθρωποι που τυπικά φέρουν την ευθύνη διαφύλαξης του Δημοσίου Συμφέροντος γίνονται συμμετέχοι στο "τεράστιο πάρτυ" των ΚΑΡΤΕΛ ακόμη και σήμερα.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κος ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου του 2012, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας μεταξύ άλλων ανέφερε:

".....Η μεταρρύθμιση βέβαια πολλούς τους ενοχλεί, γιατί ξέρουν ότι είναι μόνιμη.

Και γι' αυτό έχουν εξαπλώσει ένα όργιο δημαγωγίας.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Τα Ελληνικά Νοσοκομεία αγόραζαν ως πρόσφατα τα φίλτρα για τις μονάδες τεχνητού νεφρού προς 35 ευρώ το ένα. Την ίδια στιγμή στην Κύπρο και σε άλλες χώρες τα ίδια φίλτρα έκαναν προς 8 ευρώ το ένα! Κι αυτό είναι μόνο ένα τυπικό παράδειγμα. Από χιλιάδες παρόμοια!

Καταλαβαίνετε το τεράστιο πάρτυ που γινόταν σε όλα τα υλικά της δημόσιας υγείας. Αυτό πια κόβεται με το μαχαίρι".

Μετά τη δήλωση αυτή του Κου Σαμαρά και ειδικότερα με τη φράση «Αυτό πια κόβεται με το μαχαίρι» θα περίμενε κανείς το μαχαίρι του ίδιου του Πρωθυπουργού, να καταφέρει να φτάσει την τιμή κοντά έστω στα 8€ το κάθε φίλτρο αιμοκάθαρσης.

Αντί αυτού η τιμή από 35€ πήγε στα 28€ και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι(!) και το "ΚΑΡΤΕΛ εξαρθρώθηκε"(!)

Η διαφορά στην τιμή του φίλτρου αιμοκάθαρσης που πουλιέται στην Ελλάδα με βάση τα λόγια του ίδιου του πρωθυπουργού, σε σχέση με την τιμή που πουλιέται στην Κύπρο και άλλες χώρες ήταν 8€ - 35€ 337,5% και έγινε

8€ - 28€ 250%

Η διαφορά στις τιμές των δύο υλικών της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ που σήμερα πουλιούνται στα 8,75€ και παλιότερα πολύ πιο ακριβά σε σχέση με τις τιμές άλλων χωρών άραγε πόση να είναι;

Καθώς και οι τιμές σειράς άλλων υλικών τα οποία προστατεύονται από τους μηχανισμούς των ΚΑΡΤΕΛ;

Όλα τα παραπάνω εκτός από απαραίτητη ενημέρωση των αρμοδίων αποτελούν και ένα ανθρώπινο ξέσπασμα της εταιρείας μας, στον άνισο και ανελέητο πόλεμο που βιώνει σχεδόν 3 χρόνια τώρα από το ΚΑΡΤΕΛ της Gambro Lundia AB και της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Έναν πόλεμο που ξεκίνησε εκδικητικά κατά της εταιρείας μας όταν προβάλαμε σθεναρή αντίσταση κατά των πρακτικών υπερτιμολόγησης των ανταλλακτικών στην Ελλάδα από την κατασκευάστρια Gambro Lundia AB.

Έτσι Κύριε Κάλλο ακόμη κι αν η σύνταξη του αιτήματος σας έγινε κατ' εντολή του ΚΑΡΤΕΛ, εμείς περιμένουμε την έγκριση στην παρούσα προσφορά μας.

Ευελπιστώντας ότι κάποια μέρα οι αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί θα ασχοληθούν επιτέλους σοβαρά και πραγματικά θα «κόψουν με το μαχαίρι» τα ΚΑΡΤΕΛ μαζί με όλους αυτούς που τα υπηρετούν.

Συνημμένα:

- Έγγραφο αίτημα υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΥ 2096/3-7-14
- Απόφαση Προμήθειας υλικών υπ' αριθμ. πρωτ. 16496/23-6-14

Για την ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ

Μιχάλης Ιωάννης

Διαχειριστές

Στεριώτης Κωνσταντός



UNIVERSITY HOSPITAL OF IOANNINA
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ - Τ.Θ. 1093 - 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

P.O. BOX 1093, STAVROU NIARCHOU STR., 45 500 IOANNINA - GREECE

TEL.: 26510-99529 & 99900 - FAX: 26510-99545 & 99774 - e-mail: biomedical-eng@uhi.gr
-promithies@uhi.gr

To: ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ
Τηλ.210/ 7520070
Dept: SERVICE
Attn:
Fax:210/ 7519343

From: Στασινοῦ Δ.-Κάλλος Δ.
Dept: Γρ.Προμηθειών-Βιοϊατρική τεχνολογία
Date:3-7-2014
Αρ.πρωτ.: Τ.Υ 2096.

This transmission consists of1... page(s) including this page.
If you do not receive all pages phone on the above phone number.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την τιμή των παρακάτω ανταλλακτικών για
μηχάνημα Αιμοκάθαρσης GAMBRO AK20:

- | | |
|---|----------|
| 1. K1 1503001 AIR FILTER (ORIGINAL) | τεμ (20) |
| 2. K1 8891001 AIR FILTER COMPL. (ORIGINAL) | τεμ (10) |
| 3. K1 0857001 PIPE FILTER 50µm | τεμ (6) |
| 4. 100 319009 O-RING FOR DIALYSER CONNECTOR | τεμ (6) |
| 5. K1 6538C FILTER FOR BCH (50µm) | τεμ (30) |
| 6. K1 4944001 FILTER HEATING VESSEL (250 µm) | τεμ (12) |
| 7. 100319008 O-RING FOR BCH /SELECT | τεμ (24) |
| 8. K 162 14001 O-RING BLOOD LEACK | τεμ (5) |
| 9. K 07994001 SEALING RING | τεμ (10) |
| 10. K08227001 RING | τεμ (10) |
| 11. 100224006 BATTERY NI-MH 9V ,150mAh | τεμ (4) |
| 12. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V -7,2 Ah CSBGF 1272 | τεμ (8) |

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


ΚΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιωάννινα	23-06-2014
Αριθ. Πρωτ.	16496

ΑΠΟΦΑΣΗ

προμήθειας υλικών, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

Έχοντας υπόψη :

α. Π.Δ 118/07 άρθρο 22.
β. Ν. 2955/ 2001
γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ.
δ. Ν. 3329/ 2005
ε. Ν. 3580/ 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2010
στ. Ν. 3867/ 2010 άρθρο 27 παρ. 11
ζ. Ν. 3918/2011 άρθρο 11 παρ. 6
η. Το με Α/Α 2359/12-06-2014 εντύπου αίτημα της Μ.Τ.Ν του Νοσοκομείου.
θ. Το απο 15600/12-06-2014 έγγραφο του Νοσοκομείου για κατάθεση προσφορών.
ι. Τις προσφορές των εταιρειών VERMA DRUGS ABEE, ARITI A.E, DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, MEDICAL PRODUCT ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε, MEDIPRIME Α.Ε & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την άμεση προμήθεια, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των παρακάτω ειδών άκρως απαραίτητων για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 21.667,06€ με ΦΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : 998283526 MEDIPRIME Α.Ε.Ε.

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΦΠΑ%	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Μ/Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΕΧΕΥΑΤΑ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΕ001029	DAIJI 750-SET		ΠΕ00102902	23.0	ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ	5	8789.58
41311A				1643.58	1429.2000		
				ΦΠΑ... :	1643.58	ΣΥΝΟΛΟ:	8789.58

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : 094326835 ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΦΠΑ%	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Μ/Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΕΧΕΥΑΤΑ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΕ001022	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ		ΠΕ00102202	13.0	ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ	1200	1939.07
41311A	M			223.08	1.4300		
				ΦΠΑ... :	223.08	ΣΥΝΟΛΟ:	1939.08

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : 095150743

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΦΠΑ%	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Μ/Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΟΡΑΣ
ΠΕ001018	ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ	ΠΕ00101801	13.0	ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΤΑΙ	ΤΕ	ΤΕ
41311A	ΑΝΗΜΑ GAMBRO CLEAN CART-A		455.00	8.7500	400	3955.00
ΠΕ001018	ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ	ΠΕ00101802	13.0	ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΤΑΙ	ΤΕ	ΤΕ
41311A	ΑΝΗΜΑ GAMBRO CLEAN CART-C		682.50	8.7500	600	5932.50
ΦΠΑ...:				1137.50	ΣΥΝΟΛΟ:	9887.50

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : 094396063

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΦΠΑ%	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Μ/Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΟΡΑΣ
ΠΕ001008	ΒΕΛΩΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA (ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ -	ΠΕ00100826	13.0	30.12.23/0,33	ΤΕ	ΤΕ
41311A	ΦΑΒΡΙΚΕΣ) ΜΕ BACK EYE 16G	16G	120.90	0.3100	3000	1050.90
ΦΠΑ...:				120.90	ΣΥΝΟΛΟ:	1050.90

1. Η παραλαβή να γίνει από τις Δεκαπενθήμερες επιτροπές παραλαβής υγειονομικού υλικού.
2. Η δαπάνη να βαρύνει τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2014

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


ΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ



World Health
Organization

Medical equipment maintenance programme overview

WHO Medical device technical series

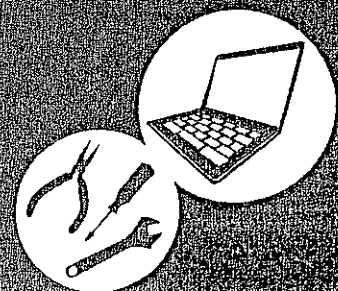

Medical equipment maintenance programme overview

WHO Medical device technical series



WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

Medical equipment maintenance programme overview.

(WHO Medical device technical series)

1.Appropriate technology. 2.Equipment and supplies. 3.Maintenance. I.World Health Organization.

ISBN 978 92 4 150153 8

(NLM classification: WX 147)

© World Health Organization 2011

All rights reserved. Publications of the World Health Organization are available on the WHO web site (www.who.int) or can be purchased from WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int). Requests for permission to reproduce or translate WHO publications – whether for sale or for noncommercial distribution – should be addressed to WHO Press through the WHO web site (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design & layout: L'IV Com Sàrl, Villars-sous-Yens, Switzerland.

Contents

Preface	4
Maintenance series and external guidance	5
Methodology	5
Definitions	6
Acknowledgements	7
Declarations of interests	7
Acronyms and abbreviations	8
Executive summary	9
1 Introduction	10
2 Purpose	11
3 Maintenance related definitions	12
4 Maintenance programme planning	14
4.1 Inventory	14
4.2 Methodology	15
4.3 Resources	15
4.3.1 Financial resources	16
4.3.2 Physical resources	17
4.3.3 Human resources	20
5 Management	23
5.1 Financial management	23
5.2 Personnel management	23
5.2.1 Service vendors	24
5.2.2 Training	25
5.3 Operational management	26
5.3.1 Developing or changing IPM procedures	26
5.3.2 Setting IPM frequency	26
5.3.3 Scheduling maintenance	27
5.3.4 Prioritization of work	27
5.3.5 Keeping records	28
5.3.6 Computerized maintenance management systems	29
5.3.7 Tags and labels	30
5.3.8 Communication	30
5.3.9 Managing use and user error	31
5.3.10 Travel	31
5.4 Performance monitoring	32
5.4.1 Completion rate of assigned IPM	32
5.4.2 Equipment location rate	32
5.4.3 IPM yield	32
5.4.4 IPM productivity	33
5.4.5 CM performance measures	33
5.5 Performance improvement	33

6 Implementation	35
6.1 Inspection and preventive maintenance	35
6.1.1 IPM procedures	35
6.1.2 Problem identification	35
6.2 Corrective maintenance	35
6.2.1 Troubleshooting and repair	35
6.2.2 Factors affecting equipment failures	36
6.2.3 Inspection and return to service	37
6.3 Reporting	37
6.4 Safety	37
7 Concluding remarks	39
References	40
Useful resources	41
Appendix A Sample policies and procedures	43
Appendix A.1 Risk-based biomedical equipment management programme	44
Appendix A.2 Initial testing and evaluation	48
Appendix A.3 Inspection and preventive maintenance procedure	50
Appendix A.4 Work order system for corrective maintenance	52
Appendix A.5 Corrective actions identified during preventive maintenance	54
Appendix A.6 Infection control	56
Appendix B Examples of inspection and preventive maintenance procedures	58
Appendix B.1 Procedure template	59
Appendix B.2 Anaesthesia/analgesia unit (gas machine)	60
Appendix B.3 Centrifuge, table top	61
Appendix B.4 Monitor, ECG	62
Appendix B.5 Pump, infusion	63
Appendix B.6 X-ray system, mobile	64
Appendix C Calculating IPM workload	65
Appendix D Examples of inventory and inspection forms	68
Appendix D.1 New equipment received form	69
Appendix D.2 Equipment inspection forms	70
Appendix D.3 Work order form	72
Appendix E Samples of inspection labels	73
Appendix E.1 Record of inspection	74
Appendix E.2 Record of inspection (test) results	75
Appendix E.3 Notification of defect	76
Appendix F Test equipment per medical device category	77

Appendix G Examples of job descriptions	78
Appendix G.1 Biomedical equipment technician - entry-level	79
Appendix G.2 Biomedical equipment technician - mid-level	80
Appendix G.3 Biomedical equipment technician - senior-level	81
Appendix G.4 Clinical engineering supervisor/manager	82
Appendix H Examples of actions performed when developing maintenance programmes at the facility level	83
Appendix H.1 Planning a maintenance programme at a district hospital	84
Appendix H.2 Managing a maintenance programme at a district hospital	85
Appendix H.3 Planning a maintenance programme within a regional health system	86
Appendix H.4 Managing a maintenance programme within a regional health system	87

Figures and tables

Figure 1. Components of a maintenance programme	10
Figure 2. Critical factors in planning a maintenance programme	14
Table 1. Financial resources required for a maintenance programme	16
Table 2. Classification and roles of technical personnel	21
Figure 3. Management aspects of a maintenance programme	23
Table 3. Service agreement types	25

activities is appropriate. Section 5.3.3 specifically discusses the various aspects of scheduling maintenance activities.

Personnel management also includes monitoring service vendors when maintenance must be outsourced (see 5.2.1 below). It is important to monitor the productivity of internal and outsourced technical personnel on a regular basis. When applied to individual in-house technicians, productivity monitoring can identify those technicians needing additional support or training. When applied to the maintenance programme as a whole, productivity monitoring can identify opportunities to improve the cost-effectiveness of the programme. More details on performance monitoring and improvement are found in sections 5.4 and 5.5.

The most important aspect of personnel management is the ability to ensure adequate training. Training on new equipment, as well as routine refresher training on existing hardware, is necessary to ensure that technical staff are capable of properly maintaining and repairing the medical equipment included within the scope of the programme. Section 5.2.2 discusses training in further detail.

5.2.1 Service vendors

As mentioned, it is often not possible to provide all maintenance services in-house. In such circumstances, it may be necessary to make use of external service providers for a significant portion of the maintenance activities.

There are generally two categories of external service providers: *equipment manufacturers and independent service organizations*. Many equipment manufacturers offer scheduled and unscheduled maintenance services for the equipment they manufacture. Some also offer maintenance services for

equipment from other manufacturers, in some cases extending to all the medical equipment in a health-care organization. Independent service organizations range in size; some specialize in a particular type of medical equipment and others offer maintenance services for a wide variety of equipment types.

In some parts of the world there are many external service providers, which offer the clinical engineering department manager a wide variety of options. However, in other parts of the world the number of external service providers is much more limited. In some cases these companies find it uneconomical to offer services in remote areas with small inventories of equipment. They are more likely to expand their service areas if it possible to negotiate a contract that covers a large inventory of equipment, especially if that inventory has a reasonable level of standardization in terms of manufacturer and model. In some cases, it may be reasonable to consider liaising with other health-care facilities in order to provide better justification for the external service providers to enter the local market.

There are several types of service agreements as outlined in Table 3. Service agreements can include various levels of scheduled maintenance, unscheduled maintenance, or a combination of the two. Flexibility in the terms of service agreements is valuable to the clinical engineering department manager, but care must be taken to fully understand those terms before entering into a formal agreement. Additionally it is advisable to check the references of any outside vendor prior to hiring them.

After a service agreement is in place, it is essential to monitor the performance of the service provider. This is necessary to make sure that the terms of the agreement are being met and that the health-care organization is receiving the services it

Table 3. Service agreement types

Type	Description	Rates (cost)
Full service	Quick response available at all times	Fixed
Time and material service	Varying response time available as needed	Hourly charge plus cost of parts
Shared responsibility	Internal staff provides initial response and repair. External staff follows up as and when required.	

needs. All maintenance activities they perform and associated costs should also be recorded (i.e. in a CMMS, if available) and reviewed on a regular basis.

5.2.2 Training

For the safety of the patient and the user, proper training is critical for both the user and the technical staff. The technical staff and the clinical engineering department manager have dual responsibility for ensuring that the technical personnel as well as the clinical users are informed, trained and versed on their specific responsibilities. Training and education is not a one-time activity but a continual process. Enabling staff to see that learning is important and a constant feature of their job will improve reliability and success in future problem solving. This section describes the training of technical personnel and section 5.3.9 briefly discusses user training.

Training of technical personnel can be provided inside the health-care organization through:

- Self-study:
 - › reading the equipment service and training manuals;
 - › using additional self-study materials provided by the manufacturer;
 - › using materials provided by a third party.
- One-to-one training provided by a more experienced person from

inside the organization. This may be a clinician teaching biomedical equipment technicians how the device works, for example, or a technician who is familiar with the device guiding others about maintenance and operation.

- The biomedical equipment technician taking part in a education class for nurses or other clinical users to learn about the operation of the equipment.
- The clinical engineering department bringing in a specialized outside trainer to teach staff about maintenance of a particular piece or type of equipment.
- The clinical engineering department bringing in one of the manufacturer's trainers to present to biomedical equipment technicians about maintenance and operation.

Or training can take place outside the organization at:

- Third-party training programmes designed to explain several models of a specific technology.
- Manufacturer's training programmes specifically designed for equipment technicians.

The methods of training suggested above, progress from the least expensive to the most expensive to implement. So depending on hospital resources, local availability of information sources and the ability to coordinate with other hospitals who might have technicians to train as well, the hospital can choose a methodology that best matches their resources. It should be noted however that the most effective training methods for sophisticated equipment are the more expensive options.

The most sophisticated equipment in hospital settings consists of computer-based multi-component systems.

Most of the performance inspection and verification of this equipment is performed by software-based inspection systems built into the equipment itself. Obtaining access to the computer codes and understanding how to maintain this equipment may only come with training provided by the manufacturer or vendor for a fee. If the hospital has developed a competent staff of biomedical equipment technicians, service training by the vendor is a good investment as it enables the hospital to eliminate vendor-related costs and may also lead to the hospital being able to assume repair responsibilities.

5.3 Operational management

5.3.1 Developing or changing IPM procedures

For IPM to be conducted properly, procedures are either selected or written so they provide sufficient testing and maintenance for specific devices and their features. The process of selecting or writing must begin with a good understanding of the technology in general, and the relevant model of equipment.

When developing new procedures for either old or new equipment, it is best to take the most conservative approach and use the manufacturer's IPM procedure manual as a baseline. The equipment owner should expect IPM procedures from the manufacturer to:

- Be well designed and easy to understand.
- Clearly explain every step in the procedure.
- Explain what test equipment is required.
- Explain what the upper and lower limits for measurements the biomedical equipment technician will take.
- Show how to replace parts.

- Explain the required frequency of specific steps.
- Provide recommended forms to be used for the IPM procedure.
- Be provided in the predominant major language of the region/country. If this is not possible, the department will then have to consider if this is the best purchase for them or if they can afford to translate the manuals themselves.

Procedures should not be changed until the owner has some experience with the device. Then, based on inputs from biomedical equipment technicians and/or other organizations who also own the equipment (or industry recommendations), IPM procedures can be changed. If this is done, the justification for deviating from the manufacturer's suggested IPM procedure should be thoroughly documented for future reference. The decision to make this change should also be reviewed periodically (e.g. annually) to make sure the conditions leading to the change persist.

In most cases, the unique characteristics and features of devices require unique inspection steps for each different model. However, in some cases, a generic procedure for all manufacturers and models (e.g. oto/ophthalmoscope, fibre optic light source, microscope) can be used. While using available generic procedures may be very convenient, it must be done with understanding and discernment as some are written with the intention of providing only the most basic steps in an inspection. Appendix B contains a procedure template and a few sample generic procedures.

5.3.2 Setting IPM frequency

The frequency of IPM is specified by the manufacturer of the equipment in the maintenance manual. In cases where there is sufficient familiarity with

5.2.1 Προμηθευτές Τεχνικής Στήριξης


Όπως έχει αναφερθεί, δεν είναι συνήθως δυνατόν να παρέχεις όλες τις υπηρεσίες συντήρησης εσωτερικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών τεχνικής στήριξης για ένα σημαντικό ποσοστό των εργασιών συντήρησης.

Γενικά υπάρχουν δύο κατηγορίες εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών τεχνικής στήριξης: οι κατασκευαστές του εξοπλισμού και οι ανεξάρτητοι οργανισμοί τεχνικής στήριξης. Πολλοί κατασκευαστές εξοπλισμού προσφέρουν υπηρεσίες προγραμματισμένων και επανορθωτικών συντηρήσεων για τον εξοπλισμό που κατασκευάζουν. Επίσης κάποιοι άλλοι προσφέρουν υπηρεσίες συντήρησης για εξοπλισμό άλλων κατασκευαστών, και εκτείνονται σε κάποιες περιπτώσεις σε όλο τον εξοπλισμό ενός οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης. Οι ανεξάρτητοι οργανισμοί τεχνικής στήριξης ποικίλουν σε μέγεθος. Κάποιοι εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο τύπο ιατρικού εξοπλισμού και κάποιοι άλλοι προσφέρουν υπηρεσίες συντήρησης για ένα ευρύ φάσμα τύπων εξοπλισμού.

Σε κάποια μέρη του κόσμου υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παρόχοι υπηρεσιών τεχνικής στήριξης, που προσφέρουν στο διευθυντή του τμήματος κλινικής μηχανικής ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου ο αριθμός των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών τεχνικής στήριξης είναι πολύ πιο περιορισμένος. Σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι εταιρείες θεωρούν πολυδάπανο το να προσφέρουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές που έχουν μικρό στόλο εξοπλισμού. Θα ήταν περισσότερο πιθανό για αυτούς να επεκτείνουν τις περιοχές που εξυπηρετούν αν μπορούσαν να διαπραγματευτούν μια σύμβαση που να καλύπτει ένα μεγάλο στόλο εξοπλισμού, ειδικότερα αν αυτός ο στόλος έχει ένα λογικό επίπεδο τυποποίησης όσον αφορά τον κατασκευαστή και το μοντέλο. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι λογικό το να συνενωθούν με άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης έτσι ώστε να δώσουν ένα καλύτερο κίνητρο στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών τεχνικής στήριξης και να μπου στην τοπική αγορά.



Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβολαίων παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα επίπεδα προγραμματισμένων συντηρήσεων, επανορθωτικών συντηρήσεων, ή ένα συνδυασμό τους. Η ευελιξία όσον αφορά τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης είναι πολύτιμη για τον διευθυντή του τμήματος κλινικής μηχανικής, αλλά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να κατανοήσεις πλήρως τους όρους αυτούς πριν να μπει σε ένα επίσημο συμβόλαιο. Επιπρόσθετα προτείνεται να ελέγξει κανείς τις συστάσεις οποιουδήποτε εξωτερικού προμηθευτή πριν να τους προσλάβει.

Αφού συναφθεί ένα συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης, είναι απαραίτητο ο πάροχος υπηρεσιών τεχνικής στήριξης να επιβλέπεται. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιβεβαιώσουμε ότι τηρούνται οι όροι του συμβολαίου και ο οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνει τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Όλες οι εργασίες συντήρησης που εφαρμόζουν και τα σχετικά κόστη πρέπει επίσης να καταγράφονται (π.χ. σε ένα CMMS, αν υπάρχει) και να επανεξετάζονται σε τακτική βάση.

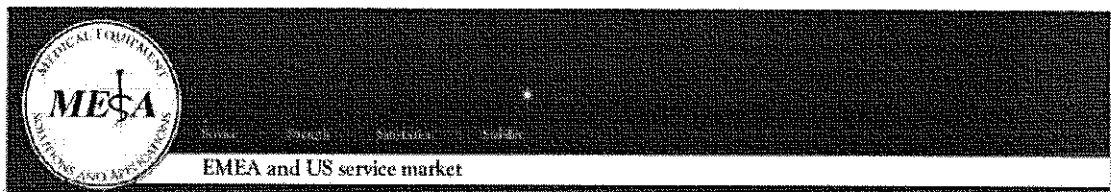

Diagnostic Imaging Equipment Sales Market²

Maintenance Service Providers, US versus EMEA markets³

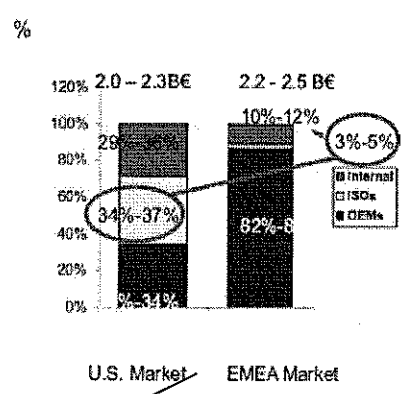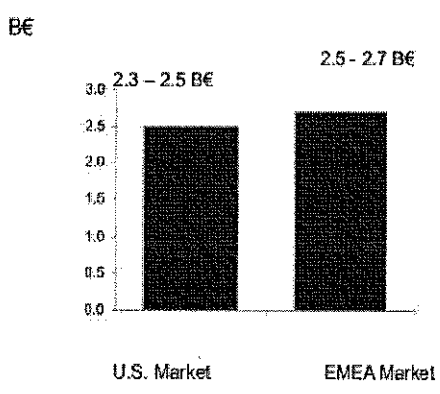

EMEA market for DI Equipment and Service now larger than US with little existing penetration of Independent Service Operators

1. EMEA = Europe, Middle East and Africa; 2. Equipment sales market; average total value in 2008-2010; 3. Service maintenance market; average value in 2008-2010 (Source: Healthcare Europa, Frost & Sullivan)

Ο πίνακας αυτός μας δείχνει την κατανομή της παροχής υπηρεσιών συντήρησης στην Αγορά της Αμερικής έναντι της αντίστοιχης κατανομής στην Αγορά EMEA (Ευρώπη – Μέση Ανατολή – Αφρική). Έτσι στην αγορά της Αμερικής οι υπηρεσίες συντήρησης μοιράζονται σε: 29%-36%: εσωτερικά-internal (από τεχνικό προσωπικό των πελατών των Ιατρικών Μηχανημάτων), 34% - 37%: ISOs (Ανεξάρτητων Οργανισμών παροχής τεχνικών υπηρεσιών) και 30% - 34%: OEMs (Οργανισμού Παροχής τεχνικών υπηρεσιών των κατασκευαστών). Έναντι της Αγοράς EMEA (Ευρώπη – Μέση Ανατολή – Αφρική) στην οποία: 10% - 12%: εσωτερικά-internal (από τεχνικό προσωπικό των πελατών των Ιατρικών Μηχανημάτων), 3% - 5%: ISOs (Ανεξάρτητων Οργανισμών παροχής τεχνικών υπηρεσιών), 82% - 87%: OEMs (Οργανισμούς Παροχής τεχνικών υπηρεσιών των κατασκευαστών).




US Market Corollary: ~\$3.1B market shows six players concentrate ~45% of the market

OUR SERVICES REFLECT OUR VALUES
 Service Strength Satisfaction Safety

ISO 13485 ISO 9001

Market share of clinical equipment maintenance/repair market by ISO player¹

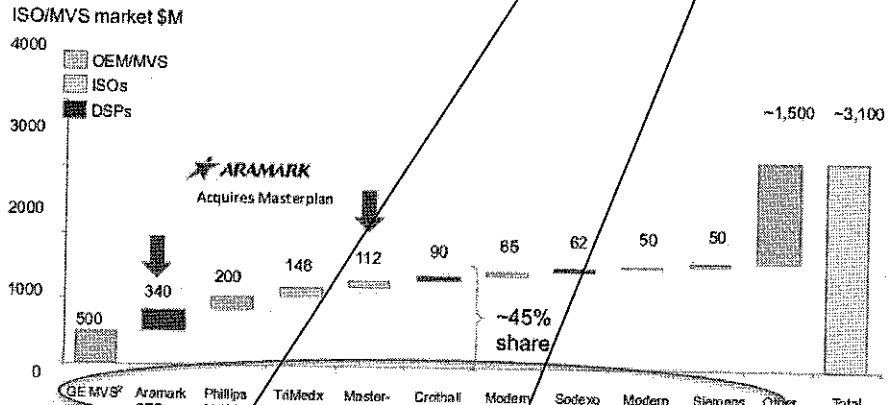

1. Estimate includes allocations to contract MVS and labor does not include contracts to OEMs, professional services or equipment warranty. 2. Daily MVS portion of contract MVS does not include core imaging.
 Source: BCG interviews and analysis, Company 10-Ks, GE, Toshiba and Philips investor presentations, Espicom, HRI, AHA, BESS, RBO, U2 Consultants, Aramark CTS company data, Frost and Sullivan, CDC, USRSR, Dow Jones, Factiva

Το αποτέλεσμα της αγοράς στην Αμερική : περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια ,δείχνει έξι παίκτες να συγκεντρώνουν περίπου το 45% της αγοράς.

Μερίδιο αγοράς, στην αγορά συντήρησης /επισκευής των ιατρικών μηχανημάτων από ανεξάρτητους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών .



Your image tells your story
We'll help you tell it right

ISOs executing a proven service model while leveraging past 30 years of industry experience


Market Factors:

OEM service revenues are modeled using the assumptions that 45 percent of all installed CT imaging equipments are serviced by the OEMs, and that the value of an annual service contract is 12 percent of the original price of the scanner. With the advantages of being focused, local, and cost-effective, independent service companies are able to capture a significant proportion of the after-sales service market from the OEMs.

While a larger proportion of premium scanners sold is serviced by the OEM during at least the first few years of operation, older systems, new low-end systems sold, and the majority of the installed base tend to be serviced by the independent service companies in North America. As a result, the OEM service revenues stream remains dependent on new scanner sales, despite its large dependency on the OEM installed base. This is indicated by the marginal decline in the OEM service market revenues during 2007 and 2008, which appears as a tapered-down version of the decline in new scanner sales.

Source: 2009 Frost and Sullivan, "Global CT Imaging Market"

With the advantages of being focused, local, and cost-effective, independent service companies are able to capture a significant proportion of the after-sales service market from the OEMs

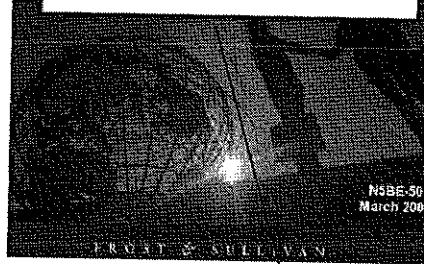

5

Τα έσοδα της υπηρεσίας των κατασκευαστών(OEM) σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας τις υποθέσεις ότι το 45% όλων των εγκατεστημένων εξοπλισμών απεικόνισης CT εξυπηρετούνται από τους κατασκευαστές (OEMs), και ότι η αξία ενός ετήσιου συμβολαίου συντήρησης είναι 12% της αρχικής τιμής του απεικονιστικού μηχανήματος. Με τα πλεονεκτήματα του ότι είναι συγκεντρωμένοι, τοπικά και οικονομικά, οι ανεξάρτητες εταιρίες service μπορούν να κατακτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα στην αγορά του after-sales service από τους κατασκευαστές (OEMs).

Ενώ ένα μεγαλύτερο μέρος από ανώτερα απεικονιστικά μηχανήματα που έχουν πουληθεί εξυπηρετείται από τους κατασκευαστές (OEM) κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των πρώτων λίγων ετών λειτουργίας του, παλιότερα συστήματα, νέα φτηνά συστήματα πουλήθηκαν και η πλειοψηφία της εγκατεστημένης βάσης τείνουν να εξυπηρετούνται από τις ανεξάρτητες εταιρίες service στη Βόρεια Αμερική. Σαν αποτέλεσμα, η ροή των εσόδων της υπηρεσίας των κατασκευαστών (OEM) παραμένει εξαρτημένη από τις πωλήσεις των νέων απεικονιστικών μηχανημάτων, παρόλη τη μεγάλη εξάρτησή της από την εγκατεστημένη βάση των κατασκευαστών (OEM). Αυτό φαίνεται από την ποσοστιαία μείωση των εσόδων στην αγορά υπηρεσιών των κατασκευαστών (OEM) κατά τη διάρκεια του 2007 και του 2008, που εμφανίζεται ως αθέμιτη εκδοχή της μείωσης των πωλήσεων των νέων απεικονιστικών μηχανημάτων.

Με τα πλεονεκτήματα του ότι είναι συγκεντρωμένοι, τοπικά και οικονομικά, οι ανεξάρτητες εταιρίες service μπορούν να κατακτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα στην αγορά του after-sales service από τους κατασκευαστές (OEMs).



ISOs Service Value Proposition

- For ISOs Service is their core Business: culture
- Turnkey, Centralized service across OEM manufacturer, imaging modality and geography
- Independent and unbiased support and reporting, irrespective of OEM model for Service, Spare Parts and Refurbished Equipment
- Throughout the cooperation with ISOs, Customers can maintain advantage of keeping OEMs competition
- More Cost Effective than traditional OEM service by 15-30%.
- Quality as per OEM more transparency

ISOs can reduce your Imaging Equipment OpEx and CapEx by 15-30% without compromising system uptime to secure Revenue

- Για τους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών το βασικό τους καθήκον είναι:
 - η κουλτούρα
 - Ολοκληρωμένη, **Επικεντρωμένη** εξυπηρέτηση έναντι του κατασκευαστή, απεικόνιση τρόπου εφαρμογής και γεωγραφία
 - **Ανεξάρτητη** και αμερόληπτη στήριξη και αναφορά, ανεξάρτητα από το σχεδιασμό του κατασκευαστή για το Service, τα ανταλλακτικά και τον ανακαινισμένο εξοπλισμό
 - Μέσα από τη συνεργασία με τους ανεξάρτητους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών (ISOs), οι πελάτες μπορούν να διατηρήσουν το πλεονέκτημα να κρατήσουν τον ανταγωνισμό των κατασκευαστών (OEMs)
 - Πιο οικονομική από την παραδοσιακή υπηρεσία του κατασκευαστή(OEM) κατά 15 - 30%.
 - Ποιότητα σύμφωνα με τον κατασκευαστή(OEM) περισσότερη διαφάνεια



It is difficult to find a way to mount a challenge against OEMs. Despite having legal actions, they still show no intention of changing their attitude in many countries.

Healthcare Europa report on Procurement in Europe (Part 1) - 2013

Rather than selling an imaging device in isolation, service maintenance contracts are provided as part of the offering. The NHS spends over £360 million per annum on medical imaging equipment and maintenance.

IHS Research, 2012.

Radiology equipment maintenance has a similar financial value to new device acquisition over the lifetime of the device. Comprehensive style contracts are dominant largely due to their ease of use and the potential to control budgetary costs, but costs are high. Creative procurement solutions can offer better value. The corrective portion of comprehensive contracts is estimated to be between 50% (Mobile C-Arm) to 92% (CT), which equates to \$29.4 million; 80% of the total contract costs within the research population of this study. Many organizations could free up cash by better managing their maintenance costs, potentially creating funding opportunities for new equipment.

Source: Wright, C.I. Radiology Management [2012, 34(5):32-5]. Sheffield Hallam University in England.

The first step is to separate maintenance from manufacturing in the European procurement mindset

Είναι δύσκολο να σταματήσεις τους κατασκευαστές από το να βρουν τρόπους να κάνουν μια επίθεση νοητείας. Παρά τους νέους κανονισμούς, αυτοί συνεχίζουν να "λούζουν" ισχυρούς γιατρούς με δώρα σε πολλές χώρες.

Προκειμένου να πουλήσεις μια συσκευή απεικόνισης στην απομόνωση (εννοεί απομόνωση ανταγωνισμού), τα συμβόλαια παροχής συντήρησης παρέχονται ως μέρος της προσφοράς. Ο NHS ξοδεύει πάνω από 360€ εκατομμύρια ανά έτος σε εξοπλισμό ιατρικής απεικόνισης και συντήρησης.

Το πρώτο βήμα είναι να διαχωρίσουμε τη συντήρηση από την κατασκευή στην νοοτροπία των Ευρωπαϊκών συμβάσεων.

Η συντήρηση του εξοπλισμού ακτινολογίας έχει μια παρόμοια οικονομική αξία με την αγορά καινούργιου εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Τα σφαιρικού τύπου συμβόλαια επικρατούν σε μεγάλο βαθμό λόγω της ευκολίας τους στη χρήση και της προοπτικής τους να μπορεί να ελεγχθεί το προϋπολογιστικό τους κόστος. Η λύση των παραγωγικών συμβάσεων μπορούν να προσφέρουν καλύτερη αξία. Το διορθωτικό ποσοστό των σφαιρικών συμβολαίων εκτιμάται να κυμαίνεται μεταξύ 50% (Mobile C-Arm) και 92% (CT), το οποίο ισοδυναμεί με \$ 29.4 εκατομμύρια; 80% του συνολικού κόστους συμβολαίου εντός του ερευνημένου πληθυσμού της συγκεκριμένης έρευνας. Πολλοί οργανισμοί θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν μετρητά με την καλύτερη διαχείριση του κόστους συντήρησής τους, ενδεχομένως δημιουργώντας ευκαιρίες χρηματοδότησης νέου εξοπλισμού.



EUROPEAN INDEPENDENT MARKET COMPLEXITY
 OEM dominance creates hurdles for independent European players

Advantages of Independent Operators

1. Focused
2. Local (flexible)
3. Cost-effective


Market Factors:

OEM service revenues are modeled using the assumptions that 45 percent of all installed CT imaging equipments are serviced by the OEMs, and that the value of an annual service contract is 12 percent of the original price of the scanner. With the advantages of being focused, local, and cost-effective, independent service companies are able to capture a significant portion of the after-sales service market from the OEMs.

While a larger proportion of premium scanners sold is serviced by the OEM during at least the first few years of operation, older systems, new low-end systems sold and the majority of the installed base tend to be serviced by the independent service companies in North America. As a result, the OEM service revenue stream remains dependent on new scanner sales, despite its large dependency on the OEM installed base. This is indicated by the marginal decline in the OEM service market revenues during 2007 and 2008, which appears as a tapered down version of the decline in new scanner sales.

(Source: Frost & Sullivan, 2010.)

Key Hurdles for Independent Providers

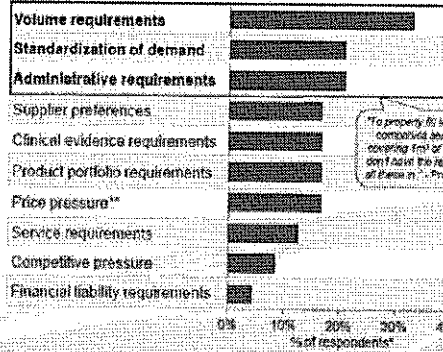

"To properly fit in our services, companies should be either coming first or paper. SMEs don't have the resources to fit in them in." Provider France

(Source: Simon-Kucher & Partners, University of Twente, 2012.)

To properly compete, independent operators need to have sufficient scale for high quality and a solid supply chain.

Για ανταποκριθούν, οι ανεξάρτητοι χειριστές θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο όσο αφορά την υψηλή ποιότητα και έναν αξιόπιστο μηχανισμό εφοδιασμού.

"Οι εταιρείες για να συμπληρώσουν κατάλληλα τους διαγνωσμούς μας, μας έστειλαν προσφορές που κάλυπταν 1m³ χαρπύ. Ο SMEs δεν έχει τους πόρους να τα συμπληρώσει όλα αυτά." Πηγή Γαλλία

Τα έσοδα της υπηρεσίας των κατασκευαστών (OEM) σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας τις υποθέσεις ότι το 45% όλων των εγκατεστημένων εξοπλισμών απεικόνισης CT εξυπηρετούνται από τους κατασκευαστές(OEMs), και ότι η αξία ενός ετήσιου συμβολαίου συντήρησης είναι 12% της αρχικής τιμής του απεικονιστικού μηχανήματος. Με τα πλεονεκτήματα του ότι είναι συγκεντρωμένοι, τοπικά και οικονομικά, οι ανεξάρτητες εταιρίες service μπορούν να κατακτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα στην αγορά του after-sales service από τους κατασκευαστές (OEMs).

Ενώ ένα μεγαλύτερο μέρος από ανώτερα απεικονιστικά μηχανήματα που έχουν πουληθεί εξυπηρετείται από τους κατασκευαστές (OEM) κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των πρώτων λίγων ετών λειτουργίας του, παλιότερα συστήματα, νέα φτηνά συστήματα πουλήθηκαν και η πλειοψηφία της εγκατεστημένης βάσης τείνουν να εξυπηρετούνται από τις ανεξάρτητες εταιρίες service στη Βόρεια Αμερική. Σαν αποτέλεσμα, η ροή των εσόδων της υπηρεσίας των κατασκευαστών (OEM) παραμένει εξαρτημένη από τις πωλήσεις των νέων απεικονιστικών μηχανημάτων, παρόλη τη μεγάλη εξάρτησή της από την εγκατεστημένη βάση του OEM. Αυτό φαίνεται από την ποσοστιαία μείωση των εσόδων στην αγορά υπηρεσιών του OEM κατά τη διάρκεια του 2007 και του 2008, που εμφανίζεται ως αθέμιτη εκδοχή της μείωσης των πωλήσεων των νέων απεικονιστικών μηχανημάτων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
www.elevit.org.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του CED/IFMBE
και με την υποστήριξη της Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΒΙΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14:00 – 18:00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT, ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13.30-14.00	ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
14.00-14.15	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
14.15-15.15	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / KEYNOTE SPEECH Saide CALIL, Καθηγητής του State University of Campinas, Brazil & Πρόεδρος του Clinical Engineering Division της IFMBE <i>«Clinical Engineering Certification: do we need it?»</i>
15.15-16.00	ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ / INVITED SPEECH Rafael PROVENCIO, Regional Marketing Manager Service Product & Solutions – Dräger <i>«European Regulations and Quality concepts at Service of Medical devices»</i>
16.00-16.30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
16.30-17.30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ <i>Θέματα συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού στα Ελληνικά Νοσοκομεία</i> <i>Προεδρείο:</i> Βασίλειος ΓΚΕΡΓΚΗΣ <i>Εισηγητές:</i> Βηθλεέμ ΜΟΥΣΙΔΟΥ, Χρήστος ΜΙΧΑΗΛ, Ηρακλής ΛΥΓΑΣ, Δημήτρης ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ
17.30-17.45	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (INBIT): «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» <i>Μετάφραση δημοσιεύσεων από τη σειρά "Medical device technical series" του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)</i> <i>Παρουσίαση:</i> Καλλιρρόη ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
17.45-18.00	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ